

PUBBLICAZIONE ESITI

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, volta alla raccolta d'informazioni utili per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, di prossima indizione, relativamente alla indicenda PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE AD ALTA DEFINIZIONE E DECONTAMINAZIONE ENDOSCOPI - CND Z destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria

Si ringraziano tutti gli operatori economici per i contributi forniti e le osservazioni rese nell'ambito della consultazione preliminare di mercato in oggetto che si è conclusa con l'evento pubblico del 20/05/2025.

L'incontro conclusivo si è tenuto a partire dalle ore 15.00 presso la sede di PuntoZero alla presenza della Coordinatrice dell'Area acquisti Dispositivi medici Dott.ssa Nicoletta Filistauri; l'Amministratore Unico Ing. Giancarlo Bizzarri; il Direttore dell'area CRAS Ing. Alessandro Di Bello; il RUP Dott.ssa Valeria Moschini; i membri del Tavolo Tecnico l'Ing. Giulia Silvestri e l'Ing. Davide Critello.

Erano presenti i seguenti operatori economici:

- Paoletti Srl;
- Olympus Italia Srl;
- Cantel Medical Italy Srl;
- Steris;
- Steelco SpA.

Durante l'incontro la Coordinatrice dell'Area Dispositivi medici ha ribadito l'intenzione di PuntoZero di attuare appalti ispirati al Value Based Procurement inserendo meccanismi incentivanti nella fase esecutiva, tramite l'applicazione del meccanismo Pay for Performance (P4P), evidenziando l'importanza della collaborazione con i fornitori per definire i criteri di performance e ridurre gli errori delle apparecchiature in fase di esecuzione della fornitura.

Si è chiarito che verrà previsto un indicatore di performance chiaro e rilevante, rappresentato dal rapporto tra cicli di disinfezione interrotti, causati esclusivamente dai problematiche tecniche della lavaendoscopi (rimanendo esclusi dall'analisi quelli causati da errore umano, endoscopi, infrastruttura aziendale), e il numero totale di cicli effettuati complessivamente dalla lavaendoscopi, e cioè il tasso d'incidenza di cicli di disinfezione interrotti. Tale indice è stato prescelto per monitorare l'affidabilità e la performance della lavaendoscopi e la sicurezza del processo di reprocessing.

In particolar modo, è stato chiarito che durante l'esecuzione del contratto sarà esaminato il report specifico recante il tasso di cicli di disinfezione interrotti per ciascuna macchina:

A. se il tasso annuo di cicli di disinfezione interrotti risulterà inferiore alla soglia di performance definita, al fornitore verrà riconosciuto il pagamento del "Prezzo complessivo offerto".

ovvero

B. se il tasso annuo di cicli di disinfezione interrotti risulterà superiore alla soglia di performance definita, al fornitore non verrà riconosciuto l'integrale pagamento del "Prezzo complessivo offerto", ma lo stesso verrà ridotto di una percentuale prefissata a causa del mancato raggiungimento del valore richiesto.

E' stato inoltre specificato, che non verranno remunerati i cicli di disinfezione interrotti esclusivamente per problematiche tecniche causate dalla lavaendoscopi, i quali pertanto non verranno conteggiati per il pagamento.

Per il conseguimento dell'obiettivo proposto, è stata richiesta la collaborazione del mercato di riferimento mediante la pubblicazione di una consultazione di mercato finalizzata ad acquisire eventuali osservazioni da parte degli Operatori Economici in merito al tema della Value Based Procurement. A tal fine, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito modulo (questionario), pubblicato sia sul proprio sito istituzionale sia sulla piattaforma STELLA, mediante il quale gli Operatori Economici erano tenuti a fornire risposte in merito ai quesiti formulati.

Il RUP è poi passato ad illustrare alle Ditte partecipanti all'incontro, l'esito della raccolta delle informazioni acquisite tramite il questionario, nonché il dettaglio delle osservazioni pervenute, rappresentate graficamente come di seguito riportato, tenuto conto della partecipazione complessiva di n.5 imprese:

Il RUP ha esaminato le osservazioni pervenute dalle Ditte in merito ai quesiti, il cui esito è stato esaminato, raggruppato e sintetizzato graficamente in base alle risposte formulate..

DOMANDA N.1:


Value-Based Procurement (VBP) alla procedura:

Al fine di definire la soglia di performance, rappresentato dal rapporto tra cicli di disinfezione interrotti, causati esclusivamente dai problematiche tecniche della lavaendoscopi (rimanendo esclusi dall'analisi quelli causati da errore umano, endoscopi, infrastruttura aziendale), e il numero totale di cicli effettuati complessivamente dalla

lavaendoscopi, si chiede di indicare il **tasso d'incidenza di cicli di disinfezione interrotti per problematiche legate alla lavaendoscopi, e pertanto si chiede:**


a) indicare il numero totale dei cicli effettuati in un mese dalla lavaendoscopi.

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

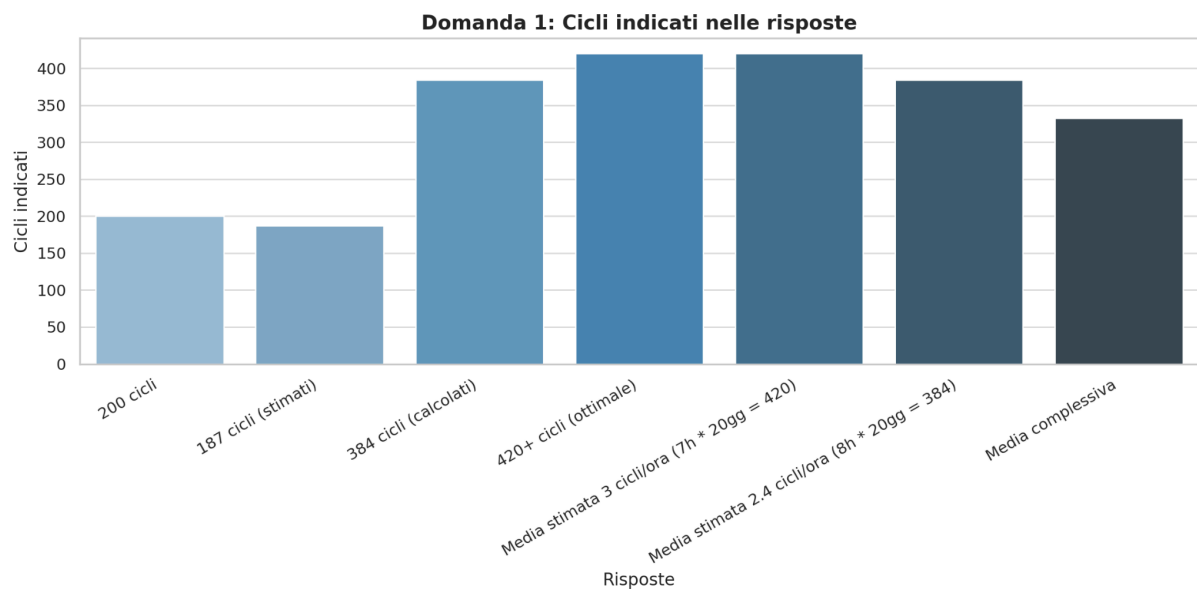


b) la numerosità dei cicli collegati ai singoli errori codificati relativamente a tale mese oggetto di analisi.

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

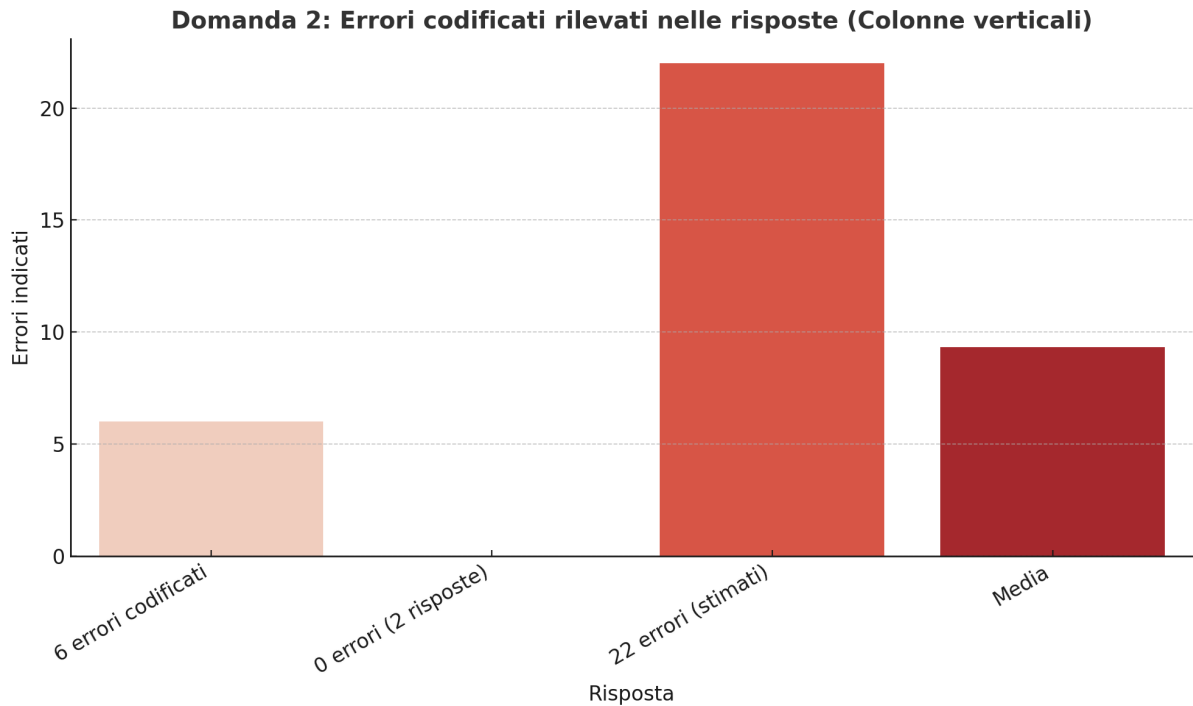

c) il tasso d'incidenza sul totale esaminato dei cicli di disinfezione interrotti per problematiche legate esclusivamente alla lavaendoscopi.

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

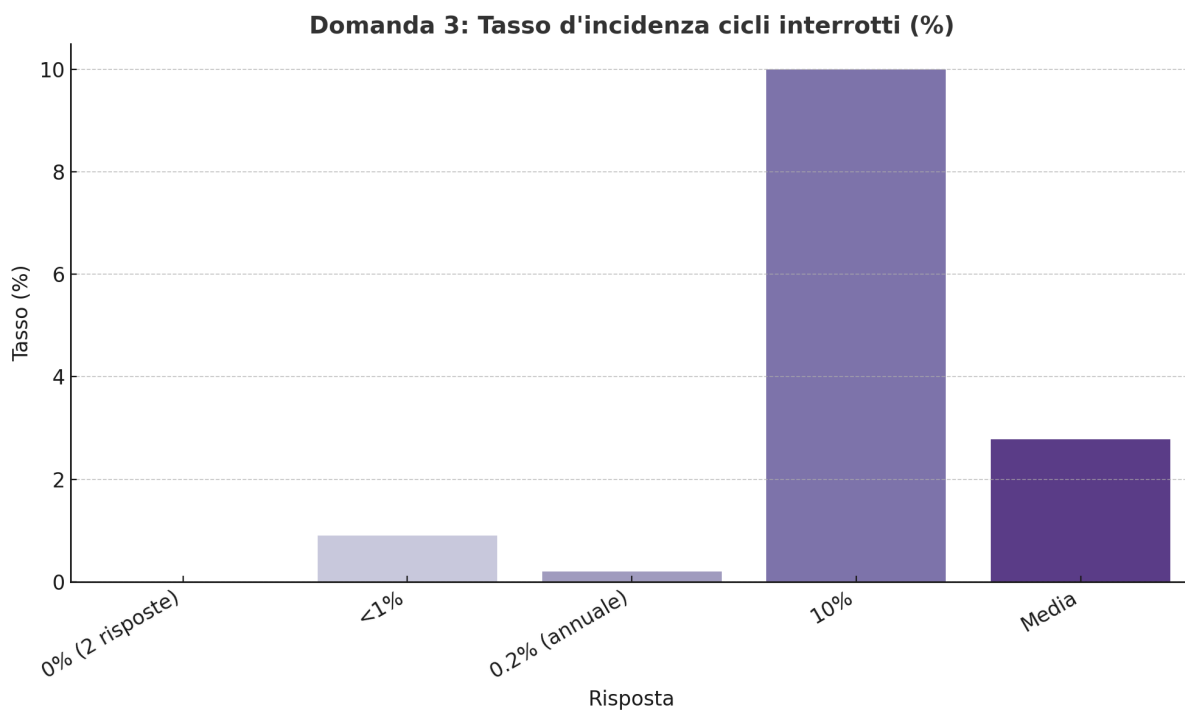

DOMANDA N.2:

Si chiede di indicare la lista degli errori relativi a problematiche tecniche della macchina completa dei relativi codici.




PuntoZero S.c.a r.l.
SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

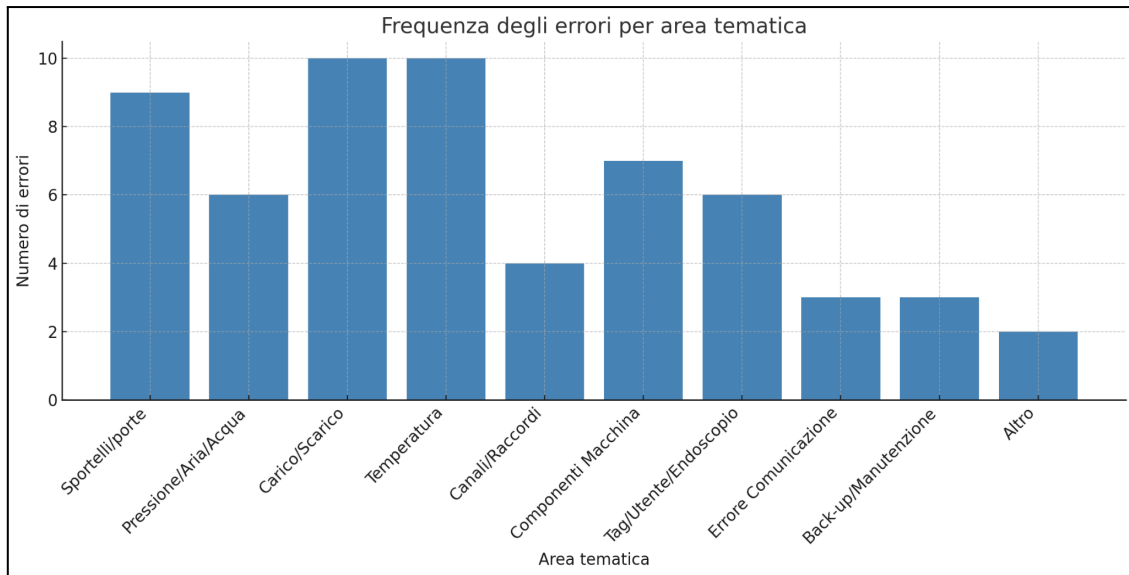

DOMANDA N.3:

Considerazione di applicabilità del meccanismo Pay for Performance (P4P):


A seguito della stipula delle Convenzioni, i fornitori aggiudicatari avvieranno la fornitura sulla base delle condizioni previste dalla documentazione di gara. Durante l'esecuzione del contratto sarà esaminato il report specifico recante il tasso di cicli di disinfezione interrotti per ciascuna macchina:

a) se il tasso **annuo di cicli di disinfezione interrotti** risulterà inferiore alla soglia di performance definita, al fornitore verrà riconosciuto il pagamento del "Prezzo complessivo offerto".

ovvero

b) se il tasso **annuo di cicli di disinfezione interrotti** risulterà superiore alla soglia di performance definita, al fornitore non verrà riconosciuto l'integrale pagamento del "Prezzo complessivo offerto", ma lo stesso verrà **ridotto di una percentuale prefissata a causa del mancato raggiungimento del valore richiesto.**

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

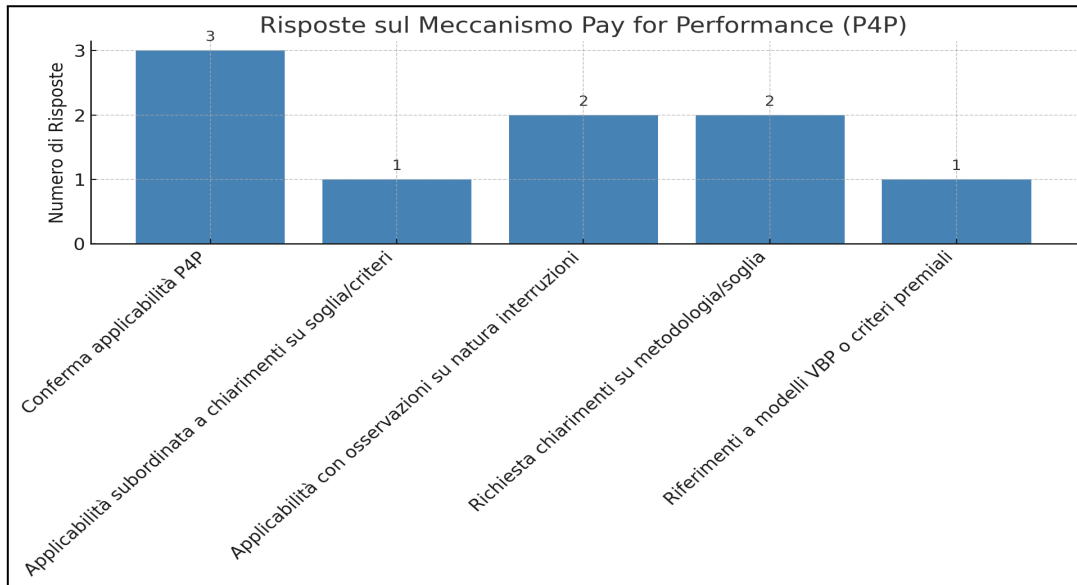


DOMANDA N.4:

Includere la Carbonfootprint di prodotto secondo la norma UNI EN ISO 14067 come requisito tecnico tabellare:

Includere la Carbonfootprint di prodotto secondo la norma UNI EN ISO 14067 come requisito tecnico tabellare:

8 risposte




DOMANDA N.5:

Certificazione UNI PdR 125:2022 (parità di genere)

L'azienda che adotta la UNI PdR 125:2022 promuove la parità di genere, trasformando la cultura aziendale e , migliorando e valorizzando le performance individuali e organizzative:

Certificazione UNI PdR 125:2022 (parità di genere) L'azienda che adotta la UNI PdR 125:2022 promuove la parità di genere, trasformando la cultur...ando le performance individuali e organizzative:

9 risposte




- L'OE è ATTUALMENTE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
- L'OE NON è ATTUALMENTE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE E NON INTENDE CONSEGUIRLA
- L'OE HA AVVIATO L'ITER PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE E SARA' ACQUISITA ENTRO GIUGNO 2025

DOMANDA N.6:

UNI EN ISO 14001 -PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO L'azienda che fornisce il bene/servizio ha un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 finalizzato alla riduzione / mitigazione degli impatti ambientali correlati ad attività sotto il diretto controllo dell'azienda e non (es. attività dei fornitori), al perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. Con certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 140001 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000.

UNI EN ISO 14001 -PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO L'azienda che fornisce il bene/servizio ha un sistema di gestione ambientale...orme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000.

9 risposte



- L'OE è ATTUALMENTE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
- L'OE NON è ATTUALMENTE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE E NON INTENDE CONSEGUIRLA
- L'OE HA AVVIATO L'ITER PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE E SARA' ACQUISITA ENTRO GIUGNO 2025


DOMANDA N.7:

CERTIFICAZIONE SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"

L'azienda che fornisce il bene/servizio ha un sistema di gestione Aziendale socialmente responsabile, certificato dal possesso della certificazione SA8000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000.

CERTIFICAZIONE SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" L'azienda che fornisce il bene/servizio ha un sistema di gestione Aziendale s...me all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000.

9 risposte




- L'OE è ATTUALMENTE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
- L'OE NON è ATTUALMENTE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE E NON INTENDE CONSEGUIRLA
- L'OE HA AVVIATO L'ITER PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE E SARA' ACQUISITA ENTRO GIUGNO 2025

DOMANDA 8:

Includere la Certificazione CERTIFICAZIONE SA 8000 (Gestione Aziendale socialmente responsabile) come requisito tecnico tabellare:

Includere la Certificazione CERTIFICAZIONE SA 8000 (Gestione Aziendale socialmente responsabile) come requisito tecnico tabellare:

9 risposte



- SI
- NO

DOMANDA N.9:

Confezionamento del disinfettante:

alla luce del nuovo Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Si propone il seguente criterio premiante tabellare finalizzato a promuovere azioni concrete di riduzione della mole di rifiuti dei contenitori di detergente tramite ricaricabilità dei flaconi di detergente:

Il Punteggio Verrà attribuito all'operatore economico che offra la fornitura di disinfettante mediante ricaricabilità dei flaconi di detergente, ai sensi del Regolamento (UE) 2025/40, promuovendo comportamenti virtuosi di riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.


Le azioni concrete adottate per la ricarica dei flaconi di detergente devono essere dettagliatamente descritte in apposita **relazione tecnica**, dalla quale risulti il rispetto di tutti gli elementi previsti dal suddetto regolamento, inclusi:

- caratteristiche tecniche dei contenitori ricaricabili,
- modalità di sicurezza e igiene nel processo di reintegro,
- tracciabilità del ciclo di ricarica.

La relazione dovrà inoltre contenere un **piano operativo per il ritiro dei contenitori vuoti e la riconsegna degli stessi reintegrati**, a totale carico del fornitore.

Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile in adeguata relazione tecnica che indichi espressamente tutti i punti suindicati. In assenza di relazione verrà attribuito il punteggio di zero.

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

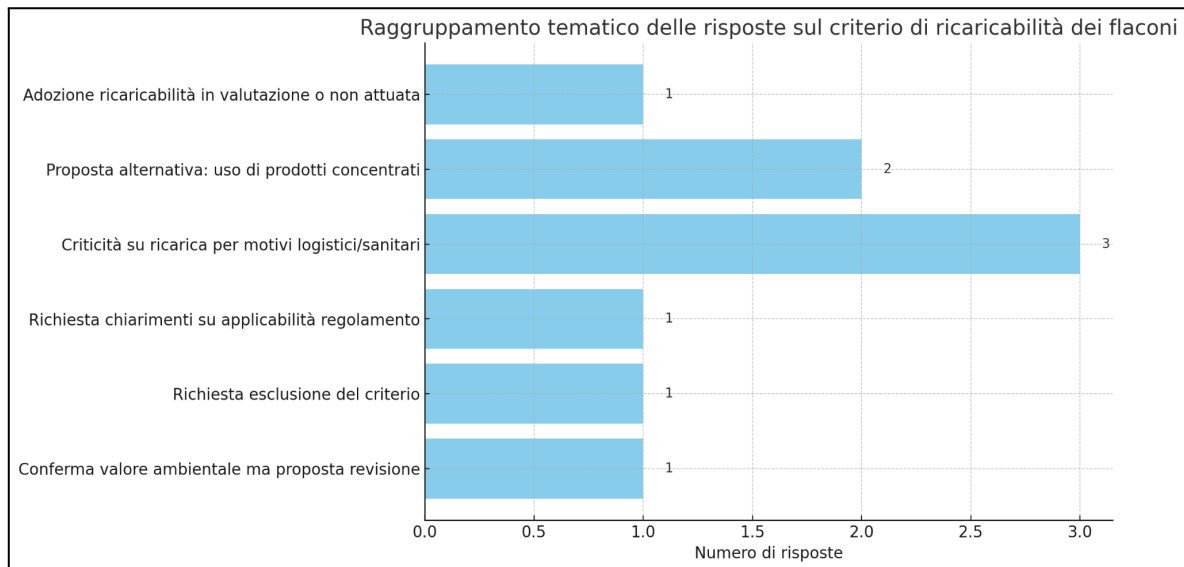

DOMANDA N.10:

Con l'obiettivo di favorire il **Green Public Procurement**, ed alla luce del nuovo **Regolamento UE 2025/40**, si propone di inserire criteri premianti volti a misurare, premiare e sostenere comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità ambientale di un Operatore Economico. Si propone il seguente criterio premiante:


"Minor Consumo d'Acqua per Ciclo di Disinfezione"

Per quanto riguarda il consumo d'acqua per ciascun ciclo di disinfezione ordinario che assicuri gli ottimali standard di risultato, espresso in litri, verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=1$ all'offerta che presenta il minor consumo d'acqua per ciclo di ricondizionamento, espresso in litri.

I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: $V(a)=\frac{V_i}{V_{min}}$.

L'indicazione del consumo d'acqua deve risultare da scheda tecnica o da apposita dichiarazione dell'operatore. Verrà attribuito un punteggio pari a zero se il valore richiesto non è espresso in litri.

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

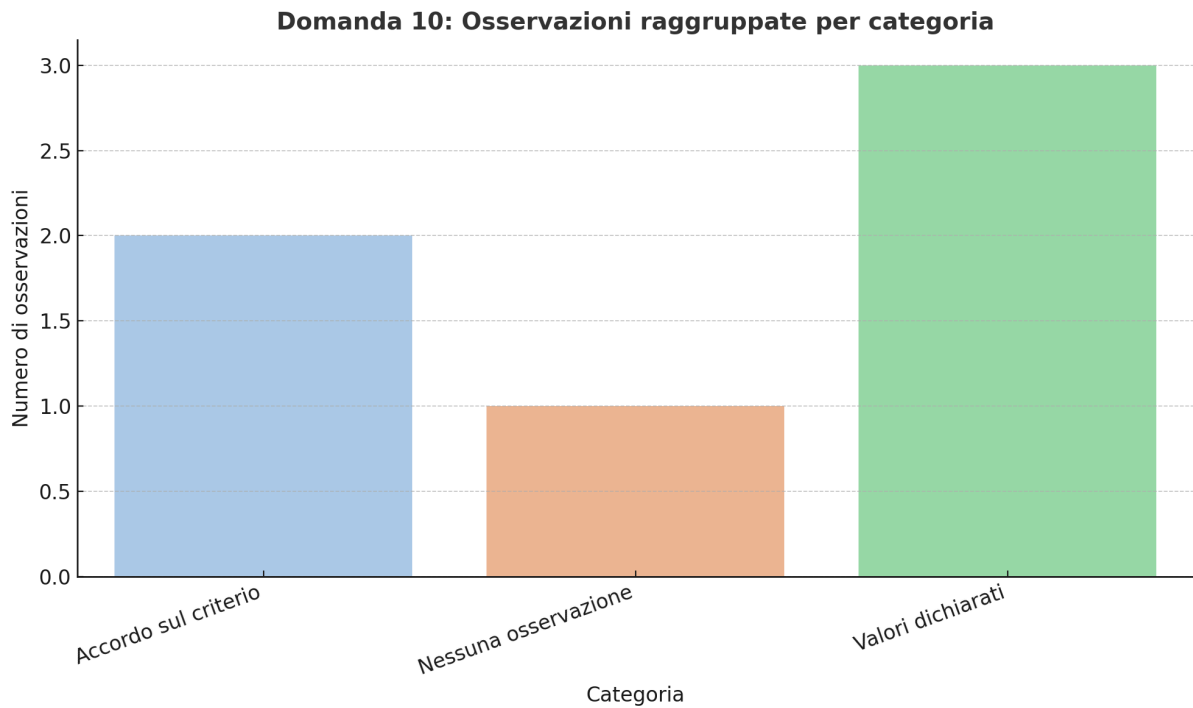

DOMANDA N.11:

Con l'obiettivo di favorire il **Green Public Procurement**, ed alla luce del nuovo **Regolamento UE 2025/40**, si propone di inserire criteri premianti volti a misurare, premiare e sostenere comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità ambientale di un Operatore Economico. Si propone il seguente criterio premiante:


"Minor Consumo di energia elettrica per Ciclo di Disinfezione"

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica per ciascun ciclo di disinfezione, ordinario che assicuri gli ottimali standard di risultato, espresso in kwh, verrà attribuito Il coefficiente massimo $V(a)=1$ all'offerta che presenta il minor consumo di energia elettrica per ciclo di ricondizionamento, espresso in kwh.

I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: $V(a)_i = V_i/V_{min}$.

L'indicazione del consumo di energia elettrica deve risultare da scheda tecnica o da apposita dichiarazione dell'operatore. Verrà attribuito un punteggio pari a zero se il valore richiesto non è espresso in kwh.

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

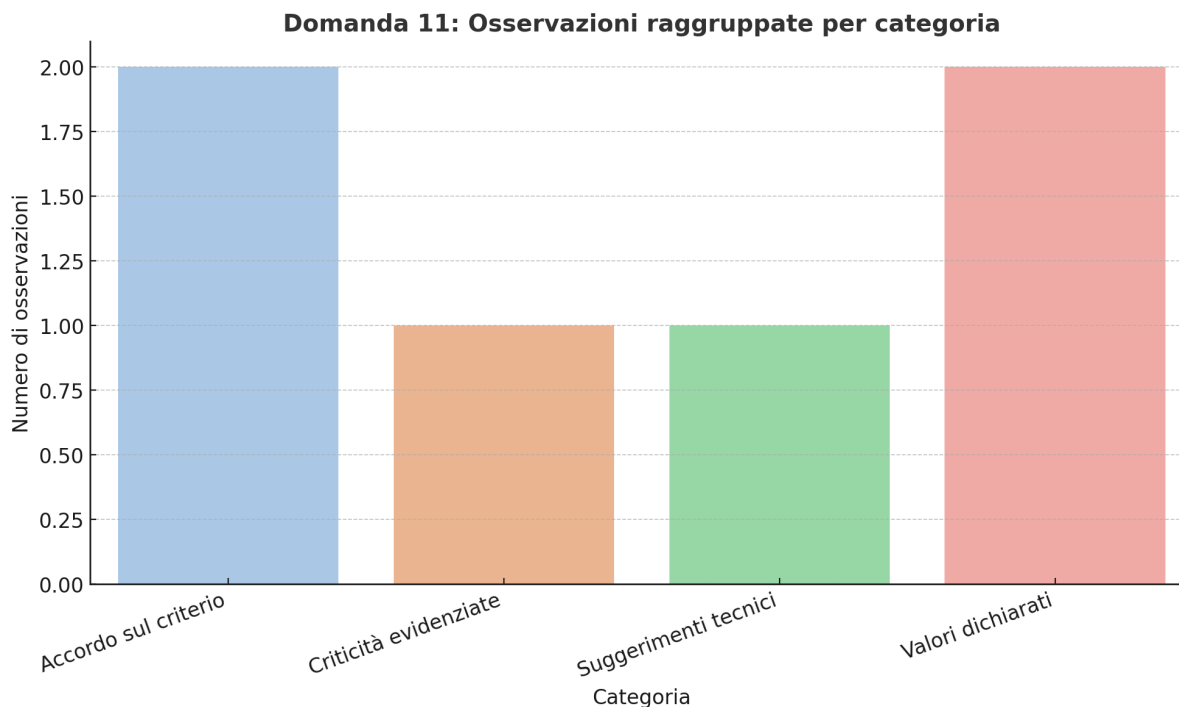

DOMANDA N.12:

Disponibilità Software di tracciabilità .

Verrà inserita nel capitolato tecnico di gara la disponibilità di un **Software di tracciabilità** che dovrà essere quotato separatamente rispetto all' offerta economica di gara e il cui acquisto sarà opzionale da parte di ciascuna Azienda Sanitaria.


“Disponibilità di Software di tracciabilità unico in grado di registrare tutte le informazioni relative all'intero ciclo di lavaggio, reprocessing, asciugatura e stoccaggio integrandosi con le apparecchiature coinvolte nelle varie fasi (pompe, lavaendoscopi e armadi di asciugatura) oggetto di fornitura. Il sistema offerto dovrà consentire di tracciare tutto il flusso di lavaggio della strumentazione, archiviando tutti i dati e i documenti necessari ad ottemperare le prescrizioni richieste dalle normative e dalle linee guida di settore. Operatori e strumenti dovranno essere identificati in maniera univoca utilizzando la stessa modalità di riconoscimento in tutte le fasi del flusso: lavaggio, reprocessing, asciugatura e stoccaggio. Il sistema offerto dovrà integrarsi con il gestionale di reparto in uso preferibilmente con

l'implementazione di un'interfaccia HL7 e/o la possibilità di esporre o di interrogare specifici webservices per condividere dati e documenti. Tecnologia "WEB", con l'utilizzo dei Browser più diffusi (almeno Chrome e Firefox) e con possibilità di installazione su Server virtualizzati forniti dall'Azienda. Qualora siano previste licenze d'uso concorrenti la ditta ne dovrà fornire in numero illimitato ovvero il numero necessario e richiesto da ogni azienda contraente per tutta la durata del contratto. La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'aggiornamento all'ultima release SW disponibile, senza oneri aggiuntivi, previa autorizzazione della Azienda Sanitaria."

Includere il requisito minimo della disponibilità del software di tracciabilità con le caratteristiche sopra indicate?

Disponibilità Software di tracciabilità . Verrà inserita nel capitolato tecnico di gara la disponibilità di un Software di tracciabilità che dovrà essere quotat...tracciabilità con le caratteristiche sopra indicate?

9 risposte



DOMANDA N.13:

Disponibilità Software di tracciabilità .

Verrà inserita nel capitolato tecnico di gara la disponibilità di un **Software di tracciabilità** che dovrà essere quotato separatamente rispetto all' offerta economica di gara e il cui acquisto sarà opzionale da parte di ciascuna Azienda Sanitaria.

"Disponibilità di Software di tracciabilità unico in grado di registrare tutte le informazioni relative all'intero ciclo di lavaggio, reprocessing, asciugatura e stoccaggio integrandosi con le apparecchiature coinvolte nelle varie fasi (pompe, lavaendoscopi e armadi di asciugatura)

oggetto di fornitura. Il sistema offerto dovrà consentire di tracciare tutto il flusso di lavaggio della strumentazione, archiviando tutti i dati e i documenti necessari ad ottemperare le prescrizioni richieste dalle normative e dalle linee guida di settore. Operatori e strumenti dovranno essere identificati in maniera univoca utilizzando la stessa modalità di riconoscimento in tutte le fasi del flusso: lavaggio, reprocessing, asciugatura e stoccaggio. Il sistema offerto dovrà integrarsi con il gestionale di reparto in uso preferibilmente con l'implementazione di un'interfaccia HL7 e/o la possibilità di esporre o di interrogare specifici webservices per condividere dati e documenti. Tecnologia "WEB", con l'utilizzo dei Browser più diffusi (almeno Chrome e Firefox) e con possibilità di installazione su Server virtualizzati forniti dall'Azienda. Qualora siano previste licenze d'uso concorrenti la ditta ne dovrà fornire in numero illimitato ovvero il numero necessario e richiesto da ogni azienda contraente per tutta la durata del contratto. La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'aggiornamento all'ultima release SW disponibile, senza oneri aggiuntivi, previa autorizzazione della Azienda Sanitaria."

Includere il requisito minimo della disponibilità del software di tracciabilità con le caratteristiche sopra indicate?

Sintesi osservazioni raggruppate per categoria:

