

Al Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Nicoletta Filistauri

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 118 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA. - COMUNICAZIONE PRODOTTI NON IDONEI

La sottoscritta Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 04/11/2024 e nelle date 03/03/2025, 18/03/2025/ 24/03/2025, 09/04/2025, 17/04/2025, 28/04/2025, 08/05/2025, 15/05/2025, 21/05/2025 e 29/05/2025 ha svolto le operazioni di valutazione tecnica constatando che i seguenti prodotti NON SONO IDONEI per le motivazioni appresso individuate:

LOTTO 2: DILATATORI PALLONCINO BILIO PANCREATICI

• DITTA ASPEN SANITAS SRL: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una lunghezza del pallone e non risponde quindi al requisito minimo "Palloni di vari diametri e lunghezze". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.



• DITTA M.G. LORENZATTO SRL: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una lunghezza del pallone e non risponde quindi al requisito minimo "Palloni di vari diametri e lunghezze". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 3: AGHI PER TERAPIA INIETTIVA

• DITTA ASPEN SANITAS SRL: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta un solo diametro da 2,3 mm e non risponde quindi al requisito minimo "Diametro per canale operativo 1.8 mm e 2.8 mm". Inoltre il prodotto presenta una sola lunghezza del catetere, non rispondendo quindi al requisito minimo "Varie lunghezze del catetere". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

• DITTA ELEMED SRL: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta un canale operativo > 2,00 mm e non risponde quindi al requisito minimo "Diametro per canale operativo 1.8 mm e 2.8 mm". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

• DITTA EUROMEDICAL SRL: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta un canale operativo di 2,00 mm e 2,8 mm e non risponde quindi al requisito minimo "Diametro per canale operativo 1.8 mm e 2.8 mm". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

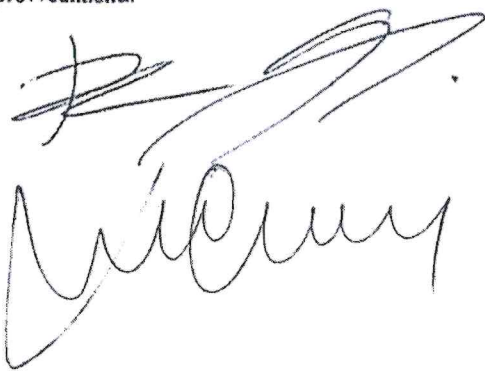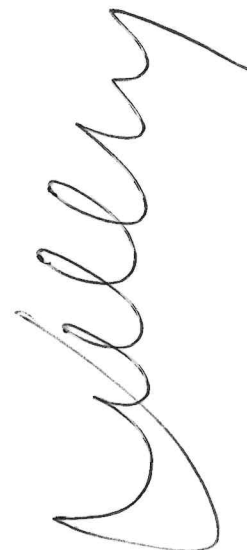

- **DITTA M.G. LORENZATTO SRL:** la Commissione rileva che nella scheda tecnica del prodotto offerto dichiara un diametro del catetere di 1,9 mm e non risponde quindi al requisito minimo "Diametro per canale operativo 1,8 mm e 2,8 mm". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

#### LOTTO 12 - AGHI PER INIEZIONE DI COLLA DI FIBRINA

- **DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.:** la Commissione rileva che il prodotto offerto non presenta il doppio lume e non risponde quindi al requisito minimo "Doppio lume". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

#### LOTTO 20 - CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER ELETTRO-COAGULAZIONE



- **DITTA OLYMPUS ITALIA SRL:** la Commissione rileva che il prodotto offerto non presenta la compatibilità con duodenoscopio e non risponde quindi al requisito minimo "Certificata per utilizzo con il duodenoscopio". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

#### LOTTO 25 - ANSA MONOUSO PLURIFILAMENTO

- **DITTA ASPEN SANITAS SRL:** la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta un diametro fino a 36 mm e non risponde quindi al requisito minimo "di diametro maggiore di 5 cm". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **DITTA EUROMEDICAL SRL:** la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta un diametro fino a 32 mm e non risponde quindi al requisito minimo "di diametro maggiore di 5 cm". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

#### LOTTO 28 - MINI ANSA MONOUSO PLURIFILAMENTO PER POLIPECTOMIA

- **DITTA ASPEN SANITAS SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché non viene dichiarato che il prodotto offerto presenta l'apertura da 7 mm, ma 10 e 15 mm richiesto a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA CANTEL MEDICAL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché viene dichiarato che il prodotto offerto presenta l'apertura da 9 mm. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA EUROMEDICAL SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché non viene dichiarato che il prodotto presenta l'apertura da 7 mm, ma 10 e 15 mm richiesto a pena di esclusione. Inoltre il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "configurazione

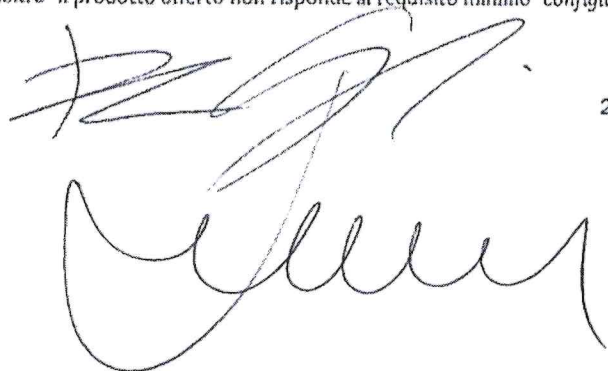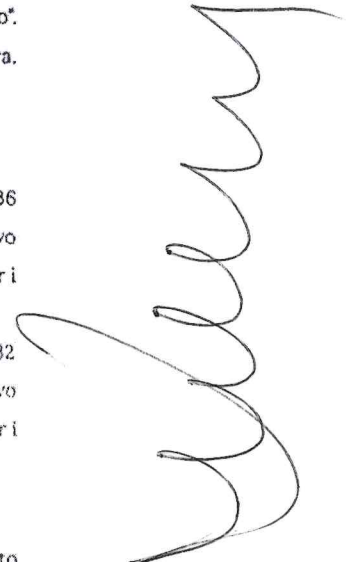

ovale e esagonale con sistema di rotazione a 1:1", perché presente solo una configurazione ovale e non anche esagonale. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

- **DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché non viene dichiarato che il prodotto presenta l'apertura da 7 mm, ma 10 e 15 mm richiesto a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

- **DITTA M.G. LORENZATTO SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché non viene dichiarato che il prodotto presenta l'apertura da 7 mm, ma 10 e 15 mm richiesto a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

- **DITTA OLYMPUS ITALIA SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché non viene dichiarato che il prodotto presenta l'apertura da 7 mm, ma 10 e 15 mm richiesto a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

- **DITTA FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "apertura 7 mm e 10 mm", perché non viene dichiarato che il prodotto presenta l'apertura da 7 mm, ma 10 e 12 mm richiesto a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

#### LOTTO 34 - CANNULA PER ERCP MONOUSO

- **DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non presenta la compatibilità con guida 0,025 e non risponde quindi al requisito minimo "Compatibile con guida 0,025". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

#### LOTTO 35 - CANNULA PER ERCP MONOUSO

- **DITTA M.G. LORENZATTO SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non soddisfa il requisito minimo del "triplo lume", in quanto nella scheda tecnica è dichiarato come dispositivo a doppio lume; inoltre non rispetta il requisito minimo relativo alla "punta standard e rastremata", poiché viene presentato esclusivamente con punta rastremata. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

#### LOTTO 48 - CESTELLO MONOUSO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI

- **DITTA ASPEN SANITAS SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "fio guidato con 4 fili, varie misure, con possibilità di litotrixxia di emergenza", perché il prodotto offerto non è utilizzabile per litotrixxia, richiesto a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato

NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 58 - SONDA DIGIUNALE PER DIGIUNOSTOMIA

• DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL: La Commissione rileva che la ditta dichiara di non avere i diametri nel modello di offerta tecnica e non rispondendo quindi al requisito minimo "vari diametri". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 60- SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE

• DITTA DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT: La Commissione rileva che il prodotto offerto non è dotato di foro in punta dichiara laterali, e non risponde quindi al requisito minimo "applicabile con filo guida e dotato di foro in punta (all'apice prossimale) per applicazione". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

• DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione rileva che il prodotto offerto non è dotato di foro in punta e non risponde quindi al requisito minimo "applicabile con filo guida e dotato di foro in punta (all'apice prossimale) per applicazione". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 61- SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE


• DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde quindi al requisito minimo "TTS" non dichiarandolo nella scheda tecnica e al requisito "di lunghezza circa 240 cm" dichiarando la lunghezza minore (160cm). Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 66 -PINZA MONOUSO PER POLIPI DIMINUTIVI

• DITTA MEDITALIA GROUP SRL: La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "lunghezza: 160 cm e 240 cm" poichè nella documentazione prodotta la Ditta presenta una lunghezza pari a "160 cm e 230 cm". Inoltre la Ditta non ha inserito nella busta tecnica le schede tecniche del dispositivo offerto bensì una dichiarazione sostitutiva dei requisiti ai sensi del dpr 445/2000, non rispettando pertanto quanto previsto all'art. 16 di pag. 36 del disciplinare di gara. Conseguentemente il dispositivo, per la mancanza del requisito minimo, viene dichiarato NON IDONEO e pertanto la Ditta viene esclusa dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 86 - FILO GUIDA CON PORZIONE DISTALE IDROFILA

• DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione giudicatrice, in sede di valutazione tecnica, ha rilevato che il dispositivo offerto non soddisfa il requisito minimo previsto dalla documentazione di gara, relativo alla

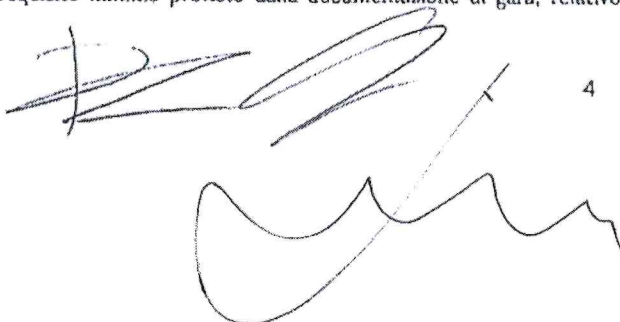

compatibilità con dispositivi di" diametro da 0,021 e 0,035 varie lunghezze". Inoltre, non è stata accettata la dichiarazione di equivalenza presentata, in quanto non conforme ai parametri tecnici richiesti. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **DITTA M.G. LORENZATTO SRL** : La Commissione giudicatrice, in sede di valutazione tecnica, ha rilevato che il dispositivo offerto non soddisfa il requisito minimo previsto dalla documentazione di gara, relativo alla compatibilità con dispositivi di" diametro da 0,021" e 0,035 varie lunghezze". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **DITTA OLYMPUS ITALIA SRL**: La Commissione giudicatrice, in sede di valutazione tecnica, ha rilevato che il dispositivo offerto non soddisfa il requisito minimo previsto dalla documentazione di gara, relativo alla compatibilità con dispositivi di" diametro da 0,021" e 0,035 varie lunghezze". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

#### LOTTO 19: PINZA EMOSTATICA



- **DITTA AORTA SRL**: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una dimensione del morso e non risponde quindi al requisito minimo "varie lunghezze e dimensioni del morso". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **DITTA ASPEN SANITAS SRL**: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una dimensione del morso e non risponde quindi al requisito minimo "varie lunghezze e dimensioni del morso". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.**: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una dimensione del morso e non risponde quindi al requisito minimo "varie lunghezze e dimensioni del morso". Inoltre non specifica se il dispositivo è mono o bipolare così come richiesto invece nel requisito di minima. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **DITTA MEDITALIA GROUP S.R.L.**: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una dimensione del morso e non risponde quindi al requisito minimo "varie lunghezze e dimensioni del morso". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **DITTA ERBE**: la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta solamente una dimensione del morso e non risponde quindi al requisito minimo "varie lunghezze e dimensioni del morso". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato NON IDONEO e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

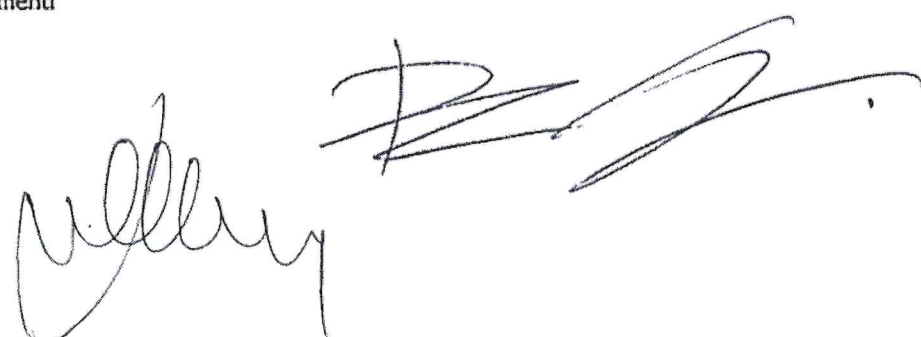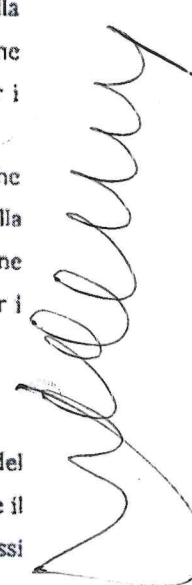

**LOTTO 116: SISTEMA PER ABLAZIONE MUCOSA CON RADIO FREQUENZA PER ESOFAGO DI BARRETT**


- **DITTA PENTAX ITALIA;** la Commissione rileva che il prodotto offerto presenta l'ablazione mucosa non per radiofrequenza ma per crioablazione e quindi non risponde quindi al requisito minimo "ablazione mucosa radiofrequenza catetere per ablazione a 360°". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

Tenuto conto di quanto comunicato dalla Commissione, si trasmette al RUP per i conseguenti adempimenti.

In fede

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dr. Raffaele Alberto Maria Colucci - Responsabile Endoscopia Digestiva Ospedale di Spoleto - Azienda USL Umbria 2 in qualità di Presidente \_\_\_\_\_

Dr. Danilo Castellani Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera di Perugia -in qualità di componente e segretario verbalizzante 

Dr. Gabriele Marinozzi Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Ospedaliera di Terni -in qualità di componente 