

PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE CENTRALI E PERIFERICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE GARA ANAC 8452441

VERBALE 1

SEDUTA DI GARA

21 Aprile 2022 ORE 10:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto sito in Orvieto (TR) in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente della Centrale Regionale Acquisti in Sanità, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 02/03/2022, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l'affidamento della Fornitura di Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici occorrenti alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria, da svolgersi ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell'art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, suddivisa in 36 lotti con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV), ai sensi di quanto previsto all'art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016.
- sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti - costituenti anch'essi *lex specialis* di gara- pervenuti entro il 25/3/2022, con relative risposte dalla Stazione appaltante pubblicate il 28/3/2022 e riportati anche sul sito web di PuntoZero scarl nella sezione dedicata alla presente procedura, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

tanto premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico, anche in considerazione delle misure di distanziamento sociale disposte da misure governative in vigore per contenimento del pericolo pandemico.

La seduta si svolgerà mediante piattaforma Net4Market attraverso la quale l'O.E. precedentemente abilitato potrà verificare *ex post*, l'avvenuta apertura dei plichi virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

L'utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono riepilogate nel pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a:

1. verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle;
2. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP ha visualizzato mediante piattaforma telematica il plico contenente la documentazione d'offerta con l'elenco degli operatori che si sono abilitati e che hanno presentato le buste amministrativa, tecnica ed economica (Allegato 1).

Visualizza successivamente

- l'elenco dei fornitori partecipanti che hanno presentato la documentazione amministrativa con data e ora di caricamento (Allegato 2)
- l'elenco dei codici seriali inseriti che identificano delle offerte economiche formulate dagli operatori economici e che saranno successivamente caricate sulla piattaforma dagli stessi operatori economici (Allegato 3).

Dagli allegati suddetti risultano partecipanti alla gara i seguenti operatori economici:

DITTA
3M Italia SRL
ASPEN SANITAS S.R.L
B. BRAUN MILANO SPA
BARD SRL
BECTON DICKINSON ITALIA SPA
BENEFIS SRL
CAIR ITALIA SRL
CARBINI SRL
DELTA MED SPA
GADA ITALIA SPA
ICU MEDICAL EUROPE SRL
MEDITREND SNC
MEDTRONIC ITALIA SPA
MULTIMEDICAL SRL
N.R. DI NANNINI SRL
NIPRO MEDICAL ITALY SRL CON SOCIO UNICO
PIKDARE SPA
QURE SRL
SANITER BICE MARIOTTINI SRL
SEDA SPA
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL
TAU MEDICA SRL
VYGON ITALIA SRL

2



Il RUP ha aperto la busta amministrativa selezionando l'apposito pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" e ha verificato che le ditte partecipanti sopra elencate, abbiano provveduto al deposito telematico della documentazione amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara, riscontrandone la tempestività.

Il Rup procede quindi all'apertura delle buste amministrative di tutti gli operatori economici.

Si riporta, di seguito, l'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici, i lotti a cui hanno richiesto di partecipare e le eventuali criticità rilevate con le conseguenti valutazioni:

Operatore economico	Lotti	Criticità	Valutazioni
3M Italia SRL	24	----	AMMESSO
ASPEN SANITAS S.R.L	12-20-23-24	----	AMMESSO
B. BRAUN MILANO SPA	1-2-3-5-13-14-15-17-18-19-28	----	AMMESSO
BARD SRL	11-12-17-25-27-33-34	----	AMMESSO
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	4-22-24-28-29-30-31	Nel DGUE presenti dichiarazioni che non inficiano la partecipazione alla procedura. Mancano le ricevute di pagamento del contributo ANAC per i lotti 4, 30 e 31	AMMESSO per i lotti 22- 24 - 28 - e 29 AMMESSO CON RISERVA per i lotti 4 - 30 e 31. <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede la documentazione mancante (ricevute pagamento contributo ANAC per i lotti 4,30 e 31 effettuato entro il 15/4/2022)
BENEFIS SRL	13-14-22-24-28-29	Nel DGUE presenti dichiarazioni che non inficiano la partecipazione alla procedura.	AMMESSO
CAIR ITALIA SRL	22	----	AMMESSO
CARBINI SRL	1-4-17-18-19-20-26-27-29-31	----	AMMESSO
DELTA MED SPA	1-2-4-10-11-12-20-22-24-26-27-28-31	-----	AMMESSO
GADA ITALIA SPA	1-2-3	----	AMMESSO
ICU MEDICAL EUROPE SRL	24	-----	AMMESSO
MEDITREND SNC	1	-----	AMMESSO

MEDTRONIC ITALIA SPA	33-35-36	Nel DGUE presenti dichiarazioni che non inficiano la partecipazione alla procedura.	AMMESSO
MULTIMEDICAL SRL	22-23	----	AMMESSO
N.R. DI NANNINI SRL	29-30-31	Manca dichiarazione di iscrizione alla CCIAA. La garanzia provvisoria presentata per € 1.911,00 è inferiore all'1% della base d'asta dei lotti a cui l'O.E. intende partecipare (€ 243.900,00)	AMMESSO CON RISERVA <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : Si richiede Dichiarazione iscrizione CCIAA e integrazione della polizza fidejussoria per € 528,00.
NIPRO MEDICAL ITALY SRL CON SOCIO UNICO	35	----	AMMESSO
PIKDARE SPA	28-29-30	----	AMMESSO
QURE SRL	33-36	Nel DGUE non è stata compilata la parte III, sez. B, sez. C e sez. D	AMMESSO CON RISERVA <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede integrazione del DGUE nelle parti non compilate ed evidenziate nella colonna criticità.
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	1-6-7-15- 20	----	AMMESSO
SEDA SPA	10-27-33- 34-35-36	----	AMMESSO
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	17-18	Nel DGUE presenti dichiarazioni che non inficiano la partecipazione alla procedura.	AMMESSO
TAU MEDICA SRL	22-24-28	Nel DGUE sono indicate forniture per importo inferiore a quanto richiesto nel Disciplinare di gara (mancanti forniture per € 1.068.118)	AMMESSO CON RISERVA <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede elenco delle ulteriori forniture effettuate per l'importo indicato nella colonna criticità
VYGON ITALIA SRL	8-9-10-18- 20-21-22- 26-31-32	----	AMMESSO

Si dà atto che la seduta di gara è stata sospesa alle ore 13.30. E' stata successivamente ripresa il 21/4/2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:30, il 28/4/2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:30, il 4/5/2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13:30 del 4/5/2022 dichiara conclusa la seduta di gara.

Verbale letto e sottoscritto per approvazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dr. Andrea Ciucci

IL SUPPORTO Sig.ra Brunella Pasquini

All. 1-2-3: c.s.

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici

Apertura:

- data/ora: 20/04/2022 10:17
- utente: ANDREA CIUCCI
- ip: 185.110.117.190

Ragione sociale	Amministrativa	Tecnica	Economica
3M ITALIA SRL	Si	Si	Si
ARTRO' SRL	No	No	No
ASPEN SANITAS SRL	Si	Si	Si
B.Braun Avitum Italy s.p.a.	No	No	No
B.BRAUN MILANO SPA	Si	Si	Si
Bard s.r.l.	Si	Si	Si
BAXTER SPA	No	No	No
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Si	Si	Si
BENEFIS S.R.L.	Si	Si	Si
CAIR ITALIA S.r.l.	Si	Si	Si
Carbini srl	Si	Si	Si
DELTA MED S.p.A.	Si	Si	Si
ESTOR SPA	No	No	No
GADA ITALIA SPA	Si	Si	Si
Icu Medical Europe SRL	Si	Si	Si
MEDITREND S.N.C.	Si	Si	Si
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	No	No	No
MEDTRONIC ITALIA SPA	Si	Si	Si

Ragione sociale	Amministrativa	Tecnica	Economica
MULTIMEDICAL SRL	Si	Si	Si
N.R. DI NANNINI SRL	Si	Si	Si
Nacatur International Import Export S.r.l. a s.u.	No	No	No
NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.	No	No	No
NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO	Si	Si	Si
PIKDARE S.P.A.	Si	Si	Si
QURE SRL	Si	Si	Si
SANITER BICE MARIOTTINI srl	Si	Si	Si
SEDA SPA	Si	Si	Si
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	Si	Si	Si
TAU MEDICA SRL	Si	Si	Si
Tecnoline spa	No	No	No
Vygon Italia s.r.l.	Si	Si	Si

7



Elenco fornitori partecipanti - documentazione amministrativa

Criteri di esportazione applicati:

- Oggetto: Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici

**Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa**

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
3M ITALIA SRL	12971700153	00100190610	via NORBERTO BOBBIO 21 pioltello mi 20096	13/04/2022 12:41
ASPEN SANITAS SRL	02193130545	02193130545	VIA PIETRO CESTELLINI, 64 perugia fraz ponte san giovanni 06135	13/04/2022 16:26
B.BRAUN MILANO SPA	00674840152	00674840152	VIA VINCENZO DA SEREGNO 14 Milano 20161	13/04/2022 15:56
Bard s.r.l.	01911071007	07931650589	VIA CINA 444 Roma 00144	13/04/2022 14:07
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	00803890151	VIA CIALDINI, 16 Milano 20161	14/04/2022 11:04
BENEFIS S.R.L.	02790240101	02790240101	VIA GUALCO, 14 Genova 16165	08/04/2022 06:56
CAIR ITALIA S.r.l.	03277950287	03277950287	via S. Bendetto 45/c praglia di teolo 35037	13/04/2022 13:45
Carbini srl	02397660420	02397660420	Via Saragat, 32 Montecarotto 60036	15/04/2022 10:51
DELTA MED S.p.A.	01693020206	01693020206	Via Guido Rossa 20 Viadana 46019	12/04/2022 11:02
GADA ITALIA SPA	08230471008	08230471008	VIA GIULIO VINCENZO BONA 133 Roma 00156	12/04/2022 17:41
Icu Medical Europe SRL	03237150234	03237150234	Viale Luca Gaurico, 9/11 Roma 00143	15/04/2022 10:21
MEDITREND S.N.C.	01594340422	01594340422	Via I° Maggio 150 B ancona 60131	14/04/2022 13:06
MEDTRONIC ITALIA SPA	09238800156	09238800156	VIA VARESINA, 162 Milano 20156	13/04/2022 09:52
MULTIMEDICAL SRL	01585920208	01585920208	VIA GUIDO ROSSA 71 Viadana 46019	14/04/2022 16:59
N.R. DI NANNINI SRL	00408220465	00408220465	Via Augusto Mancini n° 145/149 Lucca 55100	05/04/2022 15:26
NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO	11489570967	11489570967	P.ZZA CAVOUR 7 Milano 20121	11/04/2022 12:45
PIKDARE S.P.A.	03690650134	03690650134	Via Saldarini Catelli 10 Casnate con Bernate 22070	12/04/2022 10:45
QURE SRL	13130961009	13130961009	VIA TEMPIO DEL CIELO, 3 Roma 00144	07/04/2022 11:07

**Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa**

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
SANITER BICE MARIOTTINI srl	00105030555	00105030555		12/04/2022 11:29
SEDA SPA	01681100150	01681100150	VIA CARDUCCI 8 Milano 20123	08/04/2022 09:59
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	02154270595	02154270595	VIA DELLA STAZIONE Latina 04100	13/04/2022 12:58
TAU MEDICA SRL	01282550555	01282550555	VIA WALTER MINISTRINI, 35 Terni 05100	15/04/2022 12:30
Vygon Italia s.r.l.	02173550282	02173550282	Viale Dell'Industria, 60 Padova 35129	15/04/2022 10:15

10

Elenco seriali inseriti - documentazione economica

Criteri di esportazione applicati:

- Oggetto: Dispositivi per accesso vascolare centrali e periferici
- Round: 1 - Busta chiusa telematica

Legenda:

- (*) = effettuati interventi da parte del Gestore del Sistema

Elenco seriali inseriti - documentazione economica

Ragione sociale	Seriale marcatura temporale	Data ora inserimento
3M ITALIA SRL	20FD5F05	13/04/2022 17:52:18
ASPEN SANITAS SRL	20FE8B22	14/04/2022 10:55:36
B.BRAUN MILANO SPA	213F36FF	13/04/2022 15:57:10
Bard s.r.l.	20F96592	13/04/2022 15:04:09
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	20FEC5EC	14/04/2022 11:42:39
BENEFIS S.R.L.	20EEE4A0	07/04/2022 15:32:07
CAIR ITALIA S.r.l.	20FC1378	13/04/2022 13:48:17
Carbini srl	6557028895891973728	14/04/2022 11:13:12
DELTA MED S.p.A.	20F883A6	12/04/2022 11:17:45
GADA ITALIA SPA	20FE76F9	14/04/2022 10:36:01
Icu Medical Europe SRL	663a6627e69e12b2	15/04/2022 11:43:28
MEDITREND S.N.C.	21011778	15/04/2022 09:45:17
MEDTRONIC ITALIA SPA	20fb8961	13/04/2022 11:17:41
MULTIMEDICAL SRL	21000B85	14/04/2022 17:08:44
N.R. DI NANNINI SRL	210216E9	15/04/2022 15:21:45
NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO	20FE3318	14/04/2022 09:22:32
PIKDARE S.P.A.	3b3b8d8aa4044e8e	12/04/2022 14:50:11
QURE SRL	20EE095B	07/04/2022 11:25:09
SANITER BICE MARIOTTINI srl	791fab81daf488e8	13/04/2022 11:50:54
SEDA SPA	21335F3B	08/04/2022 11:10:56
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	214006D3	13/04/2022 18:24:35

12

**Elenco seriali inseriti - documentazione
economica**

Ragione sociale	Seriale marcatura temporale	Data ora inserimento
TAU MEDICA SRL	2101C028	15/04/2022 12:39:37
Vygon Italia s.r.l.	20FFDF7D	15/04/2022 10:27:04

PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE CENTRALI E PERIFERICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE GARA ANAC 8452441

VERBALE 2

SEDUTA DI GARA

24 Maggio 2022 ORE 10:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto sito in Orvieto (TR) in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente

Il responsabile Unico del Procedimento riprende il verbale della precedente seduta telematica del 20/04/2022 durante la quale si era preso atto della necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio per gli operatori ammessi con riserva ed in particolare:

BECTON DICKINSON ITALIA SPA	4-22-24- 28-29-30- 31	Nel DGUE presenti dichiarazioni che non inficiano la partecipazione alla procedura. Mancano le ricevute di pagamento del contributo ANAC per i lotti 4, 30 e 31	AMMESSO per i lotti 22- 24 - 28 - e 29 AMMESSO CON RISERVA per i lotti 4 - 30 e 31. <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede la documentazione mancante (ricevute pagamento contributo ANAC per i lotti 4,30 e 31 effettuato entro il 15/4/2022)
N.R. DI NANNINI SRL	29-30-31	Manca dichiarazione di iscrizione alla CCIAA. La garanzia provvisoria presentata per € 1.911,00 è inferiore all'1% della base d'asta dei lotti a cui l'O.E. intende partecipare (€ 243.900,00)	AMMESSO CON RISERVA SOCCORSO ISTRUTTORIO: Si richiede Dichiarazione iscrizione CCIAA e integrazione della polizza fidejussoria per € 528,00.
QURE SRL	33-36	Nel DGUE non è stata compilata la parte III, sez. B, sez. C e sez. D	AMMESSO CON RISERVA SOCCORSO ISTRUTTORIO: si richiede integrazione del DGUE nelle parti non compilate ed evidenziate nella colonna criticità.
TAU MEDICA SRL	22-24-28	Nel DGUE sono indicate forniture per importo inferiore a quanto richiesto nel Disciplinare di gara (mancanti forniture per € 1.068.118)	AMMESSO CON RISERVA SOCCORSO ISTRUTTORIO: si richiede elenco delle ulteriori forniture effettuate per l'importo indicato nella colonna criticità

Il RUP dà atto che in data 9/5/2022 attraverso la piattaforma net4Market sono state inviate comunicazioni a mezzo Pec ai suddetti operatori economici comunicando le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa da loro presentata e assegnando il termine di quindici giorni per provvedere a regolarizzare la loro posizione. Tutte le comunicazioni risultano essere state regolarmente consegnate ai destinatari.

Il Rup prende atto dei riscontri ricevuti dagli operatori economici che di seguito si riportano e sulla scorta dei quali si formulano le seguenti valutazioni:

Operatore economico	Criticità	Valutazioni	Riscontro operatore economico	Valutazione
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Mancano le ricevute di pagamento del contributo ANAC per i lotti 4, 30 e 31	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede la documentazione mancante (ricevute pagamento contributo ANAC per i lotti 4, 30 e 31 effettuato entro il 15/4/2022)	L'O.E. ha caricato a sistema le ricevute di pagamento dei contributi ANAC per i lotti 4, 30 e 31 ma il pagamento risulta essere stato effettuato l'11/5/2022 e cioè <u>dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda e delle offerte.</u>	OPERATORE ECONOMICO AMMESSO per i lotti 22, 24, 28 e 29. ESCLUSO per i lotti 4, 30 e 31 (art. 11 del Disciplinare di gara e art. 1, c. 67, L. 266/2005)
N.R. DI NANNINI SRL	Manca dichiarazione di iscrizione alla CCIAA. La garanzia provvisoria presentata per € 1.911,00 è inferiore all'1% della base d'asta dei lotti a cui l'O.E. intende partecipare (€ 243.900,00)	AMMESSO CON RISERVA <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : Si richiede Dichiarazione iscrizione CCIAA e integrazione della polizza fidejussoria per € 528,00.	L'O.E. ha caricato a sistema la dichiarazione di iscrizione e il certificato di iscrizione alla CCIAA. Ha inoltre caricato l'appendice di polizza fidejussoria già presentata in sede di gara con la precisazione che la garanzia prestata è di € 2.439,00. (Di fatto trattasi di integrazione della polizza per € 528,00)	O.E. AMMESSO
QURE SRL	Nel DGUE non è stata compilata la parte III, sez. B, sez. C e sez. D	AMMESSO CON RISERVA <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede integrazione del DGUE nelle parti non compilate ed evidenziate nella colonna criticità.	L'O.E. ha caricato a sistema il DGUE compilato nella parte III, sez. B, sez. C e sez. D.	O.E. AMMESSO
TAU MEDICA SRL	Nel DGUE sono indicate forniture per importo inferiore a quanto richiesto nel Disciplinare di gara (mancanti forniture per € 1.068.118)	AMMESSO CON RISERVA <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> : si richiede elenco delle ulteriori forniture effettuate per l'importo indicato nella colonna criticità	L'O.E. ha presentato elenco forniture ulteriori per un totale di oltre € 1.100.00,00	O.E. AMMESSO

Dagli allegati al verbale n. 1 e da quanto sopra risultano partecipanti alla gara i seguenti operatori economici:

DITTA	LOTTE
3M Italia SRL	24
ASPEN SANITAS S.R.L	12-20-23-24

B. BRAUN MILANO SPA	1-2-3-5-13-14-15-17-18-19-28
BARD SRL	11-12-17-25-27-33-34
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	22- 24-28-29
BENEFIS SRL	13-14-22-24-28-29
CAIR ITALIA SRL	22
CARBINI SRL	1-4-17-18-19-20-26-27-29-31
DELTA MED SPA	1-2-4-10-11-12-20-22-24-26-27-28-31
GADA ITALIA SPA	1-2-3
ICU MEDICAL EUROPE SRL	24
MEDITREND SNC	1
MEDTRONIC ITALIA SPA	33-35-36
MULTIMEDICAL SRL	22-23
N.R. DI NANNINI SRL	29-30-31
NIPRO MEDICAL ITALY SRL CON SOCIO UNICO	35
PIKDARE SPA	28-29-30
QURE SRL	33-36
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	1-6-7-15-20
SEDA SPA	10-27-33-34-35-36
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	17-18
TAU MEDICA SRL	22-24-28
VYGON ITALIA SRL	8-9-10-18-20-21-22-26-31-32

Lotto 1	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA, MEDITREND S.N.C, SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 2	B.BRAUN MILANO SPA, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA,
Lotto 3	B.BRAUN MILANO SPA, GADA ITALIA SPA,
Lotto 4	Carbini srl, DELTA MED S.P.A,
Lotto 5	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 6	SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 7	SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 8	Vygon Italia s.r.l
Lotto 9	Vygon Italia s.r.l
Lotto 10	DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, Vygon Italia s.r.l
Lotto 11	Bard s.r.l, DELTA MED S.P.A,
Lotto 12	ASPEN SANITAS SRL, Bard s.r.l, DELTA MED S.P.A,
Lotto 13	B.BRAUN MILANO SPA, BENEFIS S.R.L,
Lotto 14	B.BRAUN MILANO SPA, BENEFIS S.R.L,
Lotto 15	B.BRAUN MILANO SPA, SANITER BICE MARIOTTINI SRL
Lotto 16	DESERTO
Lotto 17	B.BRAUN MILANO SPA, Bard s.r.l, Carbini srl, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L

Lotto 18	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L, Vygon Italia s.r.l
Lotto 19	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl,
Lotto 20	ASPEN SANITAS SRL, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 21	Vygon Italia s.r.l
Lotto 22	BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, CAIR ITALIA SRL, DELTA MED S.P.A, MULTIMEDICAL SRL, TAU MEDICA SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 23	ASPEN SANITAS SRL, MULTIMEDICAL SRL,
Lotto 24	3M ITALIA SRL, ASPEN SANITAS SRL, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, Icu Medical Europe srl, TAU MEDICA SRL
Lotto 25	Bard s.r.l,
Lotto 26	Carbini srl, DELTA MED S.P.A, Vygon Italia s.r.l
Lotto 27	Bard s.r.l, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 28	B.BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, PIKDARE S.P.A, TAU MEDICA SRL
Lotto 29	BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, Carbini srl, N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,
Lotto 30	N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,
Lotto 31	Carbini srl, DELTA MED S.P.A, N.R. DI NANNINI SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 32	Vygon Italia s.r.l
Lotto 33	Bard s.r.l, MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO
Lotto 34	Bard s.r.l, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 35	MEDTRONIC ITALIA SPA, NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L CON SOCIO UNICO, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 36	MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 11:00 dichiara conclusa la seduta di gara.

Verbale letto e sottoscritto per approvazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dr. Andrea Ciucci

IL SUPPORTO Sig.ra Brunella Pasquini

**PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE CENTRALI E
PERIFERICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA,
CODICE GARA ANAC 8452441**

VERBALE 3

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 14/07/2022

ORE 11:00

In collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet è presente la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto nominata con Determina dell'Amministratore Unico del 01/03/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Fabio Gori - Presidente
- Dr. Vittorio Cerotto - Membro
- Dr.ssa Emanuela Santuro - Membro

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, sono presenti inoltre il RUP Dr. Andrea Ciucci con funzioni di segretario verbalizzante, la collaboratrice, Sig.ra Pasquini Brunella dipendente di PuntoZero scarl, con funzione di testimone.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti.

Il RUP comunica di avere comunicato, con pec tramite Net4Market, alle ditte partecipanti la riunione odierna della quale verrà trasmesso verbale.

Il RUP prende atto che i commissari hanno reso la dichiarazione prevista dall'art.42 e dall'art.77 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità e inconferibilità per lo svolgimento delle funzioni. Il Dr. Ciucci, inoltre, ricorda che lui e la Sig.ra Pasquini Brunella, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese ai sensi degli artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000, acquisite agli atti dell'ufficio, hanno rilasciato le dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione (L.190/2012).

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art.21 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico, anche in considerazione delle misure di distanziamento sociale disposte da misure governative per contenimento del pericolo pandemico. La seduta di svolgerà mediante piattaforma Net4Market attraverso la quale l'O.E. precedentemente abilitato potrà verificare ex post, l'avvenuta presentazione dei plichi virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa. L'utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono riepilogate nel verbale odierno che verrà trasmesso agli operatori economici.

Preliminarmente il RUP ricorda che nella seduta del 21/04/2022, e nella successiva del 24/05/2022 sono stati ammessi alle fasi successive della gara i seguenti operatori economici per i lotti appresso indicati:

DITTA	LOTTI
3M Italia SRL	24
ASPEN SANITAS S.R.L	12-20-23-24

18

B. BRAUN MILANO SPA	1-2-3-5-13-14-15-17-18-19-28
BARD SRL	11-12-17-25-27-33-34
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	22- 24-28-29
BENEFIS SRL	13-14-22-24-28-29
CAIR ITALIA SRL	22
CARBINI SRL	1-4-17-18-19-20-26-27-29-31
DELTA MED SPA	1-2-4-10-11-12-20-22-24-26-27-28-31
GADA ITALIA SPA	1-2-3
ICU MEDICAL EUROPE SRL	24
MEDITREND SNC	1
MEDTRONIC ITALIA SPA	33-35-36
MULTIMEDICAL SRL	22-23
N.R. DI NANNINI SRL	29-30-31
NIPRO MEDICAL ITALY SRL CON SOCIO UNICO	35
PIKDARE SPA	28-29-30
QURE SRL	33-36
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	1-6-7-15-20
SEDA SPA	10-27-33-34-35-36
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	17-18
TAU MEDICA SRL	22-24-28
VYGON ITALIA SRL	8-9-10-18-20-21-22-26-31-32

Di seguito i lotti con i nominativi degli operatori economici ammessi:

Lotto 1	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA, MEDITREND S.N.C, SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 2	B.BRAUN MILANO SPA, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA,
Lotto 3	B.BRAUN MILANO SPA, GADA ITALIA SPA,
Lotto 4	Carbini srl, DELTA MED S.P.A,
Lotto 5	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 6	SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 7	SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 8	Vygon Italia s.r.l
Lotto 9	Vygon Italia s.r.l
Lotto 10	DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, Vygon Italia s.r.l
Lotto 11	Bard s.r.l, DELTA MED S.P.A,
Lotto 12	ASPEN SANITAS SRL, Bard s.r.l, DELTA MED S.P.A,
Lotto 13	B.BRAUN MILANO SPA, BENEFIS S.R.L,
Lotto 14	B.BRAUN MILANO SPA, BENEFIS S.R.L,
Lotto 15	B.BRAUN MILANO SPA, SANITER BICE MARIOTTINI SRL
Lotto 16	DESERTO
Lotto 17	B.BRAUN MILANO SPA, Bard s.r.l, Carbini srl, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L
Lotto 18	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L, Vygon Italia s.r.l

Lotto 19	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl,
Lotto 20	ASPEN SANITAS SRL, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 21	Vygon Italia s.r.l
Lotto 22	BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, CAIR ITALIA SRL, DELTA MED S.P.A, MULTIMEDICAL SRL, TAU MEDICA SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 23	ASPEN SANITAS SRL, MULTIMEDICAL SRL,
Lotto 24	3M ITALIA SRL, ASPEN SANITAS SRL, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, Icu Medical Europe srl, TAU MEDICA SRL
Lotto 25	Bard s.r.l,
Lotto 26	Carbini srl, DELTA MED S.P.A, Vygon Italia s.r.l
Lotto 27	Bard s.r.l, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 28	B.BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, PIKDARE S.P.A, TAU MEDICA SRL
Lotto 29	BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, Carbini srl, N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,
Lotto 30	N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,
Lotto 31	Carbini srl, DELTA MED S.P.A, N.R. DI NANNINI SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 32	Vygon Italia s.r.l
Lotto 33	Bard s.r.l, MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO
Lotto 34	Bard s.r.l, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 35	MEDTRONIC ITALIA SPA, NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L CON SOCIO UNICO, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 36	MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,

Il RUP comunica che, successivamente alla notifica dei suddetti verbali, la ditta Becton Dickinson Italia spa ha presentato ricorso al TAR Umbria, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della sua esclusione dalla partecipazione alla gara per i lotti 4, 30 e 31. Per tale motivo, in attesa che il TAR Umbria si pronunci su tale istanza di sospensiva, il RUP comunica che nella seduta odierna non si procederà all'apertura delle offerte tecniche per i lotti 4, 30 e 31 rinviando tale procedura a data da destinarsi.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, nella seduta odierna la Commissione giudicatrice procederà a prendere atto del deposito telematico delle offerte tecniche inviate dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a verificare la presenza dei documenti inviati senza entrare nel merito del contenuto e senza alcun giudizio e/o valutazione.

Le offerte economiche, come indicato nel disciplinare telematico, restano segrete, chiuse/bloccate sui PC degli operatori economici in attesa del caricamento in piattaforma.

Il RUP e tutti i componenti della Commissione giudicatrice visualizzano, mediante condivisione dello schermo, la piattaforma telematica e prendono atto dell'elenco delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Il RUP ed il Presidente della Commissione giudicatrice alle ore 11:20 iniziano l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche: il RUP seleziona l'apposito pulsante "Apri busta tecnica" e precede a verifica che le ditte partecipanti sopra elencate in tabella abbiano provveduto al deposito telematico della documentazione nei termini e con la modalità prescritte dalla norma di gara riscontrando la presenza della documentazione richiesta

Il RUP e la commissione attestano che tutte le ditte risultano avere presentato documenti


per i lotti per i quali hanno richiesto di partecipare.

Il RUP e i membri della Commissione giudicatrice alle ore 11:45 dichiarano conclusa l'attività di apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche e concordano di fissare una prossima seduta, con data da definire, al fine di iniziare i lavori di verifica di idoneità e successiva valutazione delle offerte tecniche.

Il RUP precisa che per problemi tecnici di collegamento internet riscontrati dalla propria postazione, tutte le operazioni sono state eseguite dalla postazione e con l'account Net4Market della collega Sig.ra Brunella Pasquini.

Verbale letto dal segretario verbalizzante e approvato dai presenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Ciucci 

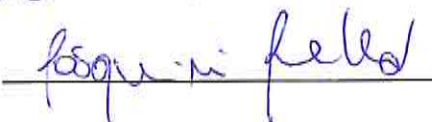IL SUPPORTO
Sig.ra Brunella Pasquini 

**PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE CENTRALI E
PERIFERICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA,
CODICE GARA ANAC 8452441**

VERBALE 4

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 23/08/2022

ORE 10:30

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, sono presenti il RUP Dr. Andrea Ciucci e la Sig.ra Pasquini Brunella dipendente di PuntoZero scarl, con funzione di testimone.

Il RUP prende atto della email del 22/8/2022 dell'avv. Vittorio Miniero, legale di PuntoZero scarl patrocinatore nei giudizi innanzi al TAR Umbria instaurati:

- dalla ditta Becton Dickinson per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della sua esclusione dalla partecipazione alla gara per i lotti 4, 30 e 31
- dalla ditta Delta Med spa per l'annullamento del bando di gara limitatamente al lotto 31 (controinteressato ditta Becton Dickinson).

Con la suddetta email l'Avv. Miniero ha trasmesso la sentenza del TAR Umbria n. 641/2022 con la quale è stato respinto il ricorso della ditta Becton Dickinson Italia spa. Con successiva email sempre del 22/8/2022 l'Avv. Miniero ha condiviso la proposta del RUP di procedere all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche di tutti i lotti oggetto dei due ricorsi suddetti (4, 30 e 31). In particolare quindi, si ritiene di procedere all'apertura delle offerte del lotto 31 in quanto, pur essendo sub iudice il bando relativo allo stesso lotto (ricorrente ditta Delta Med spa), tuttavia non è stata richiesta la sospensiva e la ditta controinteressata (Becton Dickinson spa) è stata esclusa dalla partecipazione alla gara per lo stesso lotto.

L'avv. Miniero in particolare ha precisato "... a mio parere val la pena che la CG svolga le proprie attività e si vada avanti quanto meno fino all'apertura delle offerte economiche e prima di quelle si potrebbe fare una nuova valutazione di opportunità".

Tutto ciò premesso il RUP, assistito dalla Sig.ra Pasquini procede a prelevare dalla piattaforma Net4Market le offerte tecniche delle seguenti ditte:

Lotto 4: Carbini srl; Delta Med spa.

Lotto 30: N.R. di Nannini srl; Pikdare spa

Lotto 31: Carbini srl; Delta Med spa; N.R. di Nannini srl; Vygon Italia srl

La suddetta documentazione tecnica sarà trasmessa alla Commissione Giudicatrice per il seguito di competenza.

Il RUP ore 11:45 dichiara conclusa l'attività odierna e, d'intesa con i membri della Commissione, contattati telefonicamente, fissa la prossima riunione per il giorno 25/8/2022 alle ore 10:00 presso l'Ospedale di Perugia studio del Presidente della Commissione Dr. Gori.

Verbale letto dal segretario verbalizzante e approvato dai presenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci

IL SUPPORTO

Sig.ra Brunella Pasquini

22

PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE CENTRALI E PERIFERICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE GARA ANAC 8452441

VERBALE 5

SEDUTA DI GARA DEI GIORNI 25/08/2022 – 13/09/2022 e 10/10/2022

ORE 10:00

Presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, Servizio di Anestesia e Rianimazione, è presente la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto nominata con Determina dell'Amministratore Unico dell'30/06/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Fabio Gori - Presidente
- Dr. Vittorio Cerotto - Membro
- Dr.ssa Emanuela Santuro - Membro

È presente inoltre il RUP Dr. Andrea Ciucci con funzioni di segretario verbalizzante e la collaboratrice, Sig.ra Pasquini Brunella dipendente di PuntoZero scarl.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione, dichiara aperta la seduta

Il RUP ricorda di avere inviato a tutti i presenti la documentazione di gara pubblicata comprensiva di Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte, nonché i files delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti. I componenti confermano di avere ricevuto i suddetti documenti e di avere preso atto degli stessi per un esame individuale propedeutico alla odierna valutazione collegiale.

I presenti concordano le modalità di svolgimento dei lavori ed in particolare stabiliscono che:

- preliminarmente si procederà alla verifica dei requisiti generici e le caratteristiche tecniche e i requisiti minimi previsti del Capitolato tecnico e negli allegati, nonché nel disciplinare di gara e condizioni di fornitura
- successivamente si passerà alla valutazione delle offerte tecniche con le modalità indicate negli atti di gara e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, del D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Presidente comunica che dai documenti di gara trasmessi dal RUP Dr. Andrea Ciucci, risulta che sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

Lotto 1	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA, MEDITREND S.N.C, SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 2	B.BRAUN MILANO SPA, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA,
Lotto 3	B.BRAUN MILANO SPA, GADA ITALIA SPA,
Lotto 4	Carbini srl, DELTA MED S.P.A,
Lotto 5	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 6	SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 7	SANITER BICE MARIOTTINI SRL,
Lotto 8	Vygon Italia s.r.l

23

Lotto 9	Vygon Italia s.r.l
Lotto 10	DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, Vygon Italia s.r.l
Lotto 11	Bard s.r.l, DELTA MED S.P.A,
Lotto 12	ASPEN SANITAS SRL, Bard s.r.l, DELTA MED S.P.A,
Lotto 13	B.BRAUN MILANO SPA, BENEFIS S.R.L,
Lotto 14	B.BRAUN MILANO SPA, BENEFIS S.R.L,
Lotto 15	B.BRAUN MILANO SPA, SANITER BICE MARIOTTINI SRL
Lotto 16	DESERTO
Lotto 17	B.BRAUN MILANO SPA, Bard s.r.l, Carbini srl, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L
Lotto 18	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L, Vygon Italia s.r.l
Lotto 19	B.BRAUN MILANO SPA, Carbini srl,
Lotto 20	ASPEN SANITAS SRL, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 21	Vygon Italia s.r.l
Lotto 22	BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, CAIR ITALIA SRL, DELTA MED S.P.A, MULTIMEDICAL SRL, TAU MEDICA SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 23	ASPEN SANITAS SRL, MULTIMEDICAL SRL,
Lotto 24	3M ITALIA SRL, ASPEN SANITAS SRL, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, Icu Medical Europe srl, TAU MEDICA SRL
Lotto 25	Bard s.r.l,
Lotto 26	Carbini srl, DELTA MED S.P.A, Vygon Italia s.r.l
Lotto 27	Bard s.r.l, Carbini srl, DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 28	B.BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, PIKDARE S.P.A, TAU MEDICA SRL
Lotto 29	BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, Carbini srl, N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,
Lotto 30	N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,
Lotto 31	Carbini srl, DELTA MED S.P.A, N.R. DI NANNINI SRL, Vygon Italia s.r.l
Lotto 32	Vygon Italia s.r.l
Lotto 33	Bard s.r.l, MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO
Lotto 34	Bard s.r.l, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 35	MEDTRONIC ITALIA SPA, NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L CON SOCIO UNICO, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,
Lotto 36	MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO,

La Commissione prende atto dei parametri di valutazione qualitativa che saranno oggetto di esame da parte dei singoli componenti indicati nel Capitolato tecnico.

La Commissione, altresì, prende atto dei criteri motivazionali che saranno alla base dei coefficienti di valutazione che i singoli componenti assegneranno ai singoli parametri di valutazione delle offerte tecniche così come individuati dagli artt. 2, 3 e 4 del Capitolato tecnico e dall'art. 17.2 del Disciplinare di gara che di seguito si trascrivono:

CRITERIO MOTIVAZIONALE	Descrizione criterio motivazionale	COEFFICIENTE
------------------------	------------------------------------	--------------

24

[Handwritten signatures and initials]

INADEGUATA	Soluzione proposta risulta inadeguata e non attinente a quanto richiesto ovvero requisito non valutabile per carenza di documentazione tecnica e/o campionatura	0
SCARSA	Soluzione proposta risulta inadeguata e poco attinente a quanto richiesto	0,2
INSUFFICIENTE	Soluzione proposta risponde in maniera insoddisfacente a quanto richiesto. Requisito trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	0,4
SUFFICIENTE	Soluzione proposta risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto. Requisito trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	0,6
BUONA	Soluzione proposta risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto. Requisito trattato in maniera più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	0,8
OTTIMA	Soluzione proposta risponde pienamente a quanto richiesto. Requisito trattato in maniera pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	1

Il presidente comunica che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte sono arrivati i plichi contenenti la campionatura da parte di tutti i suddetti operatori economici.

Successivamente la Commissione, dà inizio all'esame congiunto delle offerte tecniche procedendo preliminarmente alla verifica dei requisiti tecnici minimi previsti e successivamente alla valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentate dagli operatori economici concorrenti.

Si dà atto che la seduta:


- viene sospesa alle ore 12:15
- viene ripresa il giorno 13/9/2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:15
- viene ripresa il giorno 10/10/2022 dalle ore 10:30 alle ore 14:45 durante la quale si

procede, tra l'altro, all'esame delle offerte per i lotti 10 e 11 previa prova tecnica dei sistemi proposti dagli operatori economici offerenti che sono stati invitati a presentare lo strumentario (ditte DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO e VYGON ITALIA S.R.L, per il lotto 10 e ditte BARD S.R.L e DELTA MED S.P.A. per il lotto 11.) La Commissione prende atto che le ditte sono state convocate in orari differenziati dalle ore 10:30 alle ore 13:30 prevedendo un'ora a disposizione per ogni operatore economico.

Alle ore 10:30 sono presenti i Sigg. D'Andrea Giovanni e Robasto Giulia Identificati con documento d'identità (omissis) per la ditta BARD S.R.L di cui producono delega.

Alle ore 11:30 è presente il Sig. Pilotto Davide Identificato con documento d'identità (omissis) per la ditta SEDA S.P.A. di cui produce delega.

25

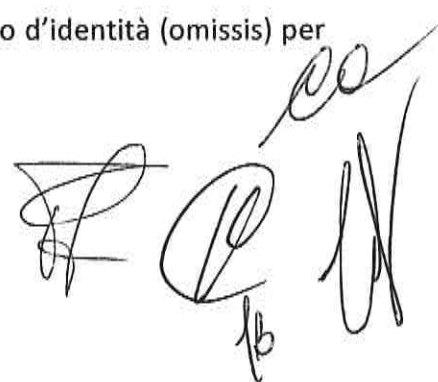

Alle ore 12:30 sono presenti i Sigg.ri Favaretto Elena e Marzola Matteo identificati con documento d'identità (omissis) per la ditta VYGON ITALIA S.R.L di cui producono delega.

Alle ore 13:30 nessuno è presente per la ditta DELTA MED S.P.A. - La Commissione attende fino alle 14:00, e considerato che nessuno si è presentato per la ditta Delta Med, regolarmente convocata con PEC, decide di assegnare zero punti al parametro Q5 del lotto 10 e al parametro Q6 del lotto 11.

Lotto n. 1

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, CARBINI SRL, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA, MEDITREND S.N.C, SANITER BICE MARIOTTINI SRL hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e sono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	70	70
CARBINI SRL	42	42
DELTA MED S.P.A	42	42
GADA ITALIA SPA	42	42
MEDITREND S.N.C	42	42
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	42	42

Lotto n.2

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, DELTA MED S.P.A, GADA ITALIA SPA, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	70	70
DELTA MED S.P.A	47	47
GADA ITALIA SPA	42	42

Lotto n.3

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, GADA ITALIA SPA, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	70	70
GADA ITALIA SPA	42	42

Lotto n.4

La ditta CARBINI SRL non viene ammessa alla fase di valutazione in quanto ha presentato prodotti non conformi alle caratteristiche minime previste: assenza di sistema di protezione dell'ago.

La ditta DELTA MED S.P.A. ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
DELTA MED S.P.A	42	70

Lotto n.5

La ditta B.BRAUN MILANO SPA, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	56	70

Lotto n.6

La ditta SANITER BICE MARIOTTINI SRL, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	53,6	70

Lotto n.7

La ditta SANITER BICE MARIOTTINI SRL, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	53,6	70

Lotto n.8

La ditta VYGON ITALIA S.R.L, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
VYGON ITALIA S.R.L	57	70

Lotto n.9

La ditta VYGON ITALIA S.R.L, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
VYGON ITALIA S.R.L	56	70

Lotto n.10

Le ditte DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, VYGON ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Preso atto delle offerte tecniche presentate e delle prove tecniche di utilizzo, dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
DELTA MED S.P.A	43	43
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	70	70
VYGON ITALIA S.R.L	64	64

Lotto n.11

Le ditte BARD S.R.L, DELTA MED S.P.A, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Preso atto delle offerte tecniche presentate e delle prove tecniche di utilizzo, dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BARD S.R.L	70	70
DELTA MED S.P.A	42	42

Lotto n.12

Le ditte ASPEN SANITAS SRL ,BARD S.R.L, DELTA MED S.P.A, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
ASPEN SANITAS SRL	70	70
BARD S.R.L	62	62
DELTA MED S.P.A	44	44

Lotto n.13

La ditta BENEFIS S.R.L non viene ammessa alla fase di valutazione in quanto ha presentato prodotti non conformi alle caratteristiche minime previste: manca il sistema di fissaggio e il cavo Ecg.

La ditta B.BRAUN MILANO SPA ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	60	70

Lotto n.14

La ditta BENEFIS S.R.L non viene ammessa alla fase di valutazione in quanto ha presentato prodotti non conformi alle caratteristiche minime previste: manca cavo Ecg.

La ditta B.BRAUN MILANO SPA ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	70	70

Lotto n.15

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	50	50
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	70	70

Lotto n.16

Nessuna offerta pervenuta - Lotto deserto -

Lotto n.17

La ditta CARBINI SRL non viene ammessa alla fase di valutazione in quanto ha presentato prodotti non conformi alle caratteristiche minime previste : manca la siringa graduata.

Le ditte BB.BRAUN MILANO SPA, BARD S.R.L, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	65	65
BARD S.R.L	70	70
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L	42	42

Lotto n.18

La ditta CARBINI SRL non viene ammessa alla fase di valutazione in quanto ha presentato prodotti non conformi alle caratteristiche minime previste: manca la siringa graduata.

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L, VYGON ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	70	70
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L	43	43
VYGON ITALIA S.R.L	59	59

Lotto n.19

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, CARBINI SRL, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

30

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Below it, several initials and signatures, including one that appears to be "Pa" and another "fb".

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	70	70
CARBINI SRL	43	43

Lotto n.20

Le ditte ASPEN SANITAS SRL, CARBINI SRL, DELTA MED S.P.A, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, VYGON ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
ASPEN SANITAS SRL	70	70
CARBINI SRL	44	44
DELTA MED S.P.A	57	57
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	61	61
VYGON ITALIA S.R.L	66	66

Lotto n.21

La ditta VYGON ITALIA S.R.L, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
VYGON ITALIA S.R.L	70	70

Lotto n.22

Le ditte BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, CAIR ITALIA SRL, DELTA MED S.P.A, MULTIMEDICAL SRL, TAU MEDICA SRL, VYGON ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70	70
BENEFIS S.R.L,	42	42
CAIR ITALIA SRL	60	60
DELTA MED S.P.A	60	60
MULTIMEDICAL SRL	54	54
TAU MEDICA SRL	42	42
VYGON ITALIA S.R.L	55	55

Lotto n.23

La ditta ASPEN SANITAS SRL non viene ammessa alla fase di valutazione in quanto ha presentato prodotto diverso rispetto a quanto richiesto nel capitolato (port protectors prodotto richiesto in gara per il lotto 24).

La ditta MULTIMEDICAL SRL, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
MULTIMEDICAL SRL	42	70

Lotto n.24

Le ditte 3M ITALIA SRL, ASPEN SANITAS SRL, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, ICU MEDICAL EUROPE SRL, TAU MEDICA SRL, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
3M ITALIA SRL	70	70
ASPEN SANITAS SRL	58	58
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	58	58
BENEFIS S.R.L	54	54
DELTA MED S.P.A	54	54
ICU MEDICAL EUROPE SRL	43	43
TAU MEDICA SRL	52	52

Lotto n.25

La ditta BARD S.R.L, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BARD S.R.L	56	70

Lotto n.26

Le ditte CARBINI SRL, DELTA MED S.P.A, VYGON ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
CARBINI SRL	43	43
DELTA MED S.P.A	66	66
VYGON ITALIA S.R.L	70	70

Lotto n.27

Le ditte BARD S.R.L, CARBINI SRL, DELTA MED S.P.A, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BARD S.R.L	70	70
CARBINI SRL	42	42
DELTA MED S.P.A	70	70
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	70	70

Lotto n.28

Le ditte B.BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, DELTA MED S.P.A, PIKDARE S.P.A, TAU MEDICA SRL, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
B.BRAUN MILANO SPA	63	63
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70	70
BENEFIS S.R.L,	44	44
DELTA MED S.P.A	48	48
PIKDARE S.P.A	45	45
TAU MEDICA SRL	42	42

Lotto n.29

Le ditte BECTON DICKINSON ITALIA SPA, BENEFIS S.R.L, CARBINI SRL, N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A,, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70	70
BENEFIS S.R.L	44	44

CARBINI SRL	44	44
N.R. DI NANNINI SRL	44	44
PIKDARE S.P.A	44	44

Lotto n.30

Le ditte N.R. DI NANNINI SRL, PIKDARE S.P.A, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
N.R. DI NANNINI SRL	42	70
PIKDARE S.P.A	42	70

Lotto n.31

Le ditte CARBINI SRL, DELTA MED S.P.A, N.R. DI NANNINI SRL, VYGON ITALIA S.R.L, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
CARBINI SRL	63	70
DELTA MED S.P.A	63	70
N.R. DI NANNINI SRL	63	70
VYGON ITALIA S.R.L	63	70

Lotto n.32

La ditta VYGON ITALIA S.R.L, ha presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e viene pertanto ammessa alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
VYGON ITALIA S.R.L	70	70

Lotto n.33

Le ditte BARD S.R.L, MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BARD S.R.L.	70	70
MEDTRONIC ITALIA SPA	64	64
QURE SRL	42	42
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	68	68

Lotto n.34

Le ditte BARD S.R.L, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BARD S.R.L.	70	70
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	70	70

Lotto n.35

Le ditte MEDTRONIC ITALIA SPA, NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L CON SOCIO UNICO, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA SPA	61,2	69,77
NIPRO MEDICAL ITALY S.R.L CON SOCIO UNICO	60,8	69,31
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	61,4	70

Lotto n.36

Le ditte MEDTRONIC ITALIA SPA, QURE SRL, SEDA SPA CON SOCIO UNICO, hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e vengono pertanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate, nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI ASSEGNATI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
MEDTRONIC ITALIA SPA	65	65
QURE SRL	59,6	59,6
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	70	70

Alle ore 14:50 del giorno 10/10/2022 il Presidente dà atto che la Commissione ha concluso i lavori di valutazione delle offerte tecniche e , pertanto, dichiara chiusa la seduta.
Verbale redatto, letto e sottoscritto per approvazione.

La Commissione Giudicatrice
Dr. Fabio Gori - Presidente



Dr. Vittorio Cerotto - Membro



Dr.ssa Emanuela Santuro - Membro



L'ASSISTENTE DEL RUP
Sig.ra Brunella Pasquini



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dr. Andrea Ciucci



LOTTO 1

AGO CATETERE ARTERIA RADIALE G 20

Ago-cannula arteriosa in materiale biocompatibile termosensibile, adatta al posizionamento in arteria radiale e/o al monitoraggio emodinamico in confezione sterile, monouso


- ago a triplice affilatura tale da attraversare facilmente gli strati cutanei e la parete arteriosa e dotato di dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali
- la cannula deve essere dotata di dispositivo di sicurezza contro le perdite ematiche accidentali
- misure 20 G, lunghezza non inferiore a 3,5 cm e non superiore a 7 cm
- documentata tenuta delle connessioni durante l'utilizzo del catetere; conformità della conicità 6% (luer)

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Facilità e sicurezza d'impianto (maneggevolezza, scorrevolezza del catetere) **PUNTI 20**
2. Caratteristiche del catetere (struttura, capacità antikinking, atraumaticità ed indeformabilità della punta, dimensione delle alette di fissaggio, ergonomicità del cono) **PUNTI 30**
3. Funzionalità (facilità di stabilizzazione del catetere, buon mantenimento in situ) **PUNTI 20**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	70
CARBINI	0.6	0.6	0.6	42
DELTAMED	0.6	0.6	0.6	42
GADA	0.8	0.6	0.4	42
MEDITREND	0.8	0.6	0.4	42
SANITER	0.8	0.6	0.4	42

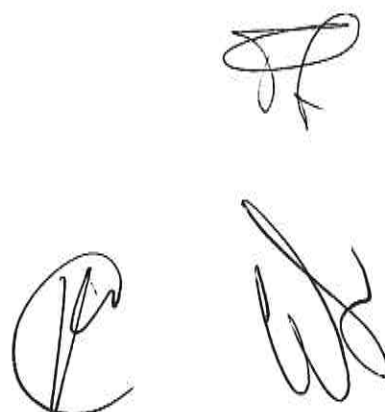

LOTTO 2

AGO CANNULA ARTERIA RADIALE DI SICUREZZA

AGO CANNULA VALVOLATO PER ACCESSO ARTERIOSO RADIALE

CONFEZIONAMENTO SINGOLO, STERILE, MONOUSO, LATEX FREE, DEHP FREE, INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE CHIARE E LEGGIBILI.

- Cannula in idoneo materiale biocompatibile flessibile, resistente alla torsione, radiopaco
- Cannula lunga 5cm circa
- Cannula con sistema chiuso: chiusura del setto una volta rimosso l'ago
- Il setto della cannula deve permettere accesso multiplo
- Ago cannula con camera di reflusso trasparente per poter verificare il momento della puntura arteriosa
- Alette di fissaggio

-Ago introduttore in acciaio inox atraumatico,

SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO AD ATTIVAZIONE PASSIVA CHE DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- DEVE ESSERE PARTE INTEGRANTE DEL DISPOSITIVO E NON UN ACCESSORIO
- DURANTE L'ATTIVAZIONE LE MANI DELL'OPERATORE DEVONO TROVARSI SEMPRE IN POSIZIONE ARRETRATA RISPETTO ALL'AGO

Ago cannula 20G x 45mm

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. CARATTERISTICHE AGO E CATETERE: memoria in caso di inginocchiamento, robustezza dell'ago, affilatura dell'ago, radiopacità del catetere, ergonomia, trasparenza della camera di reflusso **Punti 25**
2. COMPETENZA DEL SISTEMA ANTIREFLUSSO: tenuta del sistema dopo utilizzo multiplo in operazioni di prelievo e/o monitoraggio cruento pressione arteriosa. **Punti 20**
3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI SICUREZZA: attivazione dispositivo verificabile in modo uditivo e visivo, efficienza del meccanismo di sicurezza (non disattivabile), facilità d'uso. **Punti 20**
4. ASSISTENZA POST-VENDITA: assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **Punti 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	1	70
DELTAMED	0.6	0.6	0.6	1	47
GADA	0.6	0.6	0.4	0.8	42



LOTTO 3

AGO CANNULA ARTERIA RADIALE PEDIATRICO NEONATALE DI SICUREZZA

AGO CANNULA VALVOLATO PER ACCESSO ARTERIOSO RADIALE

CONFEZIONAMENTO SINGOLO, STERILE, MONOUSO, LATEX FREE, DEHP FREE

-Cannula in idoneo materiale biocompatibile flessibile, resistente alla torsione, radiopaco

-Cannula lunga 5cm circa

-Cannula con sistema chiuso: chiusura del setto una volta rimosso l'ago

-Il setto della cannula deve permettere accesso multiplo

-Ago cannula con camera di reflusso trasparente per poter verificare il momento della puntura arteriosa

-Alette di fissaggio

-Ago introduttore in acciaio inox atraumatico,

SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO AD ATTIVAZIONE PASSIVA CHE DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- DEVE ESSERE PARTE INTEGRANTE DEL DISPOSITIVO E NON UN ACCESSORIO

- DURANTE L'ATTIVAZIONE LE MANI DELL'OPERATORE DEVONO TROVARSI SEMPRE IN POSIZIONE ARRETRATA RISPETTO ALL'AGO

-L'ATTIVAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE VERIFICABILE DALL'OPERATORE MEDIANTE SEGNALE VISIVO E ACUSTICO DI AVVENUTA ATTIVAZIONE, ESSERE SEMPLICE MANEGGEVOLE, VELOCE SICURO E DEVE AVVENIRE AL PRIMO TENTATIVO SENZA INTERVENTO ATTIVO DELL'OPERATORE

-NON DEVE POTER ESSERE DISATTIVATO

Ago cannula 24G x 19mm

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. CARATTERISTICHE AGO E CATETERE: memoria in caso di inginocchiamento, robustezza dell'ago, affilatura dell'ago, radiopacità del catetere, ergonomia, trasparenza della camera di reflusso **Punti 25**

2. COMPETENZA DEL SISTEMA ANTIREFLUSSO: tenuta del sistema dopo utilizzo multiplo in operazioni di prelievo e/o monitoraggio cruento pressione arteriosa. **Punti 20**

3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI SICUREZZA: attivazione dispositivo verificabile in modo uditivo e visivo, efficienza del meccanismo di sicurezza (non disattivabile), facilità d'uso. **Punti 20**

4. ASSISTENZA POST-VENDITA: assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **Punti 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	1	70
GADA	0.6	0.6	0.6	0.6	42





LOTTO 4

DISPOSITIVO PER L'ACCESSO ARTERIOSO RADIALE DOTATO DI INTERRUITTORE DI FLUSSO

Cannula in Teflon (PTFE) siliconato a doppia svasatura, con ago interno estraibile in acciaio, dotato di sfaccettatura dorsale (back-out grinding) per ridurre il trauma. Il dispositivo, al fine di aumentare la sicurezza del paziente, una volta impiantato, deve essere riconoscibile attraverso il colore rosso per distinguerlo dall'accesso venoso.

- Interruttore rapido di flusso .
- Alette flessibili dotate di fori di fissaggio (con cerotto adesivo o con filo di sutura).
- Sistema di protezione dell'ago
- Calibro 20G; lunghezza minima della cannula 45mm

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Facilità e sicurezza d'impianto (maneggevolezza, scorrevolezza del catetere) **PUNTI 20**
2. Caratteristiche del catetere (struttura, capacità antikinking, atraumaticità ed indeformabilità della punta, dimensione delle alette di fissaggio) **PUNTI 40**
3. Funzionalità ed efficacia del sistema di sicurezza dell'ago. Test tecnico. **PUNTI 10**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	TOTALE
DELTAMED	0.6	0.6	0.6	42

40

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'F' and other illegible marks.

LOTTO 5

KIT PER CATETERIZZAZIONE ARTERIOSA CON TECNICA SELDINGER E VALVOLA ANTIREFLUSSO

Set incannulamento arterioso con tecnica seldinger, catetere valvolato con prolunga integrata, alette di fissaggio morbide non rimovibili, seldinger a punta retta, idoneo per monitoraggio invasivo e campionamento ematico, confezionamento singolo sterile, monouso, latex free, dehp free, calibri 18-22g e diverse lunghezze da 80mm ad 160mm come intervallo minimo idoneo

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Competenza della valvola antireflusso (l'assenza di reflusso in mancanza di aspirazione attiva verrà giudicata con punteggio maggiore) **Punti 25**
2. Disponibilità di lunghezze variabili >6cm e calibri variabili. **Punti 20**
3. Elementi tecnici del kit di introduzione: ago, guida metallica (punteggio maggiore per guide metalliche rette, test di utilizzo dell'ago) **Punti 20**
4. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **Punti 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
BBRAUN	0.8	0.8	0.8	0.8	56

h1

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 6

KIT PER CATETERIZZAZIONE ARTERIOSA RADIALE CON TECNICA SELDINGER

Kit composto da:

-Catetere arterioso in poliuretano, centimetrato, radiopaco, lunghezza non più di 10 cm con prolunga trasparente con terminale LLF integrata alla cannula; con presenza di camera per la rapida visualizzazione del flusso ematico arterioso

- Ago in acciaio inossidabile G20-22

- Guida metallica con punta a "J" e retta

- Tappo luer lock

Tecnica di introduzione Seldinger

MONOUSO STERILE LATEX FREE

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Facilità di impianto, di inserimento (Il dispositivo può essere facilmente impiantato, anche in casi più complicati. Buona pushability (caratteristiche di avanzamento intravenoso) **Punti 12**

2. Caratteristiche del catetere (Corpo catetere costante Presenza guaina protettiva sul corpo del catetere Resistenza al kinking e alla rottura; minor rapporto lume esterno/interno; punta distale morbida Marcatura chiaramente visibile e presente su tutta la lunghezza (Interamente radiopaco) **Punti 24**

3. Caratteristiche ago/guida (Maggior potere di penetrazione dell'ago e minore traumaticità della punta della guida) **Punti 20**

4. Completezza del kit (presenza di elementi aggiuntivi oltre i richiesti) **Punti 8**

5. Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.) Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura. Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse. Disponibilità di documenti che permettano la rintracciabilità del DM (etichetta paziente, diario delle infusioni, opuscolo informativo per il paziente) **Punti 6**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
SANITER	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	53.6

h2

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a large, stylized signature. Below it, on the left, is a circular stamp or signature. To the right of the stamp is another signature. At the bottom right, there are two more signatures, one of which appears to be a stylized 'W' or 'K'.

LOTTO 7

KIT PER CATETERIZZAZIONE ARTERIOSA FEMORALE CON TECNICA SELDINGER

Kit composto da:

- Catetere arterioso in poliuretano centimetrato radiopaco lunghezza tra 15 cm e 25 cm circa con prolunga trasparente con terminale LLF integrata alla cannula
- Ago in acciaio inossidabile G18-20
- Guida metallica con punta a "J" e retta
- Tappo luer lock

Tecnica introduzione Seldinger, sistema di blocco del flusso

MONOUSO STERILE LATEX FREE

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Facilità di impianto, di inserimento (Il dispositivo può essere facilmente impiantato, anche in casi più complicati. Buona pushability ,caratteristiche di avanzamento intravenoso) **Punti 12**
2. Caratteristiche del catetere: Corpo catetere costante; -Presenza guaina protettiva sul corpo del catetere; - Resistenza al kinking e alla rottura; -Minor rapporto lume esterno/interno; -Punta distale morbida; -Marcatura chiaramente visibile; -Marcatura presente su tutta la lunghezza (Interamente radiopaco) **Punti 24**
3. Caratteristiche ago/guida (Maggior potere di penetrazione dell'ago e minore traumaticità della punta della guida) **Punti 20**
4. Completezza del kit (presenza di elementi aggiuntivi oltre i richiesti) **Punti 8**
5. Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.) (Robustezza del confezionamento primario; Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura; Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse Disponibilità di documenti che permettano la rintracciabilità del DM (etichetta paziente, diario delle infusioni, opuscolo informativo per il paziente) **Punti 6**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
SANITER	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	53.6

L3

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature that appears to be 'F'. Below it, there are two more signatures, one of which is a large, stylized 'R' followed by 'W'.

LOTTO 8

CATETERE OMBELICALE IN POLIURETANO

CATETERE OMBELICALE IN POLIURETANO, MUNITO DI RUBINETTO A DUE VIE CON MARCATURA CENTIMETRICA. PER NEONATOLOGIA.

CONFEZIONE SINGOLA, MONOUSO, STERILE, LATEX FREE, SENZA FTALATI

-Catetere in poliuretano trasparente ad esclusivo uso medicale, resistenti ai lipidi, morbidi, termosensibili.

Tempo dichiarato di permanenza in situ;

-Catetere radiopaco; la sostanza utilizzata per rendere radiopaco il catetere non deve interagire con i farmaci infusi e/o essere ceduta al plasma;

-Il Catetere deve essere centimetrato con indicazione numerica ad ogni centimetro

- Munito di rubinetto a due vie e reperi di identificazione (rosso arterioso, blu venoso)

Lunghezza compresa tra cm 30 e cm 38 e diametro CH 2,5/3,5/5.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualità/caratteristiche del materiale del catetere (struttura, capacità antikinking, scorrevolezza, marcatura chiaramente visibile e presente su tutta la lunghezza, atraumaticità e morbidezza della punta) **PUNTI 30**

2. Facilità di impianto, di inserimento, di stabilizzazione e mantenimento in situ. **PUNTI 20**

3. Completezza dell'offerta per tutte le misure richieste. **PUNTI 5**

4. Confezionamento (robustezza del confezionamento, completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse, maneggevolezza nell'apertura). **PUNTI 10**

5. Assistenza e formazione post vendita, inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori. **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
VYGON	0.8	0.8	0.8	0.8	1	57

hh

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 9

CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO MONOLUME NEONATALI

CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO A LUNGO TERMINE. PER NEONATOLOGIA. CONFEZIONAMENTO PRIMARIO SINGOLO, STERILE, MONOUSO, LATEX FREE, SENZA FTALATI

- Catetere in poliuretano o idoneo materiale di qualità certificata ad alta biocompatibilità, trasparente ad esclusivo uso medicale, morbido, termosensibile. Tempo dichiarato di permanenza in situ;
- Catetere radiopaco su tutta la lunghezza; la sostanza utilizzata per rendere radiopaco il catetere non deve interagire con i farmaci infusi e/o essere ceduta al plasma;
- Catetere centimetrato con marcatura che consenta di verificare chiaramente la lunghezza introdotta e di accertarsi della completa rimozione dell'intero catetere
- Prolunga integrata
- Alette di fissaggio
- Sistema di introduzione (catetere in set completo di ago introduttore (ago apribile o ago cannula), siringa 10 ml, raccordo che permette di collegare la siringa all'ago introduttore se necessario)

Catetere 1 Fr 20 cm

Catetere 2 Fr 30 cm

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Facilità di impianto, di inserimento (Il dispositivo può essere facilmente impiantato, anche in casi più complicati. Buona pushability caratteristiche di avanzamento intravenoso) **Punti 12**
2. Caratteristiche del catetere: costante Presenza guaina protettiva sul corpo del catetere Resistenza al kinking e alla rottura; Minor rapporto lume esterno/interno; Punta distale morbida Marcatura chiaramente visibile; Marcatura presente su tutta la lunghezza; Interamente radiopaco **Punti 24**
3. Caratteristiche ago/guida (Maggior potere di penetrazione dell'ago e minore traumaticità della punta della guida) **Punti 20**
4. Completezza del kit (presenza di elementi aggiuntivi oltre i richiesti) **Punti 8**
5. Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.) (Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse Disponibilità di documenti che permettano la rintracciabilità del DM (etichetta paziente, diario delle infusioni,opuscolo informativo per il paziente) **Punti 6**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
VYGON	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	56

LS

LOTTO 10

CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO MONOLUME E BILUME CON COMODATO D'USO DI SISTEMA PER ECG INTRACAVITARIO ED ECOGRAFO

Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC), in PUR power Injectable (325psi), Reverse Taper prossimale minimo o assente e punta aperta distale. Compatibilità dichiarata con farmaci antitumorali compresi i taxani e soluzioni alcoliche.

Catetere radiopaco, centimetrato di lunghezza compresa tra 40-60 cm, completo di sistema di micro-introduzione composto da guida da 0,018 lunga 40-60 cm con tratto in nitinol, introduttore peel-away, ago 21 gauge ecogenico dotato di dispositivo di sicurezza, dispositivo di fissaggio del catetere sutureless, needless a pressione neutra o positiva al distacco.

Misure richieste: 3-4-5-Fr Monolume 5-6 Fr Bilume

Il catetere dovrà avere indicazioni chiare sulla resistenza ad alte pressioni di infusione sulla superficie o sulla clamp. I relativi accessori (Ago, Guida, Bisturi, Micro-Introduttore, Metro di carta, dispositivo Sutureless, needless, siringa 10ml) dovranno essere contenuti in un'unica, singola, confezione sterile.

SISTEMA ECG INTRACAVITARIO:

dotato di pad o notebook, trasduttore e cavi ecg, presenza a schermo delle due tracce contemporanee di ecg intra ed extracavitario, contestualizzazione con dati antropometrici del paziente e dati catetere, possibilità di trasmissione ecg via mail o bluetooth.

ECOGRAFO:

portatilità, sonda lineare, nitidezza di immagine e definizione, semplicità di settaggio, valutati in test tecnico nei parametri di qualità.

CRITERI QUALITÀ E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Completezza di certificazioni di compatibilità e stabilità tra i materiali costituenti il dispositivo offerto e i farmaci, anche in soluzione alcolica - **Punti 15**
2. Reverse tapering ottimale del catetere (punteggio maggiore al RT minore o assente) - **Punti 15**
3. Elementi tecnici del kit di introduzione: metro, guida metallica a punta retta; lunghezza del tratto in nitinol; siringa luer-lock, needless in dotazione - **Punti 15**
4. Test qualità dei sutureless contenuti nei kit (punteggio maggiore ai kit con sutureless di migliore qualità: adesività, foam, velcro o alette rigide di ancoraggio) - **Punti 5**
5. Qualità del sistema ECG e stabilità del tracciato, integrazione del dispositivo, qualità visione ecografica, attinenza procedura di impianto e documentazione finale, prova tecnica di utilizzo del singolo operatore **Punti 15**
6. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori - **Punti 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	TOTALE
VYGON	1	0.8	1	1	0.8	1	64
DELTAMED	0.6	0.6	1	1	0	1	43
SEDA	1	1	1	1	1	1	70

46

LOTTO 11

CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO MONOLUME E MULTILUME PER IMPIANTO BED-SIDE CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE IN COMODATO

Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC), in PUR power Injectable, con presenza di Reverse Taper prossimale e punta aperta distale. Compatibile con l'esecuzione della Tip Navigation magnetica e Tip Location tramite ECG Intracavitario, comprensivo di kit procedurale di impianto in un unico, singolo, confezionamento sterile, completo di massime misure di barriera.

Misure richieste:

3 - 4 - 5 Fr MONOLUME

4 - 5 Fr BILUME

5 - 6 Fr TRILUME

La ditta aggiudicatrice, dovrà fornire, in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto, un sistema, composto da Ecografo e sistema di Tip Navigation e Tip Location. Il sistema deve possedere chiara indicazione d'uso, atta alla verifica del corretto posizionamento dei Picc con possibilità di non esecuzione della radiografia del torace post-procedura, certificazione di sicurezza e supporto bibliografico scientifico che ne indichi la necessità di utilizzo.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualità del confezionamento del KIT con particolare riferimento alla presenza di tutti i componenti in un unica, singola, confezione sterile recante un unica data di scadenza, con facilità e sicurezza di apertura in sterilità, posizionamento dei presidi nella confezione e presenza di etichettatura identificativa di catetere e lotto, chiara identificazione delle caratteristiche power sul dispositivo, presenza di documentazione delle caratteristiche power, card identificativa per il paziente e IFU Multilingue. **PUNTI 10**

2. Caratteristiche del catetere, con riferimento al materiale, alla comprovata compatibilità con i MDC attualmente in commercio, la qualità del Reverse Taper attraverso documentazione specifica, chiara identificazione della power Injection e qualità dello stiletto premontato **PUNTI 10**

3. Qualità dell'ago introduttore con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità, sistema di sicurezza integrato, tagliente con sistema di sicurezza e trimmer per il taglio preciso del catetere **PUNTI 10**

4. Qualità del supporto formativo (valutazione dell'esperienza clinica e formativa del personale aziendale in termini di titoli, training effettuati, offerta formativa a supporto on-site ed on-line, il numero di studi clinici riguardanti il dispositivo in oggetto) **PUNTI 10**

5. Qualità del kit di microintroduzione: ago con punta ecogenica, guida in nitinol con soft straight tip, qualità del dilatatore con riferimento alle caratteristiche del corretto attraversamento della cute senza deformazioni e al sistema di blocco, lunghezza del microintroduttore (max 5-7cm) **PUNTI 10**

6. Qualità del sistema proposto in comodato d'uso che, in termini di semplicità di utilizzo, standardizzazione della procedura, sicurezza, mantenimento della sterilità durante l'utilizzo e materiale scientifico di supporto. Sarà valutato in maniera migliore un sistema unico, portatile, che integri tecnologia ad ultrasuoni e Tecnologia per la Tip Navigation e Location **PUNTI 20**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	TOTALE
BARD SRL	1	1	1	1	1	1	70
DELTAMED	1	0.6	1	0.6	1	0	42

h7

LOTTO 12

CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO CON KIT RADIOLOGICO

Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC), in PUR power Injectable, con presenza di Reverse Taper prossimale e punta aperta distale. Catetere radiopaco, centimetrato di lunghezza compresa tra 40 - 60 cm, completo di sistema di micro-introduzione composto da guida da 0,018 lunga 70 cm in nitinol, introduttore peel-away da 10cm, ago 21 gauge ecogenico dotato di dispositivo di sicurezza e dispositivo di fissaggio del catetere sutureless.

Misure richieste: 3-4-5-Fr Monolume 4-5 Fr Bilume 5-6 Fr Trilume

Il catetere, con i relativi accessori (Ago, Guida, Bisturi, Micro-Introduttore, Metro di carta, dispositivo Sutureless) dovranno essere contenuti in un'unica, singola, confezione sterile.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Caratteristiche del catetere, con riferimento al materiale, alla comprovata compatibilità con i MDC attualmente in commercio, la qualità del Reverse Taper attraverso documentazione specifica, chiara identificazione della power Injection ed elevati flussi per gravità **PUNTI 20**
2. Qualità dell'ago introduttore con riferimento alla capacità di attraversare i tessuti con facilità, sistema di sicurezza integrato, tagliente con sistema di sicurezza **PUNTI 20**
3. Qualità del supporto formativo (valutazione dell'esperienza clinica e formativa del personale aziendale in termini di titoli, training effettuati, offerta formativa a supporto on-site ed on-line, il numero di studi clinici riguardanti il dispositivo in oggetto) **PUNTI 10**
4. Qualità del kit di microintroduzione: ago con punta ecogenica, guida in nitinol con soft straight tip, qualità del dilatatore con riferimento alle caratteristiche del corretto attraversamento della cute senza deformazioni e al sistema di blocco, lunghezza del microintroduttore (max 5-7cm) **PUNTI 20**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
ASPEN	1	1	1	1	70
BARD SRL	1	1	1	0.6	62
DELTAMED	0.8	0.8	0.8	0.2	44

48

LOTTO 13

CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI PEDIATRICI

CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO, IN POLIURETANO o idoneo materiale di qualità certificata ad alta biocompatibilità, RADIOPACO, calibri da 3 a 5 Fr, diverse lunghezze, monolume, bilume, trilume

KIT COMPLETO DI:

- CATETERE
 - GUIDA ELICOIDALE DOPPIA PUNTA, DITTA E A J
 - SISTEMA INTRODUTTORE
 - CLAMP FISSAGGIO CATETERE
 - AGO INTRODUTTORE 21 G X 4 CM CIRCA
 - AGO CANNULA 22G X 4,5 CM CIRCA
 - CAVO ECG
 - SISTEMA DI FISSAGGIO SUTURELESS
- CONFEZIONAMENTO SINGOLO, MONOUSO, STERILE, LATEX FREE

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Guida metallica: flessibilità, possibilità di utilizzo di entrambe le estremità, grado di memoria in fase di piegamento **PUNTI 20**
2. Test qualità introduttore: rigidità, incremento graduale del diametro **PUNTI 20**
3. Trasparenza del tratto esterno delle vie infusionali ed affilatura dell'ago **PUNTI 15**
4. Test qualità sutureless **PUNTI 10**
5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BBRAUN	0.8	0.8	1	0.8	1	60

h9

LOTTO 14

CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI MONOLUME, BILUME, A TRE LUMI E QUATTRO LUMI

RIFERIMENTO A

CATETERE VENOSO CENTRALE 1-2 LUMI, IN POLIURETANO o idoneo materiale di qualità certificata ad alta biocompatibilità, resistente all'inginocchiamento, RADIOPACO, MARCATURA CENTIMETRICA, punta morbida.

KIT COMPLETO DI:

Cateteri di lunghezze da 15 a 30 cm e calibri da 4 a 7 F

Ago introduttore con sistema di sicurezza attivo e/o con valvola

Dilatatore

Needless se presenti con sistema luer lock

Bisturi se presente con sistema di sicurezza

Guida in nitilon con punta a J e punta retta, con marker centimetrico e marker ecg, lunghezze correlate alla lunghezza dei cateteri.

Cavo ECG, Siringa 5ml, Aletta di fissaggio

CONFEZIONAMENTO SINGOLO, MONOUSO, STERILE,

LATEX FREE

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO SINGOLO STERILE MONOUSO

RIFERIMENTO B

CATETERE VENOSO CENTRALE 3-4 LUMI, IN POLIURETANO o idoneo materiale di qualità certificata ad alta biocompatibilità, resistente all'inginocchiamento, RADIOPACO, MARCATURA CENTIMETRICA, punta morbida.

fare sub lotti

KIT COMPLETO DI:

Cateteri di lunghezze da 15 a 30 cm e calibri da 7 a 12 F

Valvole needless (1 per ogni via) contenute nella confezione sterile con attacco luer lock

Ago introduttore con sistema di sicurezza attivo e/o con valvola

Bisturi di sicurezza, Dilatatore

Guida in nitilon con punta a J e punta retta, con marker centimetrico e marker ecg, lunghezze correlate alla lunghezza dei cateteri.

Cavo ECG, Siringa 5ml, Aletta di fissaggio

CONFEZIONAMENTO SINGOLO, MONOUSO, STERILE, LATEX FREE

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Guida metallica: flessibilità, possibilità di utilizzo di entrambe le estremità, grado di memoria in fase di piegamento **PUNTI 20**

2. Test qualità introduttore: rigidità, incremento graduale del diametro **PUNTI 20**

3. Trasparenza del tratto esterno delle vie infusionali ed affilatura dell'ago **PUNTI 15**

4. Cavo ecg sterile presente nella confezione **PUNTI 10**

5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	1	1	70

50

LOTTO 15

CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI A CINQUE LUMI

CATETERE VENOSO CENTRALE 5 LUMI, IN POLIURETANO o idoneo materiale di qualità certificata ad alta biocompatibilità, resistente all'inghinocchiamento, RADIOPACO, MARCATURA CENTIMETRICA, punta morbida. fare sub lotti

KIT COMPLETO DI:

Catetere di lunghezza 20 cm circa e calibro 12 F

Valvola needless (1 per ogni via) contenuta nella confezione sterile con attacco luer lock

Ago introduttore con sistema di sicurezza attivo e/o con valvola

Bisturi di sicurezza

Dilatatore

Guida in nitilon con punta a J e punta retta, con marker centimetrico e marker ecg, lunghezze correlate alla lunghezza dei cateteri.

Cavo ECG

Siringa 5ml

Aletta di fissaggio

CONFEZIONAMENTO SINGOLO, MONOUSO, STERILE, LATEX FREE

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Guida metallica: flessibilità, possibilità di utilizzo di entrambe le estremità, grado di memoria in fase di piegamento **PUNTI 20**

2. Test qualità introduttore: rigidità, incremento graduale del diametro **PUNTI 20**

3. Trasparenza del tratto esterno delle vie infusionali ed affilatura dell'ago **PUNTI 15**

4. Cavo ecg sterile presente nella confezione **PUNTI 10**

5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BBRAUN	0.6	0.4	1	1	1	50
SANITER	1	1	1	1	1	70

51



LOTTO 17

SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI CON MONOCAMERA RADIO-TRASPARENTE

Sistema di accesso ad alto flusso 5ml/sec circa, resistente a pressioni di 300 PSI circa. Il sistema deve essere costituito da:

- dispositivo impiantabile in materiale plastico radiotrasparente a profilo basso fino a 12 mm circa, a setto perforabile con ago di Huber; presenza di simbolo e scritta radiopachi per la corretta identificazione ai raggi X;
- catetere in PUR, radiopaco a punta aperta, non valvolato, centimetrato, disponibile nei calibri da 6 ad 8F;
- ago per venipuntura;
- filo guida metallico con punta flessibile a J;
- dilatatore di calibro compatibile con il lume del catetere e sistema di introduzione tipo peel away, siringa graduata in materiale plastico "medical grade" di circa 10 ml;
- tunnellizzatore in acciaio inox, aghi di Huber;

Confezione: monouso. Sterile, latex free, PVC free, DEHP free.

Dichiarazione di compatibilità con RMN.


CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Camera: forma rastremata, dimensioni, superficie regolare **PUNTI 10**
2. Setto in silicone: diametro del setto e sua posizione rispetto alla camera; preferibilmente con punti di repere identificativi tattili. **PUNTI 25**
3. Sistema di connessione catetere/porta: presenza nel kit di doppio connettore anti-inguincchiamento per garantire utilizzabilità. Consistenza ed efficienza del sistema di connessione. **PUNTI 15**
4. Guida: flessibilità e maneggevolezza. Introduttore: flessibilità e maneggevolezza. Set infusione con ago non carotante resistente ad alte pressioni di infusione. **PUNTI 15**
5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BBRAUN	1	0.8	1	1	1	65
BARD	1	1	1	1	1	70
SMITHS	0.6	0.4	0.4	1	1	42

52

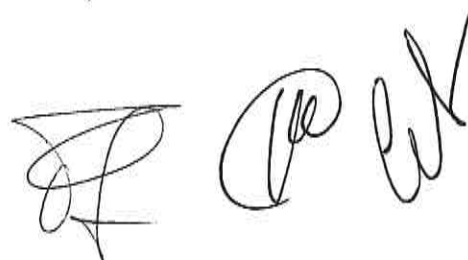

LOTTO 18

SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI MONOCAMERA PROFILO STANDARD E BASSO

Sistema di accesso ad alto flusso 5ml/sec circa, resistente a pressioni di 325 PSI circa con marker radiopaco di identificazione.

Il sistema deve essere costituito da:

dispositivo impiantabile con camera in titanio, a profilo standard fino a 14 mm circa e basso profilo fino a 12mm, a setto perforabile di ampio diametro;

catetere in PUR o silicone, radiopaco a punta aperta, non valvolato, centimetrato, disponibile nei calibri 5-8F; ago per venipuntura;

filo guida metallico con doppia punta flessibile retta ed a J;

aghi di Huber;

dilatatore di calibro compatibile con il lume del catetere e sistema di introduzione tipo peel away, siringa graduata in materiale plastico "medical grade" di circa 10 ml;

tunnellizzatore in acciaio inox;

Confezione: monouso. Sterile, latex free, PVC free, DEHP free.

Dichiarazione di compatibilità con RMN.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Camera: forma rastremata, dimensioni, superficie regolare **PUNTI 15**

2. Setto in silicone: diametro del setto e sua posizione rispetto alla camera (punteggio maggiore per diametri maggiori e posizione in altorilievo rispetto alla camera) **PUNTI 20**

3. Sistema di connessione catetere/porta: presenza nel kit di doppio connettore anti-inginocchiamento per garantire utilizzabilità. Consistenza ed efficienza del sistema di connessione. **PUNTI 15**

4. Guida: flessibilità e maneggevolezza. Introduttore: flessibilità e maneggevolezza. Set infusione con ago non carotante resistente ad alte pressioni di infusione. **PUNTI 15**

5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	1	1	70
SMITHS	0.6	0.4	0.4	1	1	43
VYGON	0.8	0.6	1	1	1	59

53

LOTTO 19

SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI MONOCAMERA PROFILO BASSISSIMO (PICC PORT)

Sistema di accesso ad alto flusso 5ml/sec circa, resistente a pressioni di 300 PSI circa. Il sistema deve essere costituito da:

dispositivo impiantabile in materiale biocompatibile con camera in titanio, a bassissimo profilo con camera di altezza massima di 9mm e setto perforabile in silicone;

catetere in PUR, radiopaco a punta aperta, non valvolato di calibri compresi tra 4F e 5F;

ago per venipuntura;

filo guida in nitilon con punta retta o con doppia punta (J e retta);

dilatatore di calibro compatibile con il lume del catetere e sistema di introduzione tipo peel away, siringa

graduata in materiale plastico "medical grade" di circa 10 ml;

tunnellizzatore in acciaio inox, aghi di Huber;

Confezione: monouso. Sterile, latex free, PVC free, DEHP free

Dichiarazione di compatibilità con RMN.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Camera: forma rastremata, dimensioni, superficie regolare **PUNTI 15**

2. Setto in silicone: diametro del setto e sua posizione rispetto alla camera (punteggio maggiore per diametri maggiori e posizione in altorilievo rispetto alla camera) **PUNTI 20**

3. Sistema di connessione catetere/porta: presenza nel kit di doppio connettore anti-inginocchiamento per garantire utilizzabilità. Consistenza ed efficienza del sistema di connessione. **PUNTI 15**

4. Guida: flessibilità e maneggevolezza. Introduttore: flessibilità e maneggevolezza. Set infusione con ago non carotante resistente ad alte pressioni di infusione. **PUNTI 15**

5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	1	1	70
CARBINI	1	0.4	0.2	0.8	1	43

54

LOTTO 20

KIT PER MICROINTRODUZIONE STANDARD

Kit costituito da:

- ago 21G lunghezza circa 7cm con punta ecogenica provvisto di dispositivo di sicurezza
 - guida metallica in nitilon con punta retta 0,46mm di lunghezza 40cm circa
 - dilatatore ed introduttore peel-away
 - bisturi di sicurezza e siringa
- calibri a partire da 3F fino a 5F come intervallo minimo

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Test tecnico del dilatatore-introduttore (flessibilità, dislivello minimo, apertura peel-away) **PUNTI 25**
2. Test tecnico della guida in nitilon (lunghezza del tratto in nitilon) **PUNTI 20**
3. Test tecnico ecogenicità dell'ago **PUNTI 20**
4. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
ASPEN SANITAS	1	1	1	1	70
CARBINI	0.6	0.8	0.4	1	44
DELTAMED	0.8	0.8	0.8	1	57
SANITER	0.8	1	0.8	1	61
VYGON	1	0.8	1	1	66

55

The block contains four handwritten marks. From left to right: a stylized signature, a circular stamp or signature, and two more signatures. The first signature is a cursive 'F' with a horizontal line. The second is a circular stamp with the letters 'P' and 'U' inside. The third and fourth are cursive signatures, one of which appears to be 'Cel'.

LOTTO 21

KIT PER MICROINTRODUZIONE NEONATALE

Kit costituito da:

- ago 24G con cono trasparente
- guida in nitilon punta retta antikinking atraumatica di circa 20cm con punta flessibile ed estremità sferica da entrambi i lati; marker per indicare la fuoriuscita della guida dal tagliente
- introduttore a guaina apribile per cateteri 1F e 2F lungo 18mm

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Test tecnico del dilatatore-introduttore (flessibilità, dislivello minimo, apertura peel-away) **PUNTI 25**
2. Test tecnico della guida in nitilon (presenza di marker, flessibilità, memoria piegamento) **PUNTI 20**
3. Test tecnico ecogenicità dell'ago **PUNTI 20**
4. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
VYGON	1	1	1	1	70

56



LOTTO 22

CONNETTORE NEEDLE FREE PER ACCESSI VASCOLARI

VALVOLA DI ACCESSO SENZA AGO, per il collegamento tra un accesso vascolare ed un set di somministrazione IN UN SISTEMA CHIUSO.

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- assenza di parti metalliche in idoneo materiale compatibile con prodotti farmaceutici
- garantire assenza di reflusso al momento della disconnessione
- sistema di accesso con collegamento Luer Lock
- corpo trasparente e meccanismo NON split septum
- dispositivi resistenti ad alte pressioni di infusione (325psi)

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO SINGOLO, STERILE, MONOUSO LATEX FREE

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Sanificabilità della superficie (verrà giudicata la superficie di sanificazione con particolare riferimento al punto di connessione con il cono siringa o con i deflussori; la superficie con meno irregolarità avrà diritto a punteggio di qualità maggiore; presenza di soluzioni di continuità tra valvola e corpo del needless riceveranno punteggi inferiori) **25 punti**
2. Presenza di minimo dislocamento positivo del fluido alla disconnessione della siringa (verrà giudicato il comportamento del fluido all'interno del needless al momento del distacco del cono della siringa da esso: il movimento del fluido in avanti riceverà punteggio maggiore, il movimento del fluido all'indietro/in aspirazione riceverà punteggio minore) **25 punti**
3. Trasparenza del presidio e visibilità della soluzione infusa parametro fondamentale per valutare l'effettiva pulizia dopo lavaggio o la presenza di residui o precipitati durante o dopo le infusioni. **15 punti**
4. Disponibilità specialist su territorio **5 punti**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
BECTON DICKINSON	1	1	1	1	70
BENEFIS	0.6	0.4	1	0.4	42
CAIR ITALIA	0.8	0.8	1	1	60
DELTAMED	0.8	0.8	1	1	60
MULTIMEDICAL	0.8	0.6	1	0.8	54
TAU MEDICA	0.6	0.4	1	0.4	42
VYGON	0.8	0.6	1	1	55

57

LOTTO 23

DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DEI CONNETTORI

Dispositivo monouso per la protezione dei connettori. Compatibile con connettori needle-free LL.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Meccanismo di apertura/chiusura: affidabilità, durata. **PUNTI 45**
2. Resistenza dell'involucro protettivo. **PUNTI 15**
3. Efficacia di protezione. **PUNTI 10**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	TOTALE
MULTIMEDICAL	0.6	0.6	0.6	42

58



LOTTO 24

TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI

Tappini disinfettanti per connettore senza ago contenenti una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70 %. Efficaci su microrganismi patogeni, devono garantire la protezione per 7 giorni.

Diverse misure e tipologie disponibili.

Latex free, monouso.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Etichettatura: completezza delle informazioni riportate sul singolo dispositivo al fine di aumentare la sicurezza del paziente e dell'operatore (presenza di indicazioni su nome prodotto, funzione, n°lotto, scadenza, sterilità)

PUNTI 25

2. Disponibilità dell'intera linea di tipologie di port protectors in grado di raccordare sia con le vie infusionali che con i needless connector o con i coni luer dei cateteri **PUNTI 20**

3. Disponibilità di formato singolo ed in strisce **PUNTI 15**

4. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 10**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
3M ITALIA	1	1	1	1	70
ASPEN	1	0.4	1	1	58
BECTON DICKINSON	1	0.4	1	1	58
BENEFIS	1	0.4	0.4	1	54
DELTAMED	1	0.4	0.4	1	54
ICU MEDICAL	1	0.4	0.4	0.4	43
TAU MEDICA	0.6	0.6	1	1	52

59

LOTTO 25

CATETERE VENOSO PERIFERICO LUNGO CON SISTEMA DI INTRODUZIONE INTEGRATO

Catetere venoso periferico in PUR di ultima generazione, power Injectable, di lunghezza da 8cm a 10 cm circa e calibro da 18G a 22G, con sistema integrato di posizionamento comprendente ago, filo guida in nitinol e catetere. Il dispositivo deve possedere sistema di sicurezza passivo e dispositivo di fissaggio sutureless. Il catetere deve essere certificato per infusioni a breve termine entro i 29 giorni. (MINIMIDLINE)

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualità del confezionamento del dispositivo, in un unica, singola, confezione sterile recante un unica data di scadenza, con facilità e sicurezza di apertura in sterilità, presenza di etichettatura identificativa di catetere e lotto, chiara identificazione della caratteristiche power del dispositivo e presenza del dispositivo sutureless **PUNTI 10**
2. Sarà valutata la qualità del materiale del catetere, le caratteristiche relative alla power injection, la termoplasticità e la biocompatibilità **PUNTI 15**
3. Qualità dell'ago introduttore con riferimento alla ecogenicità e capacità di attraversare i tessuti con facilità, sistema di sicurezza integrato e doppio foro sul corpo del catetere per permettere rapida visualizzazione del reflusso ematico **PUNTI 15**
4. Qualità del supporto formativo (valutazione dell'esperienza clinica e formativa del personale aziendale in termini di titoli, training effettuati, offerta formativa a supporto on-site ed on-line, il numero di studi clinici riguardanti il dispositivo in oggetto) **PUNTI 10**
5. Qualità del sistema integrato ago, filo guida in nitinol e catetere, in termini di maneggevolezza e rapidità di utilizzo **PUNTI 20**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BARD	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	56

60

LOTTO 26

CATETERI VENOSI PERIFERICI MIDLINE DIVERSE LUNGHEZZE E CALIBRI

Catetere in poliuretano, latex free, resistente agli inginocchiamenti ed alle alte pressioni di infusione connesse ad infusione di mezzo di contrasto (Power injectable fino a 325psi).

Punta catetere rastremata o arrotondata; alette di fissaggio e prolunga integrata.

Dispositivo di microintroduzione con peel-away o introduzione diretta su guida dopo dilatazione.

Diverse misure e calibri a partire da 3F.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Punta del catetere rastremata o arrotondata **PUNTI 20**

2. Reverse tapering minimo del catetere (punteggio maggiore al RT minore o assente) **PUNTI 20**

3. Elementi tecnici del kit di introduzione: metro, guida metallica a punta retta; lunghezza del tratto morbido della guida metallica; siringa luer-lock, needless in dotazione **PUNTI 20**

4. Test qualità dei sutureless contenuti nei kit (punteggio maggiore ai kit con sutureless di migliore qualità: adesività, foam, velcro o alette rigide di ancoraggio) **PUNTI 5**

5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
CARBINI	0.4	1	0.4	0.4	1	43
DELTAMED	0.8	1	1	1	1	66
VYGON	1	1	1	1	1	70

61

The block contains three handwritten marks. On the left is a stylized signature. In the center is a signature that appears to be 'PK'. On the right is a large, bold signature.

LOTTO 27

CATETERI VENOSI PERIFERICI MIDLINE

CATETERE VENOSO PERIFERICO MIDLINE IN PUR POWER INJECTABLE CON KIT PROCEDURALE

Kit Bedside di impianto Catetere venoso periferico tipo MidLine, monolume e bilume, in PUR di ultima generazione Power Injectable, in grado di resistere alle alte pressioni e garantire flussi elevati. Il Catetere dovrà essere Indicato per infusioni endo-venose compatibili con la via venosa periferica, prelievi ematici e infusione di mezzo di contrasto ad alta pressione (per procedure TAC, 325 PSI, 5 ml/sec). Il catetere dovrà avere la presenza di Reverse Taper prossimale, punta aperta distale, markers centimetrati, chiara visualizzazione della Power Injectability (sul tubicino di estensione, le clamp e le alette di fissaggio del catetere) ed uno stiletto pre-assemblato. Il Kit dovrà essere completo dei massimi dispositivi di barriera (cuffia e mascherine, salvietta asciugamani, camice sterile, telo copritavolo servitore, telo assorbente, Telo full body drape con ampia apertura adesiva lato destro/sinistro, coprisonda sterile con elastici e gel acquoso sterile), laccio emostatico, kit di microintroduzione (ago ecogenico in acciaio con triplice affilatura e sistema di sicurezza, guida in nitinol con punta antikinking e sistema di facilitazione all'ingresso nell'ago, microintroduttore peel-away con sistema di chiusura a vite, bisturi con manico e chiusura di sicurezza), garze sterili 10x10 cm, garze sterile 5x5 cm, siringhe di vario calibro con attacco LL, ago ipodermico con sicurezza, trimmer, metro sterile, sistema di stabilizzazione adesivo e medicazione trasparente. I dispositivi taglienti (ago introduttore, bisturi, ago ipodermico) dovranno essere dotati di sistema di sicurezza. Il catetere dovrà essere presente ed integrato all'interno del Kit in un'unica, singola, confezione sterile, con riportata un'unica data di scadenza del lotto.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualità del confezionamento del dispositivo, in un'unica, singola, confezione sterile recante un'unica data di scadenza, con facilità e sicurezza di apertura in sterilità, presenza di etichettatura identificativa di catetere e lotto, chiara identificazione della caratteristiche power del dispositivo e presenza del dispositivo sutureless

PUNTI 10

2. Sarà valutata la qualità del materiale del catetere, le caratteristiche relative alla power injection, la termoplasticità e la biocompatibilità

3. Qualità dell'ago introduttore con riferimento alla ecogenicità e capacità di attraversare i tessuti con facilità, sistema di sicurezza integrato e doppio foro sul corpo del catetere per permettere rapida visualizzazione del reflusso ematico

4. Qualità del sistema integrato ago, filo guida in nitinol e catetere, in termini di maneggevolezza e rapidità di utilizzo

5. Qualità del supporto formativo (valutazione dell'esperienza clinica e formativa del personale aziendale in termini di titoli, training effettuati, offerta formativa a supporto on-site ed on-line, il numero di studi clinici riguardanti il dispositivo in oggetto)

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	BASE	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BARD	OK	1	1	1	1	1	70
CARBINI	OK	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	42
DELTAMED	OK	1	1	1	1	1	70
SEDA	OK	1	1	1	1	1	70

LOTTO 28

AGOCANNULA DOPPIA VIA DI SICUREZZA

Agocannula doppia via con alette con sistema di sicurezza passivo per la prevenzione delle punture accidentali, munita di cannula in poliuretano termosensibile e con assoluta assenza di inginocchiamento, dotata di tappo di chiusura della seconda via con chiusura a scatto per evitare aperture accidentali e manipolazioni sulla seconda via d'accesso. Il sistema di sicurezza deve essere irreversibile e deve coprire completamente la punta dell'ago per garantire la sicurezza anche in fase di smaltimento, senza parti metalliche esposte. L'ago deve essere munito di triplice affilatura per un posizionamento il più possibile atraumatico.

Misure richieste (+/- 10%): 14G x 45mm, 16G x 45mm, 17G x 45mm, 18G x 45mm e 32mm, 20G x 32mm, 22G x 25mm

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Atraumaticità dell'ago, affilatura e capacità di penetrazione dei tessuti **PUNTI 15**
2. Qualità del catetere (termoplasticità, assenza di memoria, rastrematura) **PUNTI 20**
3. Qualità del sistema di sicurezza quali robustezza, copertura totale della punta dell'ago, capacità di evitare gocciolamento di sangue e click udibile **PUNTI 20**
4. Resistenza a pressioni fino a 325PSI ON-OFF **PUNTI 15**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTALE
BBRAUN	1	1	1	0.2	63
BECTON DICKINSON	1	1	1	1	70
BENEFIS	0.6	0.4	0.6	1	44
DELTAMED	0.6	0.6	0.6	1	48
PIKDARE	0.4	0.6	0.6	1	45
TAU MEDICA	0.4	0.6	0.6	0.8	42

63

LOTTO 29

AGOCANNULA DI SICUREZZA CON PROLUNGA INTEGRATA CON RACCORDO AD Y ED 1 NFC

Sistema chiuso integrato per accesso venoso periferico con dispositivo di sicurezza, prolunga a doppia via con un connettore needle free, con ago introduttore in acciaio a triplice affilatura. La cannula dovrà essere radiopaca in poliuretano, a superficie liscia, biocompatibile, a memoria di forma ed anti-inginocchiamento. Dovrà essere presente una camera di reflusso per la visualizzazione del corretto posizionamento in vena ed un tappo ventilato. Il sistema dovrà inoltre essere completo di copriago e clamp premontata sulla prolunga.

Le alette devono essere morbide per un facile posizionamento, con codice colore che distingua le varie misure richieste (+/- 10%):

18G x mm 45, 18G x mm 32

20G x mm 32, 20G x mm 25

22G x mm 25, 24G x mm 19

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Atraumaticità dell'ago, affilatura e capacità di penetrazione dei tessuti **PUNTI 10**

2. Qualità del catetere (termoplasticità, assenza di memoria, rastrematura) **PUNTI 10**

3. Qualità del sistema di sicurezza quali robustezza, copertura totale della punta dell'ago, capacità di evitare gocciolamento di sangue e click udibile **PUNTI 10**

4. Qualità delle alette (ampiezza, morbidezza, capacità di garantire una medicazione piatta e stabile) **PUNTI 15**

5. Presenza di fenestratura sul mandrino per visualizzazione precoce del reflusso ematico ON-OFF **PUNTI 15**

6. Qualità del supporto formativo (valutazione dell'esperienza clinica e formativa del personale aziendale in termini di titoli, training effettuati, offerta formativa a supporto on-site ed on-line, il numero di studi clinici riguardanti il dispositivo in oggetto) **PUNTI 10**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	TOTALE
BECTON DICKINSON	1	1	1	1	1	1	70
BENEFIS	0.4	0.2	0.6	0.6	1	0.8	44
CARBINI	0.6	0.2	0.4	0.6	1	0.8	44
N.R. DI NANNINI S.R.L	0.6	0.2	0.6	0.6	1	0.8	44
PIKDARE	0.4	0.2	0.6	0.6	1	0.8	44

64

LOTTO 31

SIRINGHE PRERIEMPITE DI NACL PER LAVAGGIO DEI CATETERI VENOSI DA CAMPO NON STERILE E CAMPO STERILE

RIFERIMENTO A

Siringhe preriempite pronte all'uso per campo non sterile contenenti soluzione isotonica di cloruro di sodio 0,9% sterile, tappo e cono con aggancio Luer-Lock a zero reflusso al termine dell'iniezione. Volumi pari a 3ml, 5ml e 10ml, tutte con diametro del cilindro equivalente alla siringa da 10ml per erogare la corretta pressione nella manovra di lavaggio

RIFERIMENTO B

Siringhe pre-riempite pronte all'uso per campo sterile contenenti soluzione isotonica di cloruro di sodio 0,9 % sterile, tappo e cono con aggancio luer-lock a zero reflusso al termine dell'iniezione. Volumi pari a 3ml, 5 ml, 10 ml, tutte con diametro del cilindro equivalente alla siringa da 10 ml per erogare la corretta pressione nella manovra del lavaggio.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualità del confezionamento, e chiara etichettatura (chiara distinzione dalle siringhe standard e chiara indicazione di prodotto per campo non sterile, codice colore, contenuto della siringa, destinazione d'uso, data di scadenza, lotto e monouso) **PUNTI 15**
2. Buona tenuta del gommino atta a facilitare l'adozione della tecnica pulsatile (eventuale presenza di gommino a triplice anello) **PUNTI 15**
3. Registrazione in Classe III al fine di garantire la migliore qualità e sicurezza nella produzione del dispositivo ON-OFF **PUNTI 20**
4. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**
5. Presenza di una scala graduata che indichi dei volumi di massima al fine di evitare l'utilizzo per ricostituzione del farmaco distinguendole dalle siringhe ipodermiche standard **PUNTI 15**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
CARBINI	1	0.8	0.8	1	1	63
DELTAMED	1	0.8	0.8	1	1	63
N.R. DI NANNINI S.R.L	1	0.8	0.8	1	1	63
VYGON	1	0.8	0.8	1	1	63

66

LOTTO 32

ELETTRODO AD IMMERSIONE CON CAVO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO COLONNA SALINA PER ECG INTRACAVITARIO

Elettrodo ad immersione per verifica della posizione della punta catetere attraverso ECG intracavitario.
Sterile, latex free.

Connessione luerlock, utilizzo possibile con ogni tipologia di catetere.


CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Facilità di connessione del connettore luerlock **PUNTI 25**
2. Lunghezza del cavo di connessione (punteggio maggiore per lunghezza maggiore) **PUNTI 35**
3. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 10**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	TOTALE
VYGON	1	1	1	70

67

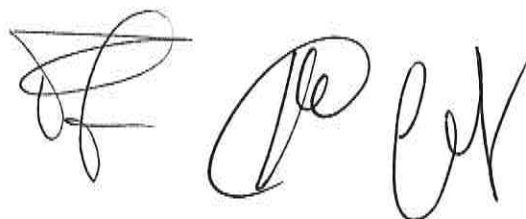

LOTTO 33

CATETERE VENOSO CENTRALE DA DIALISI A BREVE TERMINE, NON TUNNELIZZATO, IMPIANTO FEMORALE O GIUGULARE, PROVVISTO DI TERZA VIA POWER INJECTABLE

Kit catetere venoso centrale ad introduzione femorale (con vie esterne rette) o giugulare interna (con vie esterne precurve) trilume con una via di calibro inferiore resistente ad alte pressioni di infusione (325 psi circa). Catetere radiopaco in PUR, centimetrato, punta morbida, calibri da 12F a 14F, diverse lunghezze disponibili, latex free, PVC free, DEHP free, monouso sterile.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Termosensibilità del PUR: documentata in scheda tecnica, come aumento di morbidezza del presidio quando raggiunge temperatura corporea. Test tecnico. **PUNTI 20**
2. Punta morbida rastremata: test tecnico di valutazione (maggiore morbidezza corrisponde a maggior punteggio). **PUNTI 20**
3. Posizione dei lumi catetere che garantisca minimo ricircolo, valutazione della documentazione tecnica. **PUNTI 10**
4. Flessibilità della guida metallica e capacità di memoria di piegatura. Test tecnico. **PUNTI 10**
5. Valutazione complessiva della composizione del Kit catetere in tutti i suoi componenti. Test tecnico. **PUNTI 10**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BARD	1	1	1	1	1	70
MEDTRONIC	1	1	1	1	0.6	64
QURE	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	42
SEDA	1	1	1	1	0.8	68

68

LOTTO 34

CATETERE VENOSO CENTRALE TUNNELIZZATO CUFFIATO, POWER INJECTABLE, DIVERSI CALIBRI E LUMI

Kit catetere venoso centrale tunnelizzato cuffiato:

catetere in PUR, lungo circa 50 cm, resistente ad alte pressioni di infusione (300psi circa), calibri compresi tra 5F e 7F, disponibile in mono- bi- tri-lume, cuffia in dacron a distanza variabile dall'exit site.

Tunnellizzatore, sistema di fissaggio "sutureless", ago da venipuntura 21G, kit da microintroduzione, valvole needless in numero pari al numero di lumi.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualità del catetere: resistenza al kinking, reverse taper, qualità e quantità del materiale che compone la cuffia.

PUNTI 20

2. Qualità del kit di microintroduzione: affilatura ago, sistema di sicurezza ago, lunghezza del tratto guida in nitilon, sistema introduttore/peel away, tunnellizzatore. Test tecnico **PUNTI 25**

3. Qualità del sutureless contenuto nel kit: test tecnico. **PUNTI 10**

4. Qualità delle valvole needless: pressione neutra o positiva al distacco, dislocamento del fluido al distacco. Test tecnico. **PUNTI 10**

5. Assistenza e formazione post vendita inclusa la formazione e l'informazione degli utilizzatori **PUNTI 5**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
BARD	1	1	1	1	1	70
SEDA	1	1	1	1	1	70

69

LOTTO 35

CVC A BREVE PERMANENZA DOPPIO-LUME

Kit catetere a breve permanenza per emodialisi in poliuretano termosensibile, radiopaco, compatibile con RMI, in versione da 11-12 Fr circa con catetere doppio-lume a sezione doppia D. Corpo catetere diritto con aletta girevole di fissaggio. Linee di estensione diritte e ricurve con clamp dotate di codice colore e volume di priming. Lunghezze da 15cm a 25 cm circa. Kit comprendente anche ago introduttore, dilatatore/i, filo guida a J con marcatura di profondità (lunghezza 70 cm ca.), 2 tappi sigillanti.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualita' e morbidezza del materiale relativo al corpo catetere **PUNTI 15**
2. Presenza di stilette di inserzione per facilitare l'avanzamento durante impianto **PUNTI 15**
3. Assenza di fori laterali per ridurre la formazione di trombi **PUNTI 10**
4. Filo guida in nitinol anti-kinking **PUNTI 15**
5. Assenza fialati **PUNTI 5**
6. Velocità ottenibili (fornire dati) **PUNTI 5**
7. Qualita' degli accessori forniti con il kit **PUNTI 3**
8. Presenza di almeno 2 etichette adesive con codice e lotto per tracciabilità prodotto **PUNTI 2**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	TOTALE
MEDTRONIC	0.8	0.8	1	1	1	1	0.6	0.2	61,2
NIPRO	1	0.8	0.6	1	1	1	0.8	0.2	60,8
SEDA	1	0.8	0.6	1	1	1	1	0.2	61,4

40

LOTTO 36

CVC A LUNGA PERMANENZA DOPPIO-LUME

Kit catetere a lunga permanenza per emodialisi in poliuretano carbotano, radiopaco, compatibile con RMI, in versione da 15Fr circa con catetere doppio-lume a sezione doppia D e punta di tipo compatto/simmetrico. Corpo catetere diritto con ampia cuffia in dacron, con clip di fissaggio. Linee di estensione con clamp dotate di codice colore e volume di priming. Tunnellizzazione di tipo retrogrado.

Lunghezze da 19cm a 55cm circa (cuffia-punta). Kit comprendente anche ago introduttore, dilatatore/i, peel-away, filo guida a J con marcatura di profondità' (lunghezza 70 cm ca.), 2 tappi sigillanti.

CRITERI QUALITA' E MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

1. Qualita' e morbidezza del materiale relativo al corpo catetere **PUNTI 12**
2. Presenza di stiletto di inserzione per tecnica over-the wire **PUNTI 10**
3. Percentuale di ricircolo del catetere (fornire dati) **PUNTI 10**
4. Filo guida in nitinol anti-kinking **PUNTI 12**
5. Velocità ottenibili (fornire dati) **PUNTI 12**
6. Linee di estensione in silicone per prevenire effetto memoria **PUNTI 9**
7. Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit **PUNTI 3**
8. Presenza di almeno 2 etichette adesive con codice e lotto per tracciabilità prodotto **PUNTI 2**

I commissari, all'unanimità, per ogni ditta assegnano ai suddetti criteri di qualità i seguenti coefficienti che, moltiplicati per i punti massimi previsti, determinano i seguenti punteggi:

DITTA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	TOTALE
MEDTRONIC	1	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	65
QURE	0.6	1	0.8	1	0.8	1	0.6	1	59,6
SEDA	1	1	1	1	1	1	1	1	70

41