


OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA


VERBALE N. 9 DEL 24/01/2023

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta "Procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria", suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna "F" della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l'80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell'art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell'alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell'intero appalto è di seguito illustrato.
 - o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con

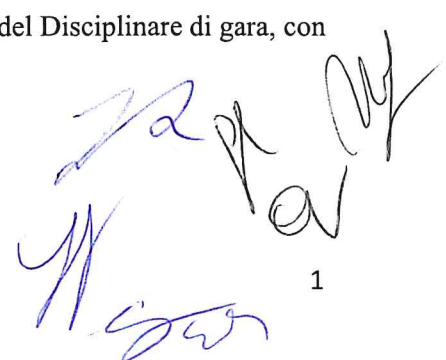

- conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
- o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.
 - In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte

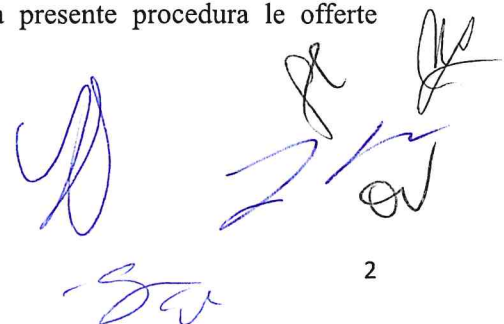

tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;

- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;
- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:


❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita per la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;

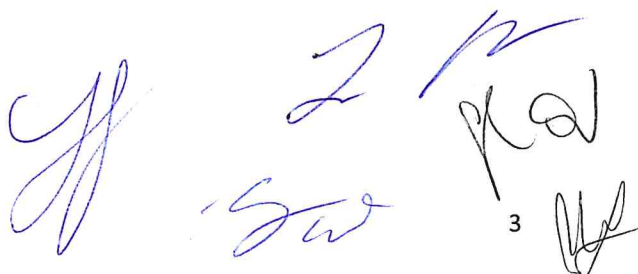

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'G' or 'J' shape. The second is a cursive 'S' or 'Z' shape. The third is a cursive 'K' or 'P' shape. Below the third signature is a small number '3' and another small signature.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 24/01/2023 alle ore 9.00 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.


La Commissione giudicatrice dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla lex specialis par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione dà atto che per un errore di digitazione il verbale del giorno 10/01/2023, nel corpo del testo, non reca il punteggio finale assegnato alla ditta HD HEALTH DEFENCE SPA per il lotto 88, il cui valore è pari a 70,00 come emerge dalla scheda di valutazione allegata al medesimo verbale e parte integrante dello stesso.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 17/01/2023, dapprima esaminando i chiarimenti forniti dalla ditta INNOVAMEDICA SRL in riscontro alla specifica richiesta avanzata dalla Commissione giudicatrice nella precedente seduta di gara (come da relativa verbalizzazione), in ordine alla documentazione tecnica relativa al **lotto 104**.

In particolare la Commissione ha richiesto di specificare le misure di diametro offerte ulteriori rispetto a quelle da 0,035".

Si dà atto che la Ditta in sede di chiarimenti (prot. n. 785 del 23/01/2023 che si allegano al presente verbale) espressamente dichiara *"vi informiamo che al momento dell'offerta la gamma era composta solo dalle misure offerte"*.

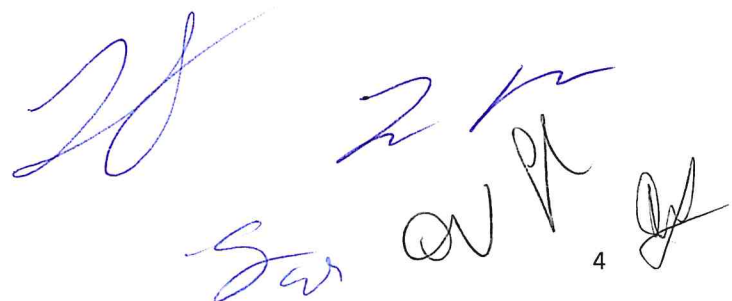

4

La sola misura del diametro indicata in offerta tecnica era quella da 0,035" con ciò evidenziando la non conformità al requisito minimo "diametro 0,035" e inferiore".

Ulteriori varianti di diametro nel frattempo resesi disponibili e non presentate specificatamente in offerta tecnica non possono essere ammesse stante il principio di immodificabilità dell'offerta. Pertanto il prodotto offerto è NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara.


Si procede, a seguire, passando in rassegna le Ditte partecipanti per il medesimo **lotto n.104**:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la non conformità poiché la ditta dispone della sola misura del diametro indicata in offerta tecnica da 0,035" con ciò evidenziando la non conformità al requisito minimo "diametro 0,035" e inferiore". Pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara.


La Commissione come da mandato alla stessa conferito, esamina e valuta per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 123:

- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

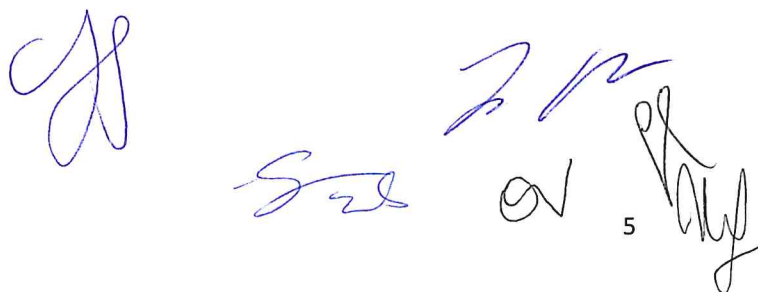

- DITTA HD HEALTH DEFENCE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **73,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **73,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA AORTA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

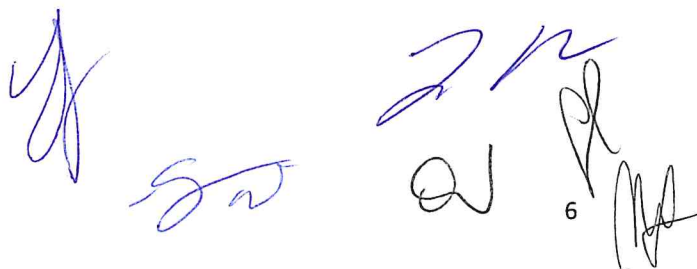


6

- DITTA MEDITALIA SAS: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **73,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 124

- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA HD HEALTH DEFENCE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo "Compatibile con sistema a scambio rapido" in quanto il dispositivo offerto non presenta lo scambio rapido, pertanto tale prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **50,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti

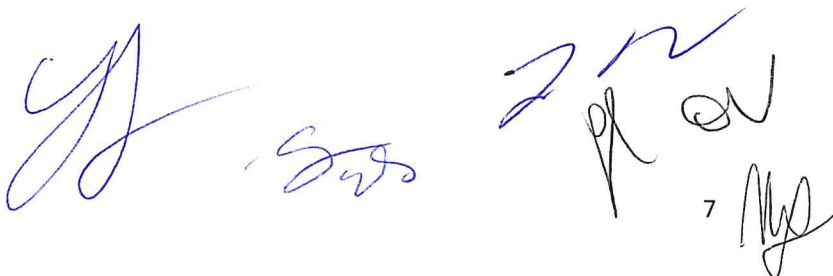

- 68,00.** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- **DITTA AORTA SRL:** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo "Compatibile con sistema a scambio rapido" in quanto il dispositivo offerto non presenta lo scambio rapido, pertanto tale prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
 - **DITTA ASPEN SANITAS SRL:** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **71,33.** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;;
 - **DITTA COOK ITALIA SRL:** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00.** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - **DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA:** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00.** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 125

- **DITTA EUROMEDICAL SRL:**La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,00.** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;




8

- DITTA HD HEALTH DEFENCE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **73,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 127

- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti

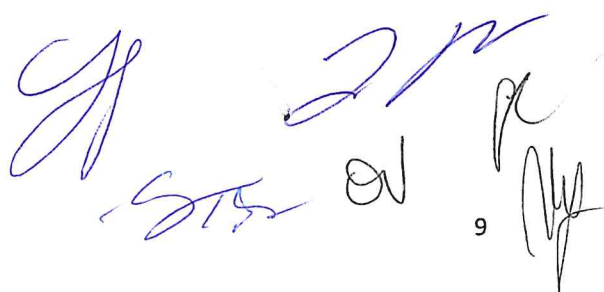

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a signature starting with 'ST', and several smaller signatures.

78,00. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;


- DITTA MEDITALIA SAS: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA SPES DI CINZIA SANTAMARIA & C. SAS: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDIMAR SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 128

- DITTA ENDOVASCULAR SERVICE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 129

- DITTA ENDOVASCULAR SERVICE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

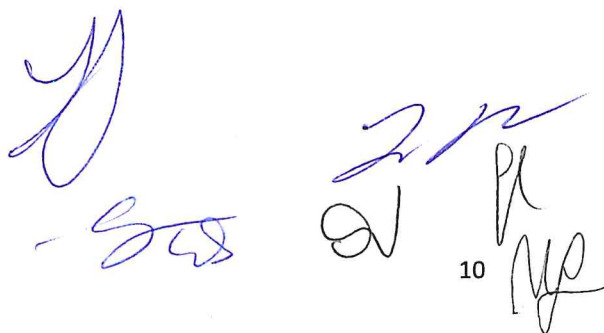

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo "lunghezza utile 175 cm e 40 cm, diametro 7 fr" in quanto il dispositivo offerto non presenta tali misure, pertanto tale prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;

LOTTO 131

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;




Per il **lotto n. 132** non sono pervenute offerte; si dà atto pertanto che il lotto è DESERTO.

LOTTO 133

La commissione dà atto che i punteggi qualitativi indicati nel capitolato danno come punteggio totale 55 punti anziché 80 e pertanto la Commissione decide di sospendere ogni tipo di valutazione tecnica, trasmettendo al RUP la relativa informativa per procedere alle determinazioni del caso.

Alle ore 14:30 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dott. Ugo Germani- in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi- in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti- in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 

LOTTO 104- FILO GUIDA RIGIDO TEFLONATO																		
REQUISITI MINIMI			BOSTON SCIENTIFIC SPA			EUROMEDICAL SRL				INNOVAMEDICA SPA				M.G. LORENZATTO				
Filo guida rigido teflonato			X			X				X				X				
con estremità morbida atraumatica			X			X				X				X				
diametro 0,035" e inferiore			X			X				NON PRESENTA DIAMETRI INFERIORI				NON PRESENTA DIAMETRI INFERIORI A 0,035				
varie lunghezze			X			X				X				X				
monouso			X			X				X				X				
			IDONEO			IDONEO				NON IDONEO				NON IDONEO				
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DELLA GUIDA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore qualità del materiale della guida. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	14,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO								
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,60								
2	FLESSIBILITÀ E ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA La commissione valuterà con maggior punteggio la migliore flessibilità e la minore traumaticità mediante esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO								
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00								
3	RIGIDITA' DELLA GUIDA La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore rigidità della guida, in base alla valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO								
				1,00	1,00	1,00		0,40	0,60	0,60								
4	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite inserimento in catetere. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO								
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80								
5	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO								
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00								
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				63,67				0,00				0,00			

LOTTO 121 -PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO																															
REQUISITI MINIMI		EUROMEDICAL SRL			HD HEALTH DEFENCE SRL			INNOVAMEDICA SPA			M.G LORENZATTO SRL			OLYMPUS ITALIA SRL			AORTA SRL			COOK ITALIA SRL			BOSTON SCIENTIFIC SPA			MEDITALIA SAS					
monouso		X			X			X			X			X			X			X			X			X					
triplo lumen		X			X			X			X			X			X			X			X			X					
Punto di ripresa radiopaco sull'arteria principale del polmone		X			X			X			X			X			X			X			X			X					
Possibilità di guidare ogni polmone con diversi diametri monouso		X			X			X			X			X			X			X			X			X					
Diametri del polmone da 8,5 a 18 mm		X			X			X			X			X			X			X			X			X					
Possibilità di incisione distale e prossimale		X			X			X			X			X			X			X			X			X					
		IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO					
RADIOGRAFIA DEL CATERE E DEL PALLONE La commissione valuterà la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tenendo conto del riempimento. Il coefficiente Vizi nel pool sarà alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizio di cui si discipolano.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI		
	10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	
ASSISTENZA DEL PALLONE La commissione valuterà la forza radiale del pallone in relazione agli usi e la non deformabilità in fase di inserimento di catetere. Il coefficiente Vizi nel pool sarà alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizio di cui si discipolano.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI		
	25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	
MANIOREVOLEZZA E VERSATILITÀ DEL CATERE La commissione valuterà la maneggevolezza e la manovrabilità del catetere anche in considerazione della non deformabilità in corso di utilizzo (prima ed ultima) valutazione in vitro. Il coefficiente Vizi nel pool sarà alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizio di cui si discipolano.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI		
	25	10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		
				0,40	0,40	0,40		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	
QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà la qualità in base all'adeguatezza del campione tenendo conto della scelta tecnica anche in rapporto alla simulazione, tenendo conto della sicurezza e della durata in uso. Il coefficiente Vizi nel pool sarà alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizio di cui si discipolano.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI		
	20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
TOTALE PUNTEGGIO		59,00			59,00			73,00			68,00			73,00			68,00			64,00			73,00			68,00			68,00		

2 My
SOS
or R

LOTTO 124 -PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO																																	
REQUISITI MINIMI			EUROMEDICAL SRL			HD HEALTH DEFENCE SRL			M.G LORENZATTO SRL			OLYMPUS ITALIA SRL			AORTA SRL			ASPEN SANITAS SRL			COOK ITALIA SRL			BOSTON SCIENTIFIC SPA									
monouso			X			X			X			X			X			X			X			X									
triplo lume			X			X			X			X			X			X			X			X									
Punto di repere radiopaco sull'arteria principale del polmone			X			X			X			X			X			X			X			X									
Possibilità di gestire ogni polmone a diversi diametri monetizzati.			X			X			X			X			X			X			X			X									
Diametri del palloncino da 9 a 20mm			X			X			X			X			X			X			X			X									
Possibilità di iniezione distale e preenziale.			X			X			X			X			X			X			X			X									
Compatibile con sistema a scambio rapido.			X			NON A SCAMBIO RAPIDO			X			X			NON A SCAMBIO RAPIDO			X			X			X									
			IDONEO			NON IDONEO			IDONEO			IDONEO			NON IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO									
RADIOPACITÀ DEL CATERERE E DEL PALLONE La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(p) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI
	10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
RESISTENZA DEL PALLONE La commissione valuterà la forza radiale del pallone la resistenza agli stress e la non deformabilità in fase di estrazione di calcoli. Il coefficiente V(p) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI
	25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITÀ DEL CATERERE La commissione valuterà la maneggevolezza e la scorrevolezza del catetere anche in considerazione della non deformabilità in corso di utilizzo (opina ad estrazione) valutando in vitro. Il coefficiente V(p) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI
	25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				23,33333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	0,80	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà la qualità in base all'adeguatezza del campione tenendo conto della scheda tecnica anche in rapporto alla simulazione, tenuto conto della letteratura scientifica in merito. Il coefficiente V(p) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RUCCARDI	TORTI
	20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			68,00			6,00			50,00			48,00			6,00			71,33			75,00			75,00									

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

LOTTO 125 -PALLONE PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO																							
REQUISITI MINIMI		EUROMEDICAL SRL					HD HEALTH DEFENCE SRL				M.G LORENZATTO SRL				ASPEN SANITAS SRL				COOK ITALIA SRL				
filo guidato		X					X				X				X				X				
doppio lume		X					X				X				X				X				
monouso		X					X				X				X				X				
diametri da 8.5 a 18 mm		X					X				X				X				X				
Possibilità di iniezione distale.		X					X				X				X				X				
		IDONEO					IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				
1	RADIOCAPACITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80						
2	RESISTENZA DEL PALLONE La commissione valuterà la forza radiale del pallone la resistenza agli stress e la non deformabilità in fase di estrazione di calcoli. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80					
3	MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITÀ DEL CATETERE La commissione valuterà la maneggevolezza e la scorrevolezza del catetere anche in considerazione della non deformabilità in corso di utilizzo (spinta ed estrazione) valutazione in vitro-. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		25	10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16,66666667	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	
				0,40	0,40	0,40		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,60	0,80	0,60	
4	QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà la qualità in base all'adeguatezza del campione tenendo conto della scheda tecnica anche in rapporto alla simulazione, tenuto conto della letteratura scientifica in merito. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	20	1,00	1,00	1,00	16	0,80	0,80	0,80	20	1,00	1,00	1,00	20	1,00	1,00	1,00	20	1,00	1,00	1,00	
TOTALE PUNTEGGIO		58,00					59,00				68,00				73,00				64,67				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

LOTTO 127 -DISPOSITIVO PER MARCATURA E TATUAGGIO ENDOSCOPICO DI POLIPI E LESIONI DEL TRATTO																									
REQUISITI MINIMI				EUROMEDICAL SRL				M.G LORENZATTO SRL				MEDITALIA SAS				SPES DI CINZIA SANTAMARIA & C. SAS				MEDIMAR					
Dispositivo medico per la marcatura ed il tatuaggio endoscopico di polipi e lesioni del tratto gastrointestinale				X				X				X				X				X					
sterile				X				X				X				X				X					
apirogeno				X				X				X				X				X					
biocompatibile				X				X				X				X				X					
monouso				X				X				X				X				X					
				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO					
1	DUREVOLEZZA DELLA MARCATURA La commissione valuterà la maggior durata e persistenza della marcatura nel tempo sulla base della letteratura scientifica e scheda tecnica del prodotto. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO			OTTIMO	OTTIMO		OTTIMO		OTTIMO		OTTIMO	OTTIMO			OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO			
				50	50	1,00		1,00	1,00	50		1,00	1,00	1,00		50	1,00	1,00		1,00	30	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	50
2	DISPOSITIVO PRECONFEZIONATO La commissione valuterà come migliore il dispositivo pronto all'uso, predosato, apirogeno con attacco luer - lock. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
				30	28	PIU' CHE ADEGUATO		OTTIMO	OTTIMO	28		OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO		28	OTTIMO	OTTIMO		PIU' CHE ADEGUATO	28	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	28
TOTALE PUNTEGGIO				78,00				78,00				78,00				58,00				78,00					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SW", "JH", "R", and others.


LOTTO 128 -SISTEMA MONOUSO PER RESEZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONI GASTROENTERICHE	
REQUISITI MINIMI	ENDOVASCULAR SERVICE
A. Endoclip in nitinol con denti appuntiti, premontata su cappuccio applicatore. Ansa monopolare integrata nella parte distale del cappuccio, manipolo rotante per il rilascio, catetere ad uncino per la retrazione del filo, guaina flessibile protettiva, catetere monopolare per la marcatura della lesione, pinza da presa per la retrazione del tessuto;	X
B. Cappuccio applicatore per prova preliminare, sterile, monouso. Conf. 2 pezzi.	X
	IDONEO

1	VERSATILITÀ APPLICATORE E MANOVRABILITÀ DEL SISTEMA Maggiore punteggio all'applicatore in grado di esercitare la funzione propria in condizioni critiche (retrovisione e strumento a visione laterale): valutazione in vitro della scorrevolezza del dispositivo nello strumento endoscopico in condizioni critiche (retrovisione e strumento a visione laterale). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
2	TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità di chiusura: valutazione in vitro della capacità di mantenere le valve ravvicinate una volta chiusa la clip.Valutazione in vitro Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
3	COMPLETEZZA DEL KIT Maggiore punteggio kit dotato di tutti i device necessari all’asportazione della lesione: sistema di aspirazione/trazione della lesione, sistema di sutura, sistema di taglio della lesione. Assegnazione del punteggio in modalità tabellare in presenza del kit= 20 punti in caso di assenza o difformità del kit alla descrizione =0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	presenza kit	assenza kit	
		20	20	X		
				FALSO	FALSO	
4	FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
5	SPESSORE DELLA LESIONE DI PARETE La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto che eseguirà l’asportazione a tutto spessore della lesione in una sola manovra. La valutazione si basa sulla scheda tecnica Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			80,00			

UP
So ov
J M
R
Hem

LOTTO 129 -CATETERE BIPOLARE A RADIOFREQUENZA										
REQUISITI MINIMI				ENDOVASCULAR SERVICE			BOSTON SCIENTIFIC SPA			
per l’ablazione endoluminale delle vie bilari principale e secondarie per via endoscopica e percutanea.				X			X			
Filoguidato,				X			X			
lunghezza utile 175 cm e 40 cm, diametro 7 fr				X			ASSENTE LUNGHEZZA E DIAMETRO RICHIESTO			
Lunghezza della parte attiva da 11 mm a 33 mm, sensore controllo temperatura.				X			X			
				IDONEO			NON IDONEO			
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
				0,80	0,80	0,80				
2	SCORREVOLEZZA La commissione valuterà la maggior scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
				0,80	0,80	0,80				
3	MANEGGEVOLEZZA La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del device tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
				0,80	0,80	0,80				
4	SICUREZZA DEL DISPOSITIVO NELL’EROGAZIONE DELLA RADIOFREQUENZA La Commissione valuterà la migliore sicurezza di distribuzione e profondità della radiofrequenza erogata da valutare tramite apposita relazione descrittiva da elaborare come da regole definite nel capitolato 1 pag, toto righe eccc in cui dovrà essere citata anche la letteratura scientifica	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
				0,80	0,80	0,80				
TOTALE PUNTEGGIO				64,00			0,00			







LOTTO 131 -SONDE PER LITOTRISSIA ENDOLUMINALE ELETTROIDRAULICA PER VIDEOCOLANGIOSCOPI	
REQUISITI MINIMI	BOSTON SCIENTIFIC SPA
Altamente flessibile ma in grado di mantenere la loro posizione,	X
punta distale smussa per facilitare l'intrduzione della stessa nel canale operatore del colangioscopio	X
sonda compatibile con sistema SpyGlass®	X
sterile e non sterile	X
Sonde per la litotrissia elettroidrauliche	X
	IDONEO

1	RADIOPACITA' La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
2	MANEGGEVOLEZZA La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del device tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
3	RESISTENZA La commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che non si deforma durante la procedura sotto le stimolazioni da utilizzo. esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
4	CAPACITÀ DI EROGAZIONE DELL'IMPULSO EROGATO La commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che garantisce la maggiore performance nella litotrissia e minor traumatismo sulla parete della via biliopancreatica. relazione tecnica con letteratura scientifica e scheda tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			75,00			