

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI GARA E INDIZIONE. CODICE GARA ANAC 8749975

VERBALE N. 4 DEL 20/12/2022

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna “F” della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l’80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell’art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell’alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell’intero appalto è di seguito illustrato.

- o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui al par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista



la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.

- In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;
- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;

- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita per la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 20/12/2022 alle ore 8.30 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione giudicatrice dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla *lex specialis* par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 15/12/2022, esaminando le ulteriori Ditte partecipanti per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 30:

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la mancanza del requisito minimo *“apertura 7 mm e 10 mm”* e rispetto al requisito *“configurazione ovale e esagonale con sistema di rotazione a 1:1”* viene constatato che il prodotto offerto non presenta forma ovale; si dichiara pertanto il prodotto offerto NON IDONEO e conseguentemente è ESCLUSO dal prosieguo della gara;
- DITTA MEDITALIA SAS: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la mancanza del requisito minimo *“apertura 7 mm e 10 mm”* rispetto al quale, in particolare, viene constatato che il prodotto

offerto non presenta le dimensioni di apertura 7mm; si dichiara pertanto il prodotto offerto NON IDONEO e conseguentemente è ESCLUSO dal prosieguo della gara;

- DITTA INNOVAMEDICA SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la mancanza del requisito minimo *“apertura 7 mm e 10 mm”* rispetto al quale, in particolare, viene constatato che il prodotto offerto non presenta le dimensioni di apertura 7mm. Inoltre rispetto al requisito *“configurazione ovale e esagonale con sistema di rotazione a 1:1”* viene constatato che lo stesso è assente; si dichiara pertanto il prodotto offerto NON IDONEO e conseguentemente è ESCLUSO dal prosieguo della gara;

Per il lotto n. 31 non sono pervenute offerte, pertanto si dà atto che il lotto è deserto.

LOTTO 32:

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **71,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza del requisito *“plurifilamento”* e dichiara il prodotto offerto NON IDONEO; conseguentemente il prodotto offerto è ESCLUSO dal prosieguo della gara.

- DITTA PENTAX SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 33

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **65,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **54,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 35


- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza di "*singolo lume*" e dichiara il prodotto offerto NON IDONEO; conseguentemente il prodotto offerto NON ACCEDE al prosieguo della gara.



- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **72,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **77,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 36

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA :La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **66,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

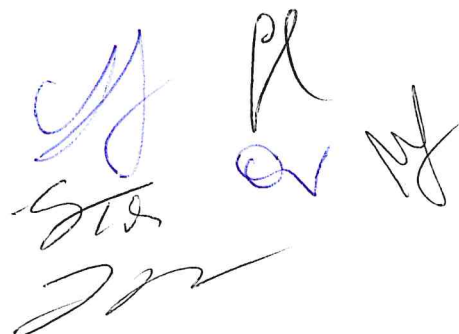The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one on the left, one in the center, one on the right, and a larger, more stylized signature at the bottom center.

LOTTO 37

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 38

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Several handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names, written in a cursive style.

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;


LOTTO 39

- DITTA M.G LORENZATTO SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza - per entrambi i sublotti- del requisito minimo "*estremità corta e lunga*" in quanto presenta una punta da 5 mm e dichiara il prodotto offerto NON IDONEO; conseguentemente il prodotto offerto NON ACCEDE al prosieguo della gara.
- DITTA OLYMPUS SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **79,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza - per entrambi i sublotti- del requisito minimo "*estremità corta e lunga*" e dichiara il prodotto offerto NON IDONEO; conseguentemente il prodotto offerto NON ACCEDE al prosieguo della gara.
- DITTA EUROMEDICAL SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



LOTTO 40

- DITTA M.G LORENZATTO SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza del requisito minimo "*estremità corta e lunga*" in quanto presenta una punta da 5 mm e dichiara il prodotto offerto NON IDONEO; conseguentemente il prodotto offerto NON ACCEDE al prosieguo della gara.
- DITTA COOK ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza del requisito minimo "*estremità corta e lunga*" e dichiara il prodotto offerto NON IDONEO; conseguentemente il prodotto offerto NON ACCEDE al prosieguo della gara.
- DITTA ASPEN SANITAS SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **53,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **52,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di

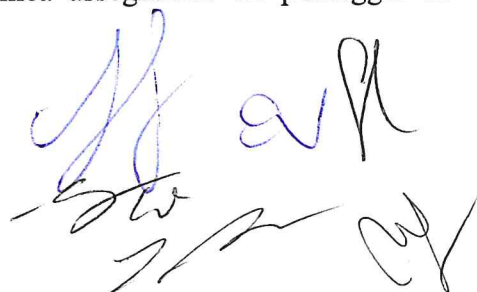

qualità pari a punti **60,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 41

- DITTA AORTA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **66,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names.


di qualità pari a punti **62,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA M.G. LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,67** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA LUME IMPORT SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata l'assenza della documentazione tecnica prevista **a pena di esclusione** al par. 15 del Disciplinare di gara, dando peraltro atto che la documentazione depositata è relativa al lotto n. 25. La Commissione ne dà atto e provvede a trasmettere gli atti al RUP per le determinazioni conseguenti.
- DITTA INNOVAMEDICA SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Per il lotto n. 42 non sono pervenute offerte e pertanto è dichiarato deserto.

LOTTO 43

- DITTA AORTA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **71,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA ASPEN SANITAS SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di

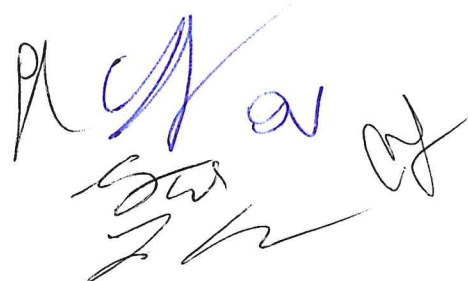

- qualità pari a punti **80,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA EUROMEDICAL SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata che la scheda tecnica depositata agli atti di gara non corrisponde al lotto 43 in discussione bensì al lotto n. 41 in quanto reca esplicita intestazione "*papillotomo pre-cut sterile monouso triplo lume*" pertanto non corrisponde a quanto richiesto. Per tale ragione la Commissione giudicatrice dà atto che non risulta presentata la scheda tecnica richiesta **a pena di esclusione al par. 15 del Disciplinare** di gara e procede a trasmettere informativa al RUP per le determinazioni conseguenti;
 - DITTA M.G. LORENZATTO SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **54,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



LOTTO 44

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,67** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,67** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- INNOVAMEDICA SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,67** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;


Handwritten signatures and initials in blue ink, including "GFF", "ev", and "ZP".

LOTTO 45

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Alle ore 16.40 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani, in qualità di Presidente _____ 
- Dott.ssa Luisa Riccardi, in qualità di membro _____ 
- Dott. Gabriele Torti in qualità di membro _____ 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante _____ 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone _____ 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone _____ 

LOTTO 30 - MINI ANSA MONOUSO PLURIFILAMENTO PER POLIPECTOMIA																		
REQUISITI MINIMI			DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA MEDITALIA SAS				DITTA H.D HEALTH DEFENCE				DITTA INNOVAMEDICA SPA			
a freddo			X				X				X				X			
apertura 7 mm e 10 mm			ASSENTE				X				MANCA APERTURA 7MM				MANCA APERTURA 7MM			
configurazione ovale e esagonale con sistema di rotazione a 1:1			MANCA FORMA OVALE				X				X				ASSENTE			
lunghezza operativa 230 mm			X				X				X				X			
canale operativo minimo 2.8 mm			X				X				X				X			
			NON IDONEO				IDONEO				NON IDONEO				NON IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	0				16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				0			
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		FALSO	FALSO	FALSO
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				0			
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		FALSO	FALSO	FALSO
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				0			
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		FALSO	FALSO	FALSO
TOTALE PUNTEGGIO			0,00				64,00				0,00				0,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00



LOTTO 32 - ANSA MONOUSO PEDIATRICA PER POLIPECTOMIA																					
REQUISITI MINIMI		DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA MEDITALIA				DITTA OLYMPUS				DITTA PENTAX							
plurifilamento										ASSENTE				X							
adatte a canale operativo di circa 2,0 mm										X				X							
		IDONEO				IDONEO				NON IDONEO				IDONEO							
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE							
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	17,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	0				12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO			
				0,80	0,80	0,80		0,80	1,00	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60			
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				12	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO			
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40			
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO			
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80			
TOTALE PUNTEGGIO		76,00					71,33					0,00					48,00				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 33 - ANSA MONOUSO CON EFFETTO AGGRAPPANTE														
REQUISITI MINIMI			DITTA EUROMEDICAL SRL				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA OLYMPUS			
effetto aggrappante (denti o altro sistema)			X				X				X			
adatte a canale operativo da 2,8 mm.			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	17,33333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	0,80	0,80		0,80	0,80	0,60		0,60	0,60	
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	22	ADEGUATO	OTTIMO	ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	1,00	0,60		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			65,33				68,00				54,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 35 - CANNULA PER ERCP MONOUSO														
REQUISITI MINIMI			DITTA COOK SRL				DITTA OLYMPUS SRL				DITTA M.G. LORENZATTO			
monouso con punta metallica			X				X				X			
singolo lume			X				X				ASSENTE			
lunghezza cm 200 circa compatibile con guida 0.035			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				NON IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
2	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE NEL CANALE OPERATORE La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0			
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI FLESSIBILITÀ La commissione valuterà la maggior flessibilità del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
4	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
TOTALE PUNTEGGIO			72,00				77,00				0,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00



LOTTO 36 -CANNULA PER ERCP MONOUSO														
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA M.G. LORENZATTO			
monouso con punta rastremata			X				X				X			
triplo lume			X				X				X			
compatibile con guida 0,035			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
2	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE NEL CANALE OPERATORE La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		0,60	0,60	
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI FLESSIBILITÀ La commissione valuterà la maggior flessibilità del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
4	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		0,60	0,60	
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				80,00				66,67			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 37 -CANNULA PER ERCP MONOUSO														
REQUISITI MINIMI			DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA M.G. LORENZATTO			
monouso con punta rastremata			X				X				X			
triplo lume			X				X				X			
compatibile con guida 0,025			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
2	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE NEL CANALE OPERATORE La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,60		0,60	0,80	
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI FLESSIBILITÀ La commissione valuterà la maggior flessibilità del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	11	OTTIMO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		1,00	0,60	0,60
4	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	16,66666667	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,80	0,60
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				64,00				62,67			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

LOTTO 38 -CANNULA PER ERCP MONOUSO														
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA M.G. LORENZATTO			
compatibile con sistema a scambio rapido			X				X				X			
monouso			X				X				X			
compatibile con guida 0,035			X				X				X			
punta standard e rastremata			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
2	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE NEL CANALE OPERATORE La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI FLESSIBILITÀ La commissione valuterà la maggior flessibilità del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
4	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				63,00				63,00			

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

LOTTO 39 -PAPILLOSFINTEROTOMI BILUME MONOUSO																										
REQUISITI MINIMI			DITTA M.G LORENZATTO SRL			DITTA OLYMPUS SRL				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA EUROMEDICAL SRL												
A. Papillosfinterotomi bilume monouso, cosuituito da:			X			X				X				X												
doppio lume con punta precurvata e rastremata da 6fr			X			X				X				X												
lunghezza filo di taglio da 20 mm a 30 mm			X			X				X				X												
estremità corta e lunga			ASSENTE (PUNTA SOLO DI 5MM)			X				ASSENTE				X												
manico incorporato			X			X				X				X												
accetta filo guida 0.035			X			X				X				X												
marker per il controllo radiografico ed endoscopico.			X			X				X				X												
B.- Papillosfinterotomi bilume monouso, composta da:			X			X				X				X												
lunghezza filo di taglio da 20 mm a 30 mm,			X			X				X				X												
estremità corta e lunga			ASSENTE (PUNTA SOLO DI 5MM)			X				ASSENTE				X												
manico incorporato			X			X				X				X												
ccetta filo guida 0.021			X			X				X				X												
marker per il controllo radiografico ed endoscopico.			X			X				X				X												
			NON IDONEO			IDONEO				NON IDONEO				IDONEO												
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE												
1	ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		10	0				10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO								
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00								
2	QUALITÀ DEL FILO DI TAGLIO La commissione valuterà con punteggio più alto il filo di taglio che avviene con minore dispersione di calore in base alla relazione descrittiva.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		20	0				20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				17,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO								
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	1,00	0,80								
3	MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		5	0				4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO								
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60								
4	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		15	0				15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO								
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00								
5	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione di spinta,allo stress in fase di tensione del filo guida e nel momento in cui il catetere esce dal canale operatore e si posiziona davanti alla papilla tramite esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
		30	0				30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO								
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60								
TOTALE PUNTEGGIO			0,00			79,00				0,00				63,33												

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 40 -PAPILLOSINTEROTOMI TRILUME MONOUSO																										
REQUISITI MINIMI		DITTA ASPEN SANITAS SRL				DITTA COOK				DITTA EUROMEDICAL SRL				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA OLYMPUS ITALIA SRL				
lunghezza filo di taglio da 20 mm a 30 mm		X				X				X				X				X				X				
estremità corta e lunga		X				ASSENTE				X				X				ASSENTE (SOLO PUNTA 5MM)				X				
manico incorporato		X				X				X				X				X				X				
accetta filo guida 0.035		X				X				X				X				X				X				
marker per il controllo radiografico ed endoscopico		X				X				X				X				X				X				
Lama protetta.		X				X				X				X				X				X				
		IDONEO				NON IDONEO				IDONEO				IDONEO				NON IDONEO				IDONEO				
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
1	ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	0				8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	8,666666667	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	1,00	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	1,00	0,80		1,00	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	1,00	0,80
2	QUALITÀ DEL FILO DI TAGLIO La commissione valuterà con punteggio più alto il filo di taglio che avviene con minore dispersione di calore in base alla relazione descrittiva.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80
3	MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80
4	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	11	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		0,60	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80
5	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione di spinta.allo stress in fase di tensione del filo guida e nel momento in cui il catetere esce dal canale operatore e si posiziona davanti alla papilla tramite esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				20	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,80	0,60
TOTALE PUNTEGGIO		64,67				0,00				53,67				52,67				0,00				60,67				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

REQUISITI MINIMI		DITTA ILD HEALTH DEFENCE SRL				DITTA AORTA SRL				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA LUME IMPORT SRL				DITTA M.G. LORENZATTO SRL				DITTA OLYMPUS ITALIA SRL				DITTA INNOVAMEDICA SPA											
monouso ad ago triplo lume		X				X				X				X				X				X				X				X											
Utilizzabile con filo guida 0.035		X				X				X				X				X				X				X				X											
Marker di profondità per visione e controllo radiologico ed endoscopico		X				X				X				X				X				X				X				X											
		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				NON IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO											
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE											
1. ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoruscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI												
	10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	6	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	0	8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	8,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO										
			0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	1,00		0,80	0,80	FALSO			FALSO	FALSO		0,80	0,80		1,00	0,80		1,00	1,00	1,00										
2. QUALITÀ DEL FILO DI TAGLIO La commissione valuterà con punteggio più alto il filo di taglio che avviene con minore dispersione di calore in base alla relazione descrittiva.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
	20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,666666667	OTTIMO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	0	18,666666667	OTTIMO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	18,666666667	OTTIMO	OTTIMO	18,666666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO								
			0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	1,00		1,00	0,80	FALSO			FALSO	FALSO	1,00		1,00	0,80		0,80	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00								
3. MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campinatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
	5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	4,333333333	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	0	4,333333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	4,333333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO								
			1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	0,80		1,00	FALSO	FALSO			FALSO	0,80	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	0,80	0,80	0,80										
4. RADIOFACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
	15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO											
			1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	0,80		0,80	0,80																
5. QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITÀ' La commissione valuterà la maggiore resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione di spinta allo stress in fase di trazione del filo guida e nel momento in cui il catetere esce dal canale operatore e si posiziona davanti alla papilla tramite esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI								
	30	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	14	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	0	14	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	14	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	30	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO								
			0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		0,40	0,60	0,40			FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,60	0,40		0,40	0,40	0,60	1,00	1,00	1,00								
TOTALE PUNTEGGIO		62,00					62,00					66,00					60,67					60,67					60,67					60,67					76,90				

GRUPPO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 43 -PAPILLOSINTEROTOMI TRILUME MONOUSO																											
REQUISITI MINIMI		DITTA AORTA SRL				DITTA ASPEN SANITAS SRL				DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA EUROMEDICAL SRL				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA				DITTA M.G. LORENZATTO					
lunghezza filo da 20mm a 30mm		X				X				X				X								X					
punta orientabile		X				X				X				X								X					
utilizzabile con guida da 0,035"		X				X				X				X								X					
		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				NON IDONEO (SCHEDA TECNICA NON CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO)				IDONEO					
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE									
1	ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00	
2	QUALITÀ DI TAGLIO DEL TAGLIENTE La commissione valuterà con punteggio più alto la qualità e le caratteristiche del materiale che costituisce il filo di taglio (come da descrizione dettagliata fornita dalla scheda tecnica)	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00	
3	MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		10	9,333333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	6	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	5,333333333	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	0				4	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	
				0,80	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,40	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40	
4	RADIOCAPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00	
5	ORIENTABILITÀ DELLA PUNTA La commissione valuterà con punteggio più alto il miglior rapporto di risposta rotazione manipolo - rotazione punta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	18,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10,66666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	10,66666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	0				8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	
				0,80	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,60	0,40	0,60		0,60	0,40	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40	
6	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	13,33333333	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	
				0,60	0,60	0,80		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60	
		TOTALE PUNTEGGIO			71,33					80,00				62,67				58,00				0,00				54,00	

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 44 - PAPILLOSINTEROTOMI TRILUME MONOUSO (COMPATIBILE CON SISTEMA A SCAMBIO RAPIDO)																						
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA EUROMEDICAL SRL				DITTA INNOVAMEDICA				DITTA M.G. LORENZATTO							
lunghezza filo da 20mm a 30mm			X				X				X				X							
punta orientabile			X				X				X				X							
utilizzabile con guida da 0,035"			X				X				X				X							
Compatibile con sistema a scambio rapido			X				X				X				X							
			IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO							
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE							
1	ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00									
2	QUALITÀ DI TAGLIO DEL TAGLIENTE La commissione valuterà con punteggio più alto la qualità e le caratteristiche del materiale che costituisce il filo di taglio (come da descrizione dettagliata fornita dalla scheda tecnica)	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00									
3	MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
				1,00	1,00	1,00		0,20	0,20	0,20		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80				
4	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9,333333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8,666666667	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
				1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	1,00		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80				
5	ORIENTABILITÀ DELLA PUNTA La commissione valuterà con punteggio più alto il miglior rapporto di risposta rotazione manipolo - rotazione punta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		20	18,66666667	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO				
				1,00	0,80	1,00		0,40	0,40	0,40		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60				
6	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9,333333333	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO				
				1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60					
TOTALE PUNTEGGIO			78,67					48,67					64,00					60,67				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 45 -PAPILLOTOMO PRE-CUT STERILE MONOUSO AD AGO TRIPLO LUME						
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA			
monouso			X			
ad ago			X			
triplo lume			X			
Utilizzabile con filo guida 0.035			X			
Marker di profondità per visione e controllo radiologico ed endoscopico			X			
Compatibile con scambio rapido			X			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	QUALITÀ DEL FILO DI TAGLIO La commissione valuterà con punteggio più alto il filo di taglio che avviene con minore dispersione di calore in base alla relazione descrittiva.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
5	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione di spinta,allo stress in fase di tensione del filo guida e nel momento in cui il catetere esce dal canale operatore e si posiziona davanti alla papilla tramite esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]