

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI GARA E INDIZIONE. CODICE GARA ANAC 8749975

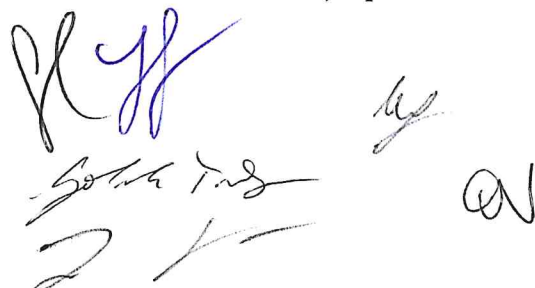
VERBALE N. 2 DEL 07/12/2022

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna “F” della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l’80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell’art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell’alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell’intero appalto è di seguito illustrato.



- o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui al par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista



la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.

- In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;
- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;

- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

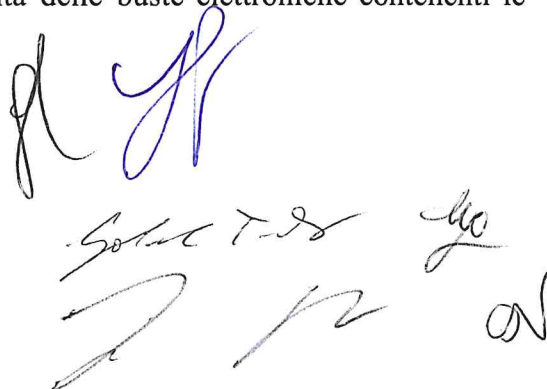
E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita er la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 07/12/2022 alle ore 8.30 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

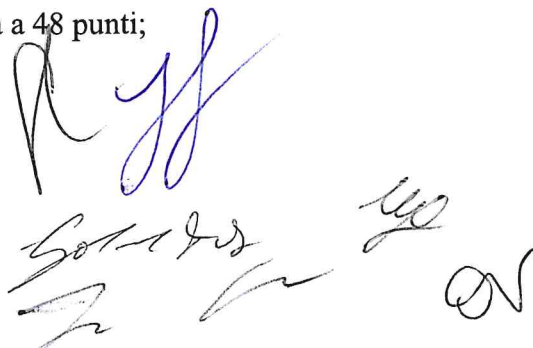


La Commissione dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla lex specialis par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 2/12/2022, esaminando le ulteriori Ditte partecipanti per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 4:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la **NON** sussistenza della caratteristica "*Compatibile con sistema a rapido scambio*"; conseguentemente dichiara il prodotto offerto **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;
- DITTA EUROMEDICAL SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There is a large, stylized signature at the top, followed by several smaller, more legible signatures below it, including one that appears to be 'Gottardo'.

LOTTO 5:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la **NON** sussistenza delle caratteristiche tecniche minime in quanto non risulta presente l'utilizzo come dilatatore colico nella scheda tecnica; conseguentemente dichiara il prodotto offerto **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;

LOTTO 6

- DITTA COOK SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA LORENZATTO SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,67** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Si dà atto che per il **lotto n. 7** non sono pervenute offerte da parte degli Operatori Economici.

LOTTO 9

La Commissione giudicatrice dà preliminarmente atto che la Ditta DITTA E.F.M. EMANUELE

IORE MANCINI SRL non ha presentato campionatura per il prodotto richiesto al lotto n.1 contravvenendo il par. 15 del Disciplinare di gara che richiede la campionatura per tutti i lotti a pena di esclusione. Pertanto la Ditta è ESCLUSA dalla gara.

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la non corrispondenza in particolare per *“Calibri dell'ago da 19 a 25 Gauge (disponibilità di tutte le misure)”* in quanto risulta assente la disponibilità di misure da 19 a calibri maggiori avendo dichiarato offerta di calibri 23 e 25 Gauge conseguentemente il prodotto offerto non corrisponde ai requisiti minimi. La Commissione dà atto che la Ditta ha presentato una dichiarazione di equivalenza per le misure offerte, tuttavia rigetta l'equivalenza rispetto alle due sole misure presentate ribadendo che la varietà di differenti calibri previsti nel capitolato non possono considerarsi equivalenti ai due proposti e dichiara il prodotto offerto **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;
- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **79,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **54,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la non corrispondenza per *“Calibri dell'ago da 19 a 25 Gauge (disponibilità di tutte le misure)”* in particolare risulta assente la disponibilità di misure calibri da 19 Gauge conseguentemente il prodotto offerto non

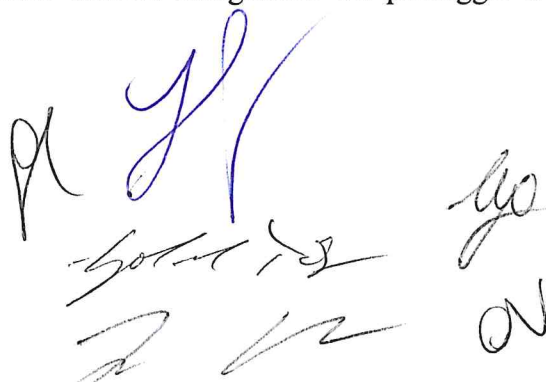


corrisponde ai requisiti minimi. La Commissione constata che il prodotto offerto è **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA PENTAX ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 11

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are four distinct signatures, some appearing to be 'M.G. Lorenzatto' and others being more stylized initials. The handwriting is cursive and somewhat messy, typical of a quick signature.

qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 12

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 14

- DITTA ASPEN SANITAS SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA AORTA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **40,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **51,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di



- qualità pari a punti **29,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **45,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **23,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA MEDITALIA SRL I/E La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA M.G. LORENZATTO SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **38,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA NEOS MEDICA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **21,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



- DITTA PENTAX ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **42,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **20,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto che NON SUPERA la soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 15

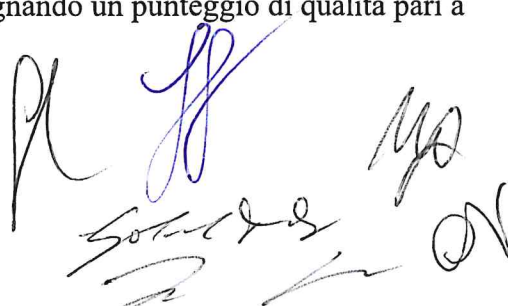
- DITTA APOLLO ENDOSURGERY UK La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 16

- DITTA ENDOVASCULAR SERVICE SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 17

- DITTA ASPEN SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a



punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **71,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

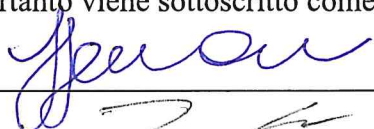


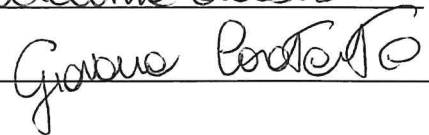
LOTTO 18

- DITTA ENDOVASCULAR SERVICE SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la NON sussistenza dei seguenti requisiti minimi:
 - a. Pinze ad ancora con punte verso l'esterno per agganciare il tessuto di piccole lesioni e fistole.
 - b. Pinze con due morsi ad apertura asimmetrica con comando separato per afferrare i lembi di tessuto in lesioni ampie.

La Commissione constata pertanto che il prodotto offerto è **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;

Alle ore 14.15 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani, in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi, in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 

LOTTO 4 - DILATATORI BILIARI A PALLONCINO A SCAMBIO RAPIDO										
REQUISITI MINIMI										
1	monouso									
	sterili									
	doppio lume									
	posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico									
	materiale plastico a bassa compliance									
	devono accettare il filo guida da 0.035.									
	Palloni di vari diametri e lunghezze.									
Compatibile con sistema a rapido scambio.										
USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio.										
REQUISITI PREFERENZIALI										
	RADIOPACITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE: La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione		PUNTEGGIO ASSEGNABILE		30					
	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE		PUNTEGGIO ASSEGNABILE		25					
	La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione									
	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE		PUNTEGGIO ASSEGNABILE		20					
	La commissione valuterà la migliore adattabilità , la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino.									
	VARIABILITÀ MASURE		PUNTEGGIO ASSEGNABILE		5					
	La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte.									
TOTALE PUNTEGGIO										

LOTTO 5 - DILATATORI A PALLONCINO COMPATIBILE CON SISTEMA RAPIDO SCAMBIO TRATTI GI

REQUISITI MINIMI	DITTA BOSTON				DITTA EUROMEDICAL			
monouso	X							
sterili	X							
esofagei	X							
pilorici colici e biliari	X				ASSENTE			
posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico (2.8)	X							
materiale plastico a bassa compliance	X							
devono accettare il filo guida da 0.035.	X							
La lunghezza operativa non deve essere inferiore a 180 cm.	X							
Palloni di vari diametri e lunghezze.	X							
Compatibile con sistema a rapido scambio.	X							
USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio.	X							

NON IDONEO										
IDONEO										
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	RADIOCAPACITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE: La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 30	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	GERMANI	RICCARDI	TORTI
			30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		FALSO	FALSO	FALSO
				1,00	1,00	1,00				
2	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 25	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	GERMANI	RICCARDI	TORTI
			25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		FALSO	FALSO	FALSO
				1,00	1,00	1,00				
3	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE La commissione valuterà la migliore adattabilità , la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 20	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	GERMANI	RICCARDI	TORTI
			20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		FALSO	FALSO	FALSO
				1,00	1,00	1,00				
4	VARIABILITÀ MISURE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 5	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	GERMANI	RICCARDI	TORTI
			5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		FALSO	FALSO	FALSO
				1,00	1,00	1,00				
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				0,00			

- GIUDIZIO**
 OTTIMO
 PIU' CHE ADEGUATO
 ADEGUATO
 PARZIALMENTE ADEGUATO
 SCARSAMENTE ADEGUATO
 INADEGUATO
- COEFFICIENTI**
 1,00
 0,80
 0,60
 0,40
 0,20
 0,00

LOTTO 15 - SISTEMA DI SUTURA CHIRURGICA-ENDOSCOPICA CON MANIPOLO

REQUISITI MINIMI	DITTA APOLLO ENDOSURGERY UK
manipolo da applicare ad endoscopio n grado di effettuare suture continue o a punti staccati, a pieno spessore	X
lunga durata	X
in grado di effettuare suture continue o a punti staccati	X
dotato di manipolo	X
con sistema monouso a vite continua per il trazionamento della mucosa gastrica	X
con sistema di serraggio della sutura in PTFE	X
suture in Polidossanone con ancoretta di innesto all'Anchor Exchange	X
suture in Polipropilene con ancoretta di innesto all'Anchor Exchange	X
Overtube (lunghezza 27 cm – diametro 16,7mm)	X

IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI

VALUTAZIONE COMMISSIONE

	MANOVRABILITÀ DEL DEVICE La commissione valuterà con il maggior punteggio il device che più facilmente può essere manovrabile esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
1		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
	ATRAUMATICITA'	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
2	La commissione valuterà con il maggior punteggio al device che presenta da relazione e scheda tecnica la minore traumaticità sulle pareti del viscere.	25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
	TENUTA DEI PUNTI DI SUTURA La commissione valuterà con il maggior punteggio ai punti che presentano maggiore presa e minore traumatismo una volta rilasciati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
3	Scheda relazione tecnica e letteratura scientifica.	30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			80,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 16 - SISTEMA GASTROINTESTINALE DI SUTURA ENDOSCOPICA MONOUSO A CONTROLLO IDRAULICO

REQUISITI MINIMI	DITTA ENDOVASCULAR SERVICE SRL
monouso a controllo idraulico per la plicatura a tutto spessore della parete dello stomaco nel trattamento di GERD, GIST, fistole e perforazioni	X
applicatore monouso con canale integrato per l'introduzione di un endoscopio pediatrico	X
cartucce con punti di sutura riassorbibili e non riassorbibili	X
placca di protezione del tessuto	X
elica retrattore del tessuto	X
filo guida Savary	X
	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	MANOVRABILITÀ DEL DEVICE La commissione valuterà con il maggior punteggio il device che più facilmente può essere manovrabile esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	ATRAUMATICITA' La commissione valuterà con il maggior punteggio al device che presenta da relazione e scheda tecnica la minore traumaticità sulle pareti del viscere.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	TENUTA DEI PUNTI DI SUTURA La commissione valuterà con il maggior punteggio ai punti che presentano maggiore presa e minore traumatismo una volta rilasciati. Scheda relazione tecnica e letteratura scientifica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

LOTTO 17 - CARCATORE PER LEGATURA VARICI

REQUISITI MINIMI		DITTA ASPEN SRL				DITTA BOSTON SCIENTIFIC				DITTA COOK ITALIA SRL			
Disponibile nel caricamento da 4 a 10 lacci.		X				X				X			
Dotato di valvola per irrigazione		X				X				X			
Dotato di dispositivo di bloccaggio		X				X				X			
Dotato di segnalazione di rilascio dell'elastico		X				X				X			
Monouso		X				X				X			
Compatibile con strumenti endoscopici di vari diametri.		X				X				X			

REQUISITI PREFERENZIALI		IDONEO						IDONEO						IDONEO					
		VALUTAZIONE COMMISSIONE						VALUTAZIONE COMMISSIONE						VALUTAZIONE COMMISSIONE					
MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA IN PARTICOLARE SUL SISTEMA DI BLOCCAGGIO 1 La Commissione valuterà con maggior punteggio il device che garantisce un sistema di bloccaggio più sicuro ed efficace.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI		
	25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18,33333333	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0,60	0,80	0,80	0,80	25	1,00	1,00	1,00		
			1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00						
SEMPLICITÀ E STABILITÀ DI MONTAGGIO 2 La Commissione valuterà con maggior punteggio il sistema che presenta la facilità maggiore di montaggio e migliore stabilità del sistema una volta assemblato.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI		
	20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	20	1,00	1,00	1,00		
			1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00							
ERGONOMICITÀ 3 La Commissione valuterà con maggior punteggio il sistema che presenta la migliore ergonomia.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI		
	10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0,80	0,80	0,80	0,80	10	1,00	1,00	1,00		
			1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00						
VISIBILITÀ ENDOSCOPICA 4 La Commissione valuterà con maggior punteggio il device che consente la migliore visibilità endoscopica dopo l'assemblaggio del legatore.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI		
	25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	25	1,00	1,00	1,00		
			1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00							
TOTALE PUNTEGGIO		80,00	71,33						80,00										

GIUDIZIO

OTTIMO

PIU' CHE ADEGUATO

ADEGUATO

PARZIALMENTE ADEGUATO

SCARSAMENTE ADEGUATO

INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 18 - SISTEMA DI CLIP OVER THE SCOPE

REQUISITI MINIMI	DITTA ENDOVASCULAR SERVICE	DITTA M.G. LORENZATTO
Sistema di Clip Over The Scope, per il trattamento endoscopico di perforazioni della parete gastrointestinale, di fistole post-chirurgiche e di deiscenze anastomotiche, di sanguinamenti di lesioni e da grossi vasi. Sistema rimovibile. Set contenente	X	
A- Un manipolo, un cappuccio con premontata la clip ed un filo di sutura intracanalare (da 165 cm e 220cm) collegato al cappuccio che consente il rilascio della clip	X	
Clip disponibile a denti smussi, mediamente appuntiti e appuntiti con morso da 9,0, 10,0 e 11,0 mm	X	
Cappucci compatibili con tutti gli endoscopi (gastro e colon) di diametro da 8,5 a 14 mm	X	
B- Pinze ad ancora con punte verso l'esterno per agganciare il tessuto di piccole lesioni e fistole.	X	ASSENTE
Lunghezza 2200 mm e 1650 mm; diametro 2,4 mm	X	
compatibile con endoscopi dotati di canale operativo da 2,8 mm	X	
C - Pinze con due morsi ad apertura asimmetrica con comando separato per afferrare i lembi di tessuto in lesioni ampie	X	ASSENTE
Lunghezza 2200 mm e 1650 mm	X	
di diametro 2,6 mm;	X	
Compatibile con endoscopi dotati di canale operativo da 3,2 mm	X	
D- Sistema di clip metallica monouso per il trattamento dei sanguinamenti, rotante e riposizionabile con possibilità di aprire e chiudere più volte la clip prima del rilascio definitivo.	X	
Rotazione a 360° tramite sistema integrato e dedicato a manopola	X	
Apertura fino a 16,5 mm, angolo 135°, lunghezze di lavoro da 165, 230 e 270 cm;	X	
E- Sistema di Clip metallica in nitinol per la chiusura di fistole retto-vaginali e ano-rettali composto da: Clip in nitinol precaricate su sistema, applicatore a pistola, chiusura a tagliola, denti appuntiti; scovolino per cruentazione;	X	
F- Set per la rimozione di clip OTSC e/o FTRD composto da catetere flessibile a corrente continua bipolare, cappuccio per la retrazione sicura dei frammenti di clip e pinza per la rimozione della clip	X	ASSENTE
Catetere lungo 220cm, compatibile con canale operativo da 2,8 mm	X	
pinza lunga 220 cm	X	
apertura del morso 130°.	X	

IDONEO
NON IDONEO
REQUISITI PREFERENZIALI
VALUTAZIONE COMMISSIONE
VALUTAZIONE COMMISSIONE

	VERSATILITÀ APPLICATORE E MANOVRABILITÀ DEL SISTEMA Maggiore punteggio all'applicatore in grado di esercitare la funzione propria in condizioni critiche., retroversione; valutazione in vitro del sistema di montaggio dell'intero device. Esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
1		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
	TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità e diametro di presa. Inoltre verrà valutata in vitro della capacità di eseguire una chiusura efficace e sicura	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
2		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
	DISPONIBILITÀ DIVERSE MISURE Maggiore punteggio alla maggiore varietà di fogge e misure offerte	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
3		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
	FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
4		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
	FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
5		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0			
				1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				0,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

LOTTO 11 - AGHI TIPO CARR LOCKE PER TERAPIA INIETTIVA						
REQUISITI MINIMI			DITTA M.G. LORENZATTO SRL			
monouso			X			
sterile			X			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza del device. Valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	SCORREVOLEZZA DELL'AGO NELLA GUAINA DURANTE LA MANOVRA La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza dell'ago. Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	AFFILATURA E CAPACITÀ DI PENETRAZIONE DELL'AGO NEI TESSUTI La commissione valuterà la maggiore affilatura e capacità di penetrazione Valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	QUALITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA FUORIUSCITA DELL'AGO La commissione valuterà la migliore qualità del sistema di controllo della fuoriuscita dell'ago Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 12 - AGHI TIPO CARR LOCKE PER TERAPIA INIETTIVA PER DUODENOSCOPIO

REQUISITI MINIMI	DITTA M.G. LORENZATTO
monouso	X
sterile	X
flessibile	X

IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI

VALUTAZIONE COMMISSIONE

1	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza del device. Valutazione in vitro.	30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	SCORREVOLEZZA DELL'AGO NELLA GUAINA DURANTE LA MANOVRA	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza dell'ago. Valutazione in vitro	25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	AFFILATURA E CAPACITÀ DI PENETRAZIONE DELL'AGO NEI TESSUTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	La commissione valuterà la maggiore affilatura e capacità di penetrazione Valutazione in vitro.	20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	QUALITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA FUORIUSCITA DELL'AGO	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	La commissione valuterà la migliore qualità del sistema di controllo della fuoriuscita dell'ago Valutazione in vitro	5	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 6 - DILATATORI BILIARI MECCANICI PER DILATAZIONE PROGRESSIVA
REQUISITI MINIMI
monouso
sterili (varie misure)
materiale plastico utilizzabili su filo guida sotto controllo radiologico ed endoscopico, con calibro variabile in punta
devono accettare il filo guida da 0.035.
La lunghezza utilizzabile non deve essere inferiore ai 180 cm
diametri da 4 a 12 fr. circa.

DITTA COOK ITALIA	DITTA M.G. LORENZATTO
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà la maggiore maneggevolezza e maggior scorrevolezza del sistema. La valutazione è eseguita sul campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16,66666667	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,80
2	RASTREMATURA E ATRAUMATICITÀ DEL SISTEMA La commissione valuterà la maggiore rastrematura e maggior atraumaticità del sistema. Valutazione in vitro della consistenza del materiale della campionatura	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	21,66666667	OTTIMO	ADEGUATO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	0,60	1,00
3	RADIOPACITÀ E VISIBILITÀ La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,60	0,80
4	DISPONIBILITÀ DI VARIE MISURE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				61,67			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 9 - AGHI PER TERAPIA INIETTIVA																																			
REQUISITI MINIMI			DITTA ASPEN			DITTA BOSTON			DITTA E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI			DITTA EUROMEDICAL			DITTA H.D. HEALTH DEFENCE			DITTA M.G. LORENZATTO			DITTA MEDITALIA			DITTA OLYMPUS			DITTA PENTAX								
monouso			X			X			X			X			X			X			X			X			X								
sterili, per terapia iniettiva			X			X			X			X			X			X			X			X			X								
Punta a becco di flauto dotati di fermo di avanzamento			X			X			X			X			X			X			X			X			X								
camicia interna ed esterna in teflon			X			X			X			X			X			X			X			X			X								
diametro per canale operativo 1,8 mm e 2,8 mm			X			X			X			X			X			X			X			X			X								
Varie lunghezze del cuneo.			X			X			X			X			X			X			X			X			X								
Calibri dell'ago da 19 a 25 Gauge (disponibilità di tutte le misure)			X			ASSENTE			ASSENTE			ASSENTE			ASSENTE			X			X			X			X								
			IDONEO			NON IDONEO			ASSENZA DI CAMPIONATURA			IDONEO			NON IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO								
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE								
1 SCORREVOLEZZA DEL DEVICE La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza del device. Valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
			OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		0					0					12		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO		0					12	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	12	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO
			1,00	1,00	1,00			FALSO	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	FALSO	0,60		0,60	0,60			FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2 SCORREVOLEZZA DELL'AGO NELLA GUAINA DURANTE LA MANOVRA La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza dell'ago. Valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
			OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		0					0					20		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		0					10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO
			1,00	1,00	1,00			FALSO	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	FALSO	0,80		0,80	0,80			FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3 AFFILATURA E CAPACITÀ DI PENETRAZIONE DELL'AGO NEI TESSUTI La commissione valuterà la maggiore affilatura e capacità di penetrazione. Valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
			OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		0					0					13,33333333		ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO		0					8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO
			1,00	1,00	1,00			FALSO	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	FALSO	0,60		0,80	0,60			FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4 QUALITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA FUORIUSCITA DELL'AGO La commissione valuterà la migliore qualità del sistema di controllo della fuoriuscita dell'ago. Valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
			OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		0					0					3,33333333		ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO		0					2	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	2	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO
			1,00	0,80	0,80			FALSO	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	FALSO	0,60		0,80	0,60			FALSO	FALSO	FALSO		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
TOTALE PUNTEGGIO		79,33				0,00				0,00				54,67				0,00				32,00				32,00				32,00					

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Pl
JF ov
Gola 7-22
Zr

LOTTO 14 - CLIP MONOUSO ROTANTE A 360°																										
REQUISITI MINIMI			DITTA ASPEN SRL			DITTA AORTA SRL			DITTA BOSTON SCIENTIFIC			DITTA COOK ITALIA SRL			DITTA EUROMEDICAL SRL			DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA								
monouso			X			X			X			X			X			X								
sterile			X			X			X			X			X			X								
rotante a 360°			X			X			X			X			X			X								
precaricata, con possibilità di riapertura multipla			X			X			X			X			X			X								
Lunghezza oltre 200 cm (discostamento non oltre il 10%)			X			X			X			X			X			X								
compatibile con tutti gli strumenti endoscopici			X			X			X			X			X			X								
Utilizzabile in canale di lavoro almeno da 2.8 mm.			X			X			X			X			X			X								
			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO								
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE								
1	RESISTENZA ALLO STRESS DI APPLICAZIONE La commissione valuterà con maggior punteggio la risposta della CLIP allo stimolo di rotazione con strumento in retroflessione e in caso di utilizzo con strumento a visione laterale.Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 40	PUNTEGGIO CONSEGUITO 40	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 24	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 18,66666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		0,20	0,20	0,20		0,60	0,60	0,60		0,20	0,20	0,20		0,60	0,40	0,40		0,20	0,20	0,20
				1,00	1,00	1,00																				
2	TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità di chiusura: valutazione in vitro della capacità di mantenere le valve ravvicinate una volta chiusa la clip.Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 20	PUNTEGGIO CONSEGUITO 20	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,20	0,20	0,20
				1,00	1,00	1,00																				
3	DISPONIBILITÀ DIVERSE MISURE Maggiore punteggio alla maggiore varietà di fogge e misure offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 15	PUNTEGGIO CONSEGUITO 15	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 6	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 6	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60
				1,00	1,00	1,00																				
4	FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 5	PUNTEGGIO CONSEGUITO 5	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 2,666666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,40	0,60	
				1,00	1,00	1,00																				
TOTALE PUNTEGGIO			80,00			40,00			51,00			29,00			45,67			23,67								

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 14 - CLIP MONOUSO ROTANTE A 360°																							
REQUISITI MINIMI			DITTA MEDITALIA SRL I/E				DITTA M.G. LORENZATTO SRL				DITTA NEOS MEDICA SRL				DITTA OLYMPUS ITALIA SRL				DITTA PENTAX ITALIA SRL				
monouso			X				X				X				X				X				
sterile			X				X				X				X				X				
rotante a 360°			X				X				X				X				X				
precaricata, con possibilità di riapertura multipla			X				X				X				X				X				
Lunghezza oltre 200 cm (discostamento non oltre il 10%)			X				X				X				X				X				
compatibile con tutti gli strumenti endoscopici			X				X				X				X				X				
Utilizzabile in canale di lavoro almeno da 2.8 mm.			X				X				X				X				X				
			IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
1	RESISTENZA ALLO STRESS DI APPLICAZIONE La commissione valuterà con maggior punteggio la risposta della CLIP allo stimolo di rotazione con strumento in retroflessione e in caso di utilizzo con strumento a visione laterale.Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		40	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	10,66666667	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	18,66666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	
				0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	0,40		0,60	0,40	0,40					
2	TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità di chiusura: valutazione in vitro della capacità di mantenere le valve ravvicinate una volta chiusa la clip.Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	4	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	5,333333333	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	6,66666667	ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	
				0,40	0,40	0,40		0,60	0,60	0,60		0,20	0,20	0,20		0,20	0,40	0,60		0,20	0,20		
3	DISPONIBILITÀ DIVERSE MISURE Maggiore punteggio alla maggiore varietà di fogge e misure offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	6	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	3	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,40		0,20	0,20	0,20		1,00	1,00	1,00	
4	FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		5	1	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	1	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	2,333333333	ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	
				0,20	0,20	0,20		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,20	0,20	0,20		0,60	0,20	0,60	
TOTALE PUNTEGGIO			32,00				38,00				21,00				20,00				42,67				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

