

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI GARA E INDIZIONE. CODICE GARA ANAC 8749975

VERBALE N. 1 DEL 02/12/2022

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna “F” della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l’80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell’art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell’alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell’intero appalto è di seguito illustrato.

- o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui al par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista

la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.

- In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;
- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;



- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'amministratore unico di Puntozero Scarl è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E con le funzioni di segretario verbalizzante assegnate alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

TANTO PREMESSO

Si dà atto che in data odierna 02/12/2022 a partire dalle ore 9.15 presso la Sede di Puntozero scarl, si è riunita la Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto e della Dott.ssa Valentina Alabastri di PuntoZero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione è riunita per la valutazione tecnica dei lotti da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; a tale scopo verifica e dà atto della integrità delle campionature pervenute e del loro imballaggio prendendo in custodia le stesse che resteranno conservate presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità

GH
up
all
Germani
Giovanna Carotenuto
Valentina Alabastri

tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla *lex specialis* par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.


La Commissione procede a tutte le incombenze ad essa delegate dal Disciplinare di gara il cui esito è sinteticamente riportato di seguito mentre il relativo dettaglio valutativo complessivo (corrispondenza alle caratteristiche minime e valutazione di qualità) viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale:

LOTTO 1:

La Commissione giudicatrice dà preliminarmente atto che la Ditta COOK ITALIA SRL non ha presentato campionatura per il prodotto richiesto al lotto n.1 contravvenendo il par. 15 del Disciplinare di gara che richiede la campionatura per tutti i lotti a pena di esclusione. La Commissione dà atto che risulta presentato il manometro con siringa di gonfiaggio il cui invio tuttavia non era espressamente richiesto mentre manca il dispositivo richiesto.

Per tale ragione la Ditta COOK ITALIA SRL è **ESCLUSA** dal lotto n.1

- **DITTA EUROMEDICAL SRL:** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la **NON** sussistenza delle caratteristiche tecniche minime in quanto non risulta presente l'utilizzo come dilatatore colico nella scheda tecnica; conseguentemente dichiara il prodotto offerto **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;
- **DITTA INNOVAMEDICA SPA:** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **72,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- **DITTA OLYMPUS ITALIA SRL :** La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di

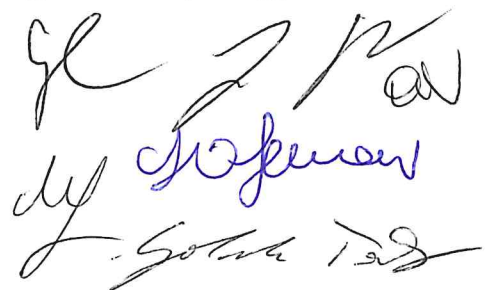

qualità pari a punti **53,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA LORENZATTO SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **50,33** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,33** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,33** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 2:

- DITTA COOK ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **65,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di




qualità pari a punti **55,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- **DITTA LORENZATTO SRL** : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **47,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- **DITTA OLYMPUS ITALIA SRL** : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- **DITTA EUROMEDICAL SRL**: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **72,33** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 3

- **DITTA ASPEN SANITAS SRL**: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la **NON** sussistenza delle caratteristiche tecniche minime seguenti: *“Il diametro del palloncino deve variare da 30 mm a 40 mm circa.”* mente il prodotto offerto risulta alla dimensione massima 34mm, e cioè inferiore di 6mm rispetto ai 40mm richiesti, e quindi non funzionalmente equivalente alle dimensioni previste da capitolato; conseguentemente dichiara il prodotto offerto **NON IDONEO** precludendo l'accesso alla fase successiva di gara;
- **DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA**: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il


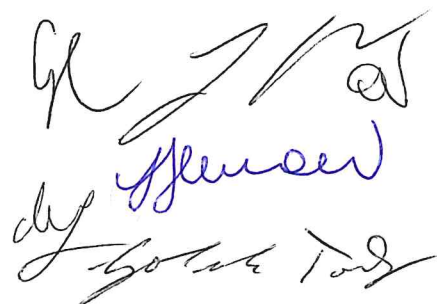



prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA LORENZATTO SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **34,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del MANCATO SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **65,00** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Alle ore 14.00 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - il segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 



REQUISITI MINIMI		DITTA INNOVAMEDICA				DITTA OLYMPUS ITALIA				DITTA LORENZATTO				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SRL				DITTA EUROMEDICAL				DITTA BOSTON SCIENTIFIC				DITTA COOK ITALIA				
monouso		X				x				X				X				X				X								
sterili		X				x				X				X				X				X								
esofagei		X				x				X				X				X				X								
pilorici		X				x				X				X				X				X								
colici		X				x				X				X				ASSENTE				X								
posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico (la cui misura è 2.8 mm)		X				x				X				X								X								
materiale plastico a bassa compliance		X				X				X				X								X								
devono accettare il filo guida da 0,035.		X				x				X				X								X								
La lunghezza operativa non inferiore a 180 cm.		X				X				X				X								X								
Palloni di diametri da 6 a 20mm di varie lunghezze.		X				X				X				X								X								
USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio.		X				X				X				X								X								
		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				NON IDONEO				IDONEO				MANCANZA DELLA CAMPIONATURA				
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
1	RADIOPACITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE: La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	22	OTTIMO	ADEGUATO	ADEGUATO	16	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0			
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	1,00		0,60	0,60	0,60		0,40	0,60	FALSO		FALSO	FALSO	0,80		0,80	0,80	FALSO		FALSO	FALSO	
2	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	13,33333333	ADEGUATO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0			
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,40		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO
3	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE La commissione valuterà la migliore adattabilità , la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	18,66666667	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	13,33333333	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				17,33333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0			
				1,00	0,80	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,80	FALSO		FALSO	FALSO	1,00		0,80	0,80	FALSO		FALSO	FALSO	
4	VARIABILITÀ MISURE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0				3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0			
				1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,40		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO
TOTALE PUNTEGGIO		72,67				53,00				50,33				48,33				0,00				64,33				0,00				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

CA L PR
Gemma
Goleto Tard
al
ly

LOTTO 2 - DILATATORI PALLONCINO BILIO PANCREATICI																							
REQUISITI MINIMI		DITTA COOK				DITTA INNOVAMEDICA				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA OLYMPUS				DITTA EUROMEDICAL					
monouso		X				X				X				X				X					
sterili		X				X				X				X				X					
doppio lume		X				X				X				X				X					
posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico		X				X				X				X				X					
materiale plastico a bassa compliance		X				X				X				X				X					
devono accettare il filo guida da 0.035.		X				X				X				X				X					
La lunghezza operativa non inferiore a 180 cm.		X				X				X				X				X					
Palloni di vari diametri e lunghezze		X				X				X				X				X					
USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio.		X				X				X				X				X					
		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO					
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE					
1	RADIOCAPITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE: La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80	
2	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	23,33333333	OTTIMO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	
				0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	0,80	
3	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE La commissione valuterà la migliore adattabilità , la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		
4	VARIABILITÀ MISURE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		5	3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	2	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		0,40	0,40	0,40		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00	
TOTALE PUNTEGGIO			65,00				55,00				47,00				62,00				72,33				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

fe 2 R
genu
Gola Tard
av
uf

LOTTO 3 - DILATATORI A PALLONCINO PER ACALASIA																		
REQUISITI MINIMI			DITTA ASPEN				DITTA BOSTON				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA OLYMPUS			
monouso							X				X				X			
sterili							X				X				X			
con demarcazione radiologica sulla punta distale							X				X				X			
posizionabili su filo guida							X				X				X			
materiale plastico a bassa compliance							X				X				X			
La lunghezza operativa non inferiore a 90 cm.							X				X				X			
Il diametro del palloncino deve variare da 30 mm a 40 mm circa.			ASSENTE				X				X				X			
USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio.							X				X				X			
			NON IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	RADIOPACITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE: La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	0				30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
2	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	0				25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	11,66666667	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	16,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,60		0,80	0,60	0,60
3	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE La commissione valuterà la migliore adattabilità , la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	0				20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0	INADEGUATO	INADEGUATO	INADEGUATO	13,33333333	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,60	0,60	0,80
4	VARIABILITÀ MISURE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	0				5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
TOTALE PUNTEGGIO			0,00				80,00				34,67				65,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]