

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D'ASTA € 14.323.878,00, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI

VERBALE N. 12 DI SEDUTA RISERVATA

Scioglimento riserva ammissione O.E. e valutazione documentazione tecnica

(08/11/2022)

PREMESSO

- che con nota dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 26/07/2022, la Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore amministrativo professionale presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, veniva nominata RUP della presente procedura;
- che con DDG dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, veniva confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 37, D. Lgs. n. 50/2016;
- che con la medesima DDG n. 331/2022, la Rag. Barbara Bazzucchi, dipendente in servizio presso la Direzione Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, veniva individuata quale supporto amministrativo al RUP per l'espletamento della gara in oggetto;
- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:
 - o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari
 - o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi de Vermandois
 - o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti
 - o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro
- che, con riferimento alla presente procedura, il RUP e il Tavolo Tecnico sottoscrivevano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, conservate agli atti di Punto Zero S.c. a r.l.;
- che con Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 22/06/2022 veniva autorizzata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici urogenitali, suddivisa in 89 lotti per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- che per i lotti dal n. 1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82, il Tavolo Tecnico ha stabilito di procedere all'aggiudicazione degli stessi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da aggiudicare individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, mediante assegnazione di un massimo di 100 punti di cui: 70 punti da attribuire a favore dell'offerta tecnica e 30 punti da attribuire a favore dell'offerta economica.
- che il bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE 2022/S 122-346306 del 28/06/2022, sulla GURI n. 75 del 29/06/2022 e, altresì, unitamente alla restante documentazione di gara, sul sito istituzionale

- di Punto Zero S.c. a r.l. <https://puntozeroscarl.it/> e sulla piattaforma Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, indicando la data dell'08/08/2022, ore 13:00 come termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- che in data 09/08/2022 si procedeva all'apertura delle offerte economiche presentate dagli O.E. concorrenti per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e precisamente: n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89;
 - che nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara procedeva ad escludere l'O.E. Benefis S.r.l. per mancata presentazione dell'offerta economica e dava atto che nessuna offerta era pervenuta per i lotti 36, 74, 76, 77, 78, 83, 85, 86;
 - che per i suddetti lotti, da aggiudicare al minor prezzo, i referenti tecnici di supporto al RUP, Dr.ssa Eleonora Salvini e Dr. Francesco Fagotti, procedevano alla verifica dell'idoneità tecnica delle offerte pervenute e per l'effetto il RUP, preso atto delle offerte economiche e delle offerte tecniche, formulava proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante (cfr. verbale n. 9 dell'11/10/2022);
 - che con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 19/08/2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice chiamata a valutare le offerte pervenute per i lotti oggetto della presente procedura;
 - che con il medesimo provvedimento, la Dott.ssa Francesca Gernini veniva nominata segretario verbalizzante;
 - che la Commissione Giudicatrice e il Segretario verbalizzante hanno dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse con riguardo alla presente procedura, compilando apposita dichiarazione, trasmessa a PuntoZero unitamente ai curricula dei componenti della Commissione;
 - che in data 29/09/2022 la Commissione Giudicatrice dava avvio alle operazioni di apertura della documentazione tecnica presentata dagli O.E. concorrenti e di verifica della completezza della stessa per i lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - in esito alla suddetta seduta, la Commissione rilevava, preliminarmente, che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08/08/2022 ore 13:00 pervenivano le offerte degli operatori economici di seguito indicati:

Fornitore	Lotti
B BRAUN MILANO S.P.A.	18
BENEFIS S.R.L.	19, 20
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	40, 42, 43, 45, 47, 52, 53, 65, 80, 81, 82
CLINI-LAB S.R.L.	22, 24, 26, 32, 33, 35
CO.DI.SAN. S.P.A.	22, 23, 24, 25, 26
COLMA S.R.L.	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 65, 81
COLOPLAST S.P.A.	1, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 7, 71, 72, 73, 80, 81
COOK ITALIA S.R.L.	3, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 65, 81, 82
DBI S.R.L.	67, 68, 69

DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	67, 69
FERMED S.R.L.	67
HOLLISTER S.P.A.	8, 9, 14
MEDICA S.P.A.	61, 62, 64
MEDIMAR S.R.L.	61
MEDIVAL S.R.L.	3, 31, 35, 38, 65, 80, 81,
OLINTO MARTELLI S.R.L.	2, 7, 22, 26, 35
SEDA S.P.A.	46, 48
TAU MEDICA S.R.L.	40, 43, 65, 80, 81
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	7, 8, 16, 17, 26, 30, 59
UROMED S.R.L.	41, 51, 52, 65, 66, 80, 81
WELLSPECT S.R.L.	10, 11

- che in esito alla suddetta seduta, la Commissione Giudicatrice:
 - o disponeva di richiedere agli operatori economici, B BRAUN MILANO S.P.A. e CLINI-LAB S.R.L., la dichiarazione di conformità ai requisiti di minima di cui agli artt. 4, 6 Capitolato Speciale Prestazionale e Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", da rendere ai sensi degli artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il modello 7, già nella disponibilità degli O.E., in quanto trattasi di mera integrazione che non modifica il contenuto dell'offerta tecnica già presentata;
 - o demandava al RUP le decisioni circa la firma digitale apposta da CLINI-LAB S.R.L. sui singoli file .pdf contenuti nella cartella .zip e non già in quest'ultima;
 - o rilevava la completezza della documentazione tecnica presentata dagli altri O.E. concorrenti e per l'effetto, procedeva, quindi, all'ammissione degli Operatori Economici alla successiva fase della procedura di gara, come di seguito indicato:

Fornitore	Esito
B BRAUN MILANO S.P.A.	ammesso
BENEFIS S.R.L.	ammesso
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	ammesso
CLINI-LAB S.R.L.	Ammesso con riserva
CO.DI.SAN. S.P.A.	ammesso
COLMA S.R.L.	ammesso
COLOPLAST S.P.A.	ammesso

- che il RUP, nel corso della seduta del 04/10/2022, alla presenza dei testimoni, dava atto che l'offerta tecnica presentata da CLINI-LAB S.R.L. doveva ritenersi conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara (cfr. verbale n. 6 del 04/10/2022) e rimetteva alla Commissione Giudicatrice lo scioglimento della riserva sull'ammissione dell'O.E. CLINI-LAB S.R.L. al prosieguo della procedura;
- che in data 11/10/2022, la Commissione Giudicatrice, proseguiva in seduta pubblica, l'apertura della documentazione tecnica e la verifica della completezza della stessa e, precisamente:

- sulla base di quanto constatato dal RUP (cfr. verbale n. 4 del 04/10/2022), ammetteva al prosieguo della procedura l'O.E. CLINI-LAB S.R.L.;
- dava atto che Tau Medica Srl non produceva il mod. 7 e, per l'effetto, ne disponeva la richiesta di integrazione;
- rimetteva al RUP le valutazioni in merito all'eventuale presenza di collegamento tra D.B.I. Srl e Boston Scientific S.p.A. e tra Medival Srl e Uromed Srl;
- si riservava di svolgere approfondimenti in ordine all'offerta tecnica presentata da UROMED S.r.l., relativamente alle informazioni richieste agli O.E., da riportare nella relazione tecnica, in quanto non risultava presente un documento denominato "Relazione Tecnica";
- procedeva, quindi, all'ammissione degli Operatori Economici alla successiva fase della procedura di gara, come di seguito indicato:

Fornitore	Esito
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Ammesso con riserva
COOK ITALIA SRL	Ammesso
D.B.I. SRL	Ammesso con riserva
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	Ammesso
FERMED S.R.L.	Ammesso
HOLLISTER S.P.A.	Ammesso
MEDICA S.P.A.	Ammesso
MEDIMAR S.R.L.	Ammesso
MEDIVAL S.R.L.	Ammesso con riserva
OLINTO MARTELLI S.R.L.	Ammesso
SEDA S.P.A.	Ammesso
TAU MEDICA S.R.L.	Ammesso
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	Ammesso
UROMED S.R.L.	Ammesso con riserva
WELLSPECT S.R.L.	Ammesso

- che il RUP, alla presenza dei testimoni, preso atto di quanto constatato dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta dell'11/10/2022, disponeva di richiedere chiarimenti agli O.E. (cfr. verbale n. 11 del 12/10/2022), ai sensi dell'art. 85, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di scongiurare la presenza di collegamento tra D.B.I. S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., nonché tra Medival Srl e Uromed S.r.l., in particolare, richiedendo agli stessi dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R.

- 28.12.2000, n. 445, in ordine all'assenza di collegamento tra i medesimi e di fornire ogni documentazione utile a comprovare quanto eventualmente dichiarato (es. visura camerale, etc.);
- che il RUP, rilevava che, per mero errore materiale, nella richiesta di chiarimenti inoltrata a UROMED SRL era stata riportata la denominazione sociale di DBI SRL in luogo di MEDIVAL SRL e, pertanto, con PEC del 31/10/2022, inoltrata tramite la piattaforma NET4MARKET, richiedeva a UROMED SRL di fornire chiarimenti in ordine ai rapporti con MEDIVAL SRL;
 - che con nota prot. n. 74402 del 03/11/2022, veniva convocata la Commissione Giudicatrice per sciogliere la riserva sull'ammissione degli O.E. D.B.I. S.r.L., Boston Scientific S.p.A., Medival Srl e Uromed S.r.l., nonché per dare avvio all'attività di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura pervenuta.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di Novembre, ore 09.00 in Perugia, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 Perugia, Ellisse 5° piano sono presenti, quali componenti della Commissione Giudicatrice:

Dr. Francesco Fagotti	Dirigente Farmacista Azienda USL Umbria 1	Presidente
Dr. Paolo Guiggi	Dirigente Medico SC Urologia Azienda Ospedaliera di Perugia	Componente
Dr.ssa Eleonora Salvini	Dirigente Medico U.O. Urologia Azienda Ospedaliera di Foligno	Componente

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore amministrativo professionale presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. E' presente, inoltre, la Rag. Barbara Bazzucchi, in qualità di supporto amministrativo al RUP, coadiutore amministrativo senior presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. La Commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", previsti a pena di esclusione ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale prestazionale, nonché del criterio di aggiudicazione della gara, stabilito all'art. 18 del Disciplinare di gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione di cui all'art. 18.1 e secondo le modalità previste dalle Tabelle dei criteri di valutazione.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione Giudicatrice alle ore 09.00 di oggi 8 Novembre 2022

- prende atto, preliminarmente, che gli O.E. interessati dalle richieste di chiarimenti circa la presenza di eventuale collegamento, hanno fornito riscontro come segue:

- Boston Scientific S.p.A: PEC prot. n. 9596 del 19/10/2022;
- DBI Srl: PEC prot. n. 9414 del 13/10/2022;
- MEDIVAL SRL: PEC prot. n. 9628 del 19/10/2022;
- UROMED SRL: PEC prot. n. 9410 del 13/10/2022 + PEC prot. n. 10055 del 02/11/2022;
- in ordine ai chiarimenti resi, sentito il RUP, dall'analisi delle visure camerali prodotte e dalle dichiarazioni rese, dà atto dell'assenza di indici rivelatori di potenziale collegamento, come elaborati dalla giurisprudenza maggioritaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, etc. tra gli O.E. Boston Scientific S.p.A. e DBI Srl e tra gli O.E. MEDIVAL SRL e UROMED SRL e, in quanto:
 - DBI SRL è concessionario di vendita esclusivo della Boston Scientific Spa per la linea di prodotti Ginecologia, su tutto il territorio nazionale italiano. Inoltre, non partecipano agli stessi lotti;
 - i dispositivi offerti in gara da MEDIVAL SRL sono prodotti dalla Ditta Uromed Kurt Drews KG, Meessen /11, D-22113 Oststeinbek – Germania - Azienda esportatrice: Uromedex Export GmbH, operatore economico diverso da UROMED SRL, concorrente nell'ambito della presente procedura;
- dà atto che TAU MEDICA SRL ha inoltrato il mod. 7 "Dichiarazione di conformità ai requisiti di minima";
- procede ad esaminare la documentazione tecnica inoltrata da UROMED SRL. Preliminarmente prende atto che l'art. 16 del Disciplinare di gara richiedeva che la relazione tecnica fosse articolata secondo specifiche corrispondenti ai criteri di cui alla "Tabella parametri di valutazione", allegata al Disciplinare. Pertanto, procede a verificare la documentazione tecnica presentata da UROMED SRL, per ciascun lotto di partecipazione ed in particolare controlla se nella stessa siano riportate le specifiche corrispondenti ai criteri di cui alla Tabella parametri di valutazione, come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto, procede lotto per lotto e verifica quanto segue:
 - LOTTO 41: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
 - LOTTO 51: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
 - LOTTO 52: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
 - LOTTO 65: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
 - LOTTO 66: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
 - LOTTO 80: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
 - LOTTO 81: PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE CORRISPONDENTI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
- procede, quindi:
 - all'apertura dei plichi ancora sigillati contenenti la campionatura pervenuta per i lotti da n. 1 a n. 35, presentata dagli O.E. concorrenti di cui alla tabella riepilogativa sopra riportata;
 - all'analisi generale della documentazione tecnica e all'esame della stessa, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 "Specifiche Tecniche e requisiti minimi";
 - all'esame della campionatura pervenuta;
 - all'attività valutativa finalizzata all'attribuzione dei punteggi tecnici previsti nella "Tabella criteri di valutazione", allegata al Disciplinare di gara;

- rileva che per i lotti da n. 7 a n. 20 il sub-criterio di valutazione: "Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica" non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell'espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dà atto che per il sub-criterio in discorso, verrà attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per ciascuno dei lotti dal n. 7 al n. 20, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima – verrà di fatto neutralizzato e non inciderà sul punteggio conseguito, restando in tal modo impregiudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;
- dà atto che per l'offerta tecnica presentata da OLINTO MARTELLI S.R.L. per il lotto n. 7 ha conseguito il punteggio tecnico pari a 34,4, inferiore alla soglia di sbarramento di 35 punti, di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara. Pertanto, non si procederà a riparametrizzazione della stessa, come previsto all'art. 18.3 del Disciplinare;
- dà atto che nell'offerta tecnica presentata da HOLLISTER S.p.A. per il lotto n. 9 risulta mancante il seguente requisito minimo: catetere in poliuretano;
- dà atto che nell'offerta tecnica presentata da WELLSPECT S.R.L. per il lotto n. 10 risulta mancante il seguente requisito minimo: lunghezza minima catetere bambino 25 cm;
- dà atto che HOLLISTER S.p.A. ha presentato campionatura per i lotti n. 7 e n. 15, ma non ha presentato offerta tecnica per i medesimi lotti;
- dà atto che, per mero errore materiale, tra i requisiti minimi previsti per i lotti n. 23 e n. 25 è stata riportata la lunghezza minima pari a 35 cm, non necessaria per i dispositivi in discorso in quanto pediatrici e, pertanto, dà atto che non ne verrà tenuto conto nello svolgimento della valutazione tecnica;
- dà atto che SANITER BICE MARIOTTINI SRL ha presentato campionatura per i seguenti lotti: 22, 29, 31, 34, 38, 40, 45, 65, 81 ma non risulta presente la relativa documentazione tecnica nella piattaforma Net4market. Pertanto, ritiene opportuno chiedere chiarimenti al Servizio tecnico della piattaforma, al fine di verificare con certezza la mancanza a sistema della suddetta documentazione;
- in merito all'offerta tecnica presentata da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto n. 26, sospende la valutazione del sub-criterio "Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.", in quanto non riesce ad aprire il file denominato "Relazione tecnica lotto 26" dallo stesso O.E. A tale proposito, ritiene opportuno contattare il Servizio Tecnico della piattaforma Net4market al fine di verificare se il suddetto file sia danneggiato o meno;
- le risultanze dell'attività valutativa svolta, unitamente ai punteggi tecnici attribuiti, sia effettivi che riparametrati, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara, sono riportate dettagliatamente nel prospetto allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- dà atto che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 6, 10, 15, 21, 27, 54, 56, 57, 63, 70.

La Commissione Giudicatrice

- scioglie la riserva sull'ammissione degli O.E. Boston Scientific S.p.A, DBI Srl, MEDIVAL SRL e UROMED SRL, e propone al RUP l'ammissione degli stessi al prosieguo della procedura;
- dà atto della produzione del mod. 7 da parte di TAU MEDICA SRL;

- dà atto che nella documentazione tecnica prodotta da UROMED SRL, sebbene non denominata “relazione tecnica” sono ugualmente presenti le specifiche tecniche corrispondenti ai criteri di valutazione, così come richiesto all’art. 16 del disciplinare di gara;
- preso atto delle difficoltà riscontrate nell’apertura del file prodotto da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto 26, denominato “Relazione tecnica lotto 26”, ammette lo stesso con riserva al prosieguo della procedura, in attesa che il Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market fornisca riscontro in merito all’eventuale danneggiamento dello stesso;
- ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare di gara, propone al RUP l’esclusione dalla presente procedura, dell’O.E. OLINTO MARTELLI SRL, limitatamente al lotto n. 7, per aver conseguito il punteggio tecnico pari a 34,4, inferiore alla soglia di sbarramento al punteggio tecnico, fissata nella misura di 35 punti;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all’art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l’esclusione dalla presente procedura, dell’O.E. HOLLISTER S.p.A., limitatamente al lotto n. 9, per mancanza del seguente requisito minimo: catetere in poliuretano;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all’art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l’esclusione dalla presente procedura, dell’O.E. WELLSPECT S.R.L., limitatamente al lotto n. 10, per mancanza del seguente requisito minimo: lunghezza minima catetere bambino 25 cm;
- dà atto che per i lotti da n. 7 a n. 20 il sub-criterio di valutazione: “Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica” non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell’espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dà atto che per il sub-criterio in discorso, verrà attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per ciascuno dei lotti dal n. 7 al n. 20, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima - verrà di fatto neutralizzato e non inciderà sul punteggio conseguito, restando in tal modo impregiudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;
- dà atto che, per mero errore materiale, tra i requisiti minimi previsti per i lotti n. 23 e n. 25 è stata riportata la lunghezza minima pari a 35 cm, non necessaria per i dispositivi in discorso in quanto pediatrici e, pertanto, dà atto che non ne è stato tenuto conto nello svolgimento della valutazione tecnica;
- dà atto che SANITER BICE MARIOTTINI SRL ha presentato campionatura per i seguenti lotti: 22, 29, 31, 34, 38, 40, 45, 65, 81 ma non risulta presente la relativa documentazione tecnica nella piattaforma Net4market. Pertanto, ritiene opportuno chiedere chiarimenti al Servizio tecnico della piattaforma, al fine di verificare con certezza la mancanza a sistema della suddetta documentazione. A tal fine, dà mandato al RUP di svolgere l’accertamento in questione, le cui risultanze saranno formalizzate in occasione della prossima seduta della Commissione per le valutazioni di competenza della stessa;
- in merito all’offerta tecnica presentata da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto n. 26, sospende la valutazione del sub-criterio “Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.”, in quanto nell’impossibilità di aprire il file denominato “Relazione tecnica lotto 26” dallo stesso O.E. A tale proposito, dà mandato al RUP di contattare il Servizio Tecnico della piattaforma Net4market al fine di verificare se il suddetto file sia danneggiato o meno, le cui risultanze saranno formalizzate in occasione della prossima seduta della Commissione per le valutazioni di competenza della stessa
- conseguentemente, in esito all’attività valutativa svolta nella seduta odierna, dispone l’ammissione al prosieguo della procedura dei seguenti O.E.:

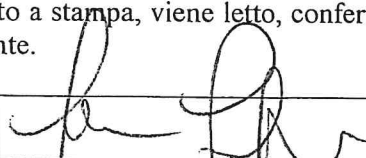





LOTTI	OPERATORI ECONOMICI
1	COLOPLAST S.P.A.
2	OLINTO MARTELLI S.R.L.
3	COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA S.R.L., MEDIVAL S.R.L.
4	COLOPLAST S.P.A.
7	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
8	HOLLISTER S.P.A., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
9	COLOPLAST S.P.A.
11	WELLSPECT S.R.L.
12	COLOPLAST S.P.A.
13	COLOPLAST S.P.A.
14	HOLLISTER S.P.A.
16	COLOPLAST S.P.A., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
17	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
18	B BRAUN MILANO S.P.A.
19	BENEFIS S.R.L.
20	BENEFIS S.R.L.
22	CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A., OLINTO MARTELLI S.R.L.,
23	CO.DI.SAN. S.P.A.
24	CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A., COLOPLAST S.P.A.,
25	CO.DI.SAN. S.P.A., COLOPLAST S.P.A.
26	CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A. (con riserva), COLOPLAST S.P.A., OLINTO MARTELLI S.R.L., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
28	COLOPLAST S.P.A.
29	COLOPLAST S.P.A.
30	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
31	COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L.
32	CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A.

33	CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A.
34	COLOPLAST S.P.A.
35	CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L., OLINTO MARTELLI S.R.L.

- dà atto che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 5, 6, 10, 15, 21, 27, 54, 56, 57, 63, 70.
- alle ore 17.32 di oggi 08/11/2022 dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori della Commissione al giorno 21/11/2022 ore 09.00, per la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche dei restanti lotti.

Il presente verbale, composto da n. 10 (dieci) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice e dal segretario verbalizzante.

Dr. Francesco Fagotti	
Dr. Paolo Guiggi	
Dr.ssa Eleonora Salvini	
Dott.ssa Francesca Gernini	

LOTTO N. 1 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI SENZA PALLONCINO - SONDE COUVELAIRE

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta a becco di flauto, 2 fori, senza palloncino. Lunghezza minima 40 cm, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta, sterile, monouso.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta a becco di flauto, 2 fori, senza palloncino. Lunghezza minima 40 cm, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta, sterile, monouso.							SI/NO		MOTIVAZIONE		
CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6					1		DR. FAGOTTI	
								1		DR.SSA SALVINI	
								1		DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6						1		DR. FAGOTTI
									1		DR.SSA SALVINI
									1		DR. GUGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8					1		DR. FAGOTTI	
								1		DR.SSA SALVINI	
								1		DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8						1		DR. FAGOTTI
									1		DR.SSA SALVINI
									1		DR. GUGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8
Uniformità delle parti congiunte	8						1		DR. FAGOTTI		
							1		DR.SSA SALVINI		
							1		DR. GUGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8		
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8						1		DR. FAGOTTI		
							1		DR.SSA SALVINI		
							1		DR. GUGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8		
								1		DR. FAGOTTI	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7			1	DR. SSA SALVINI
									1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			7
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10			1	DR. FAGOTTI
									1	DR. SSA SALVINI
									1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3			3	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3
									1	DR. FAGOTTI
									1	DR. SSA SALVINI
		Praticità della confezione				6			1	DR. GUIGGI
									1	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6
PUNTEGGIO TOTALE							70			




LOTTO N. 2 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESCICALI SENZA PALLONCINO - SONDE COUVELAIRE

OLINTO MARTELLI S.R.L.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta a becco di flauto, 2 fori, 3 vie con palloncino con capacità da 30 a 75 ml. Lunghezza minima 40 cm, con imbuo standard raccordabile ai sistemi di raccolta, sterile, monouso.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta a becco di flauto, 2 fori, 3 vie con palloncino con capacità da 30 a 75 ml. Lunghezza minima 40 cm, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta, sterile, monouso.							SI/NO	MOTIVAZIONE
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
							1	
					8			
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGI	
						1		
						8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	




Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7			1	DR.SSA SALVINI
									1	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	-
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
								1	DR. FAGOTTI	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10			1	DR.SSA SALVINI
									1	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
								3	DR. FAGOTTI	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3			3	DR.SSA SALVINI
									3	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
								1	DR. FAGOTTI	
Praticità della confezione	6								1	DR.SSA SALVINI
									1	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
							PUNTEGGIO TOTALE			



LOTTO N. 3 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI SENZA PALLONCINO - SONDE MALECOT

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta Malecot, senza palloncino. Lunghezza minima 30 cm, con mandrino, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	
							6	
							1	
	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				8	
							1	
							1	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	
							8	
							1	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	
							8	
							1	
							1	
							8	
							1	

SI/NO	MOTIVAZIONE	
	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR. SSA SALVINI
	1	DR. GUIGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR. SSA SALVINI
	1	DR. GUIGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR. SSA SALVINI
	1	DR. GUIGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR. SSA SALVINI
	1	DR. GUIGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR. SSA SALVINI
	1	DR. GUIGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
	1	DR. FAGOTTI

12

DR. FAGOTTI

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				7	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR.SSA SALVINI DR. GUGGI
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	n. 7 misure offerte n. 7 misure offerte n. 7 misure offerte TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,78 0,78 0,78 0,78	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUGGI
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7,80	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata			3		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUGGI
		Praticità della confezione				6	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUGGI
PUNTEGGIO TOTALE							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	67,80	6

COOK ITALIA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta Malecot, senza palloncino. Lunghezza minima 30 cm, con mandrino, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6			Superficie parzialmente ruvida	0,6	DR. FAGOTTI		
						Superficie parzialmente ruvida	0,6	DR.SSA SALVINI		
						Superficie parzialmente ruvida	0,6	DR. GIUGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,60		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3,60		
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				Punta rigida	0,6	DR. FAGOTTI	
							Punta rigida	0,6	DR.SSA SALVINI	
							Punta rigida	0,6	DR. GIUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,6	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3,60	

Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. SSA SALVINI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	DR. SSA SALVINI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6,40	DR. SSA SALVINI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	DR. GUIGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6,40	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6	DR. SSA SALVINI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0,6	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5,33	DR. FAGOTTI
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.			7	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	DR. SSA SALVINI
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure			10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10	DR. FAGOTTI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. SSA SALVINI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	DR. GUIGI
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata			3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. SSA SALVINI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	



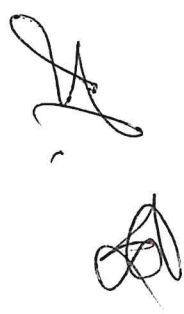
Handwritten signature and initials.

Caratteristiche del confezionamento	9						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3			
								1		DR. FAGOTTI	
								1		DR.SSA SALVINI	
								1		DR. GUIGGI	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6
		PUNTEGGIO TOTALE									60,93

MEDIVAL S.R.L.										
REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta Malecot, senza palloncino. Lunghezza minima 30 cm, con mandrino, sterile, monouso.						MOTIVAZIONE				
						SI/NO				
						SI				
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6			Superficie notevolmente ruvida	0,6		DR. FAGOTTI	
						Superficie notevolmente ruvida	0,4		DR.SSA SALVINI	
						Superficie notevolmente ruvida	0,6		DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,53		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3,20		
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				Punta rigida e traumatica	0,4		DR. FAGOTTI
							Punta rigida e traumatica	0,4		DR.SSA SALVINI
							Punta rigida e traumatica	0,4		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,4	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		2,40	
		Facilità di posizionamento	8					1		DR. FAGOTTI
								1		DR.SSA SALVINI
								1		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8					1		DR. FAGOTTI
								1		DR.SSA SALVINI
								1		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8	
						Buona collegabilità tra mandrino e drenaggio	0,8		DR. FAGOTTI	




PUNTEGGIO TOTALE						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6
						49,03	

LOTTO N. 4 – SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI SENZA PALLONCINO - SONDE MERCIER

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: sonda semirigida con punta curva Mercer, 2 fori, lunghezza minima 40 cm, senza palloncino, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta, sterile, monouso

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, assente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							1	DR. FAGOTTI
		Atraumaticità e conformazione della punta assente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI

12


Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI	DR. GUGGI
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	DR. SSA SALVINI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI	DR. GUGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. FAGOTTI	DR. SSA SALVINI
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. SSA SALVINI	DR. GUGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3		
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	DR. SSA SALVINI
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI	DR. GUGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
PUNTEGGIO TOTALE				70			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 5 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

LOTTO DESERTO



LOTTO N. 6 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

LOTTO DESERTO

TS

27

200

LOTTO N. 7 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

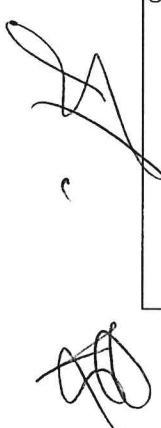
OLINTO MARTELLI S.R.L.


REQUISITI MINIMI: Catetere in PVC, UOMO - DONNA: Catetere autolubrificante pronto all'uso in PVC trasparente, idrofilico, punta nelaton, con soluzione fisiologica integrata nella confezione, con guaina di protezione per metodina no touch, due fori di drenaggio atraumatici e smussati, contenuto in confezione tascabile singola sterile, con doppia apertura. Uomo: lunghezza minima 35 cm - Donna: lunghezza minima 15 cm. Misure varie.

						SI/NO	MOTIVAZIONE		
						SI			
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6			Materiale non omogeneo e ruvido	0,2	DR. FAGOTTI	
						Materiale non omogeneo e ruvido	0,2	DR.SSA SALVINI	
						Materiale non omogeneo e ruvido	0,2	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,2	
						Punta estremamente rigida	0,2	DR. FAGOTTI	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				Punta estremamente rigida	0,2	DR.SSA SALVINI
							Punta estremamente rigida	0,2	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,2
							2,4		
							PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO		
Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8	Facilità di posizionamento	8			Troppo rigido, quindi scarsamente maneggevole	0,2	DR. FAGOTTI	
						Troppo rigido, quindi scarsamente maneggevole	0,2	DR.SSA SALVINI	
						Troppo rigido, quindi scarsamente maneggevole	0,2	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,6	
						Guaina non confortevole	0,2	DR. FAGOTTI	
		Guaina non confortevole	8				Guaina non confortevole	0,2	DR.SSA SALVINI
							Guaina non confortevole	0,2	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,6
							1,6		
							PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO		

[Handwritten signature]

Caratteristiche funzionali	32	Uniformità delle parti congiunte	8				Facilità di collegamento alla sacca di raccordo discreta	0,6	DR. FAGOTTI					
							Facilità di collegamento alla sacca di raccordo discreta	0,6		DR.SSA SALVINI				
							Facilità di collegamento alla sacca di raccordo discreta	0,6			DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6						
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,8						
							Scorrevolezza non idonea anche successivamente alla lubrificazione	0,2				DR. FAGOTTI		
							Scorrevolezza non idonea anche successivamente alla lubrificazione	0,2					DR.SSA SALVINI	
							Scorrevolezza non idonea anche successivamente alla lubrificazione	0,2						DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,2						
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1,6						
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO														
9,6														
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR. FAGOTTI					
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1		DR.SSA SALVINI				
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1			DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1						
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7						
							n. 17 misure offerte	1				DR. FAGOTTI		
							n. 17 misure offerte	1					DR.SSA SALVINI	
							n. 17 misure offerte	1						DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1						
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10						
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO														
10														
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure					n. 17 misure offerte	1	DR. FAGOTTI					
							n. 17 misure offerte	1		DR.SSA SALVINI				
							n. 17 misure offerte	1			DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1						
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10						
							PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO							
							10							





Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3				3	DR. FAGOTTI	
							3	DR.SSA SALVINI	
							3	DR. GUGGI	
						3			
						3			
		Praticità della confezione	6						
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO						5,4			
PUNTEGGIO TOTALE						34,4			

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Catetere in PVC, UOMO - DONNA: Catetere autolubrificante pronto all'uso in PVC trasparente, idrofili, punta nelaton, con soluzione fisiologica integrata nella confezione, con guaina di protezione per metodina no touch, due fori di drenaggio atraumatici e smussati, contenuto in confezione tascabile singola sterile, con doppia apertura. Uomo: lunghezza minima 35 cm - Donna: lunghezza minima 15 cm. Misure varie.							SI/NO	MOTIVAZIONE	
							SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale <									

LOTTO N. 8 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

HOLLISTER S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere in PVC, UOMO. Catetere autolubrificante monovla, pronto per l'uso, lido, punta conico-olivare morbida con soluzione fisiologica integrata nella confezione, con guaina di protezione per metodica no touch, due fori di drenaggio atraumatici e smussati, in PVC trasparente, in confezione singola sterile, con doppia apertura. Misure varie UOMO


						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6			Punta leggermente rigida	0,8	DR. FAGOTTI
						Punta leggermente rigida	0,8	DR.SSA SALVINI
						Punta leggermente rigida	0,8	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,8	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			Buona facilità di posizionamento	0,6	DR. FAGOTTI
						Buona facilità di posizionamento	0,6	DR.SSA SALVINI
						Buona facilità di posizionamento	0,6	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			Alloggiamento nella confezione non facilitante	0,6	DR. FAGOTTI
						Alloggiamento nella confezione non facilitante	0,6	DR.SSA SALVINI
						Alloggiamento nella confezione non facilitante	0,6	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

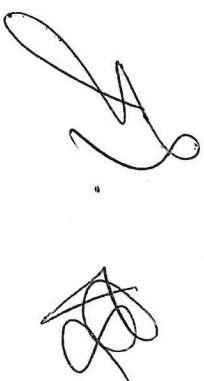
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	8	Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
					Scorrevolezza non ottimale	0,8	DR. FAGOTTI
					Scorrevolezza non ottimale	0,8	DR.SSA SALVINI
					Scorrevolezza non ottimale	0,8	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6,4	
					Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR. FAGOTTI
					Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR.SSA SALVINI
					Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7						
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	10	N. 3 MISURE OFFERTE	0,27	DR. FAGOTTI
					N. 3 MISURE OFFERTE	0,27	DR.SSA SALVINI
					N. 3 MISURE OFFERTE	0,27	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,27	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2,7	
						0	DR. FAGOTTI
						0	DR.SSA SALVINI
						0	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	6	Buona praticità della confezione	0,6	DR. FAGOTTI
					Buona praticità della confezione	0,6	DR.SSA SALVINI
					Buona praticità della confezione	0,6	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3,6	
						0	DR. FAGOTTI
						0	DR.SSA SALVINI
						0	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,6	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3,6	
PUNTEGGIO TOTALE					48,1		



REQUISITI MINIMI: Catetere in PVC, UOMO: Catetere autolubrificante monovita, pronto per l'uso, idrofilico, punta conico-olivare morbida con soluzione fisiologica integrata nella confezione, con guaina di protezione per metodica no touch, due fori di drenaggio atraumatici e smussati, in PVC trasparente, in confezione singola sterile, con doppia apertura. Misure varie UOMO

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, assente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Atraumaticità e conformazione della punta assente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR.SSA SALVINI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	N. 11 MISURE OFFERTE		1	DR. FAGOTTI
				N. 11 MISURE OFFERTE		1	DR.SSA SALVINI
				N. 11 MISURE OFFERTE		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	0		0	DR. FAGOTTI
				0		0	DR.SSA SALVINI
				0		0	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0	
		Praticità della confezione	6	1		1	DR. FAGOTTI
				1		1	DR.SSA SALVINI
				1		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
PUNTEGGIO TOTALE							
67							



LOTTO N. 9 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere autolubrificato, UOMO - DONNA - BAMBINO: Catetere autolubrificato monovola, pronto per l'uso, idrofilico, in poliuretano, punta nelaton, immerso in soluzione fisiologica sterile, con fori smussati ed autolubrificati, contenuto in confezione singola sterile con sacca raccogliurine integrata. Uomo: lunghezza minima 35 cm. - Donna e bambino: lunghezza minima 15 cm. Misure varie Uomo, Donna e Bambino

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. SSA SALVINI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
						1	DR. FAGOTTI
						1	DR. SSA SALVINI
						1	DR. GUIGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10			0	DR. FAGOTTI
						0	DR. SSA SALVINI
						0	DR. GUIGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0	
						1	DR. FAGOTTI
						1	DR. SSA SALVINI
						1	DR. GUIGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3			0	
						1	DR. FAGOTTI
		Praticità della confezione	6			1	DR. SSA SALVINI
						1	DR. GUIGI
				PUNTEGGIO TOTALE		67	

HOLLISTER S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere autolubrificato, UOMO - DONNA - BAMBINO: Catetere autolubrificato monovita, pronto per l'uso, idrofili, in poliuretano, punta nelaton, immerso in soluzione fisiologica sterile, con fori smussati ed autolubrificati, contenuto in confezione singola sterile con sacca raccogliurine integrata. Uomo: lunghezza minima 35 cm - Donna e bambino: lunghezza minima 15 cm. Misure varie Uomo, Donna e Bambino							SI/NO	MOTIVAZIONE
							NO	MANCANZA DEL SEGUENTE REQUISITO MINIMO: CATETERE IN POLIURETANO
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
						DR. FAGOTTI		
						DR.SSA SALVINI		
						DR. GUIGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
Caratteristica del materiale								
17								

Caratteristica del materiale

12

Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni

6

Caratteristiche funzionali	32	Atraumaticità e conformazione della punta assente da scabrosità e di corretta conformazione	6			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	DR. SSA SALVINI
							DR. GUIGGI
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	DR. SSA SALVINI
							DR. GUIGGI
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	DR. SSA SALVINI
							DR. GUIGGI
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	DR. SSA SALVINI
							DR. GUIGGI
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	DR. SSA SALVINI
							DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	DR. SSA SALVINI
							DR. GUIGGI

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	6	Praticità della confezione	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			
							DR. FAGOTTI	DR. SSA SALVINI	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO									
PUNTEGGIO TOTALE									

LOTTO N. 10 – SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

WELLSPECT S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Catetere autolubrificato, UOMO - BAMBINO: Catetere autolubrificato monovia, pronto per l'uso, in POBE o similare, tascabile, idrofilico, punta nelaton con soluzione fisiologica integrata nella confezione, dotato di guida ergonomica per effettuare il cateterismo con metodica no touch, due fori di drenaggio atraumatici e smussati, senza falati, trasparente e in confezione singola sterile. Uomo: lunghezza minima 35 cm - Bambino: lunghezza minima 25 cm Misure varieUomo - Bambino

REQUISITI MINIMI: Catetere autolubrificato, UOMO - BAMBINO: Catetere autolubrificato monovia, pronto per l'uso, in POBE o similare, tascabile, idrofilico, punta nelaton con soluzione fisiologica integrata nella confezione, dotato di guida ergonomica per effettuare il catterismo con metodica no touch, due fori di drenaggio atraumatici e smussati, senza flaiati, trasparente e in confezione singola sterile. Uomo: lunghezza minima 35 cm - Bambino: lunghezza minima 25 cm Misure varieluomo - Bambino						SI/NO		MOTIVAZIONE			
CRITERI DI VALUTAZIONE						PUNTEGGIO MAX		MOTIVAZIONE		PUNTEGGIO COMMISSARI	
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE						PUNTI D MAX		PUNTI T MAX		PUNTI Q MAX	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, assente da imperfezioni	6				MOTIVAZIONE		PUNTEGGIO COMMISSARI		
									DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI		
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE									
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO									
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				MOTIVAZIONE		PUNTEGGIO COMMISSARI		
									DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI		
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE									
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO									

RS

11

21

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7				DR. FAGOTTI
										DR.SSA SALVINI
										DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10				DR. FAGOTTI
										DR.SSA SALVINI
										DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3				DR. FAGOTTI
										DR.SSA SALVINI
										DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			
		Praticità della confezione				6				DR. FAGOTTI
										DR.SSA SALVINI
										DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			
PUNTEGGIO TOTALE										

22

WELLSPECT S.R.L.

Donna



Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022				1	DR. FAGOTTI	
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022				1	DR.SSA SALVINI	
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022				1	DR. GUGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				7		
				1				DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI
				1				DR. GUGGI	1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				10		
				0				DR. FAGOTTI	0	DR.SSA SALVINI
0				DR. GUGGI	0					
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				0						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				0						
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	1				DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI
				1				DR. GUGGI	1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				6		
				PUNTEGGIO TOTALE				67		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 12 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere autolubrificato monovia in PUR, UOMO - DONNA: Catetere autolubrificato monovia, pronto per l'uso, ldrofilico, in poliuretano, punta nelaton già immerso in soluzione fisiologica sterile, con fori emussati ed autolubrificati, contenuto in confezione tascabile singola sterile. Misure varie UOMO - DONNA

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI		
					1	DR.SSA SALVINI		
					1	DR. GUIGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI		
					1	DR.SSA SALVINI		
					1	DR. GUIGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR. FAGOTTI
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR.SSA SALVINI
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022	1	DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10	
								0	DR. FAGOTTI
								0	DR.SSA SALVINI
								0	DR. GUIGI
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGI
PUNTEGGIO TOTALE							67		

LOTTO N. 13 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere autolubrificato monovia in PUR, UOMO : Catetere autolubrificato monovia, pronto per l'uso, idrofilico, in polietilene, con guida protettiva asciutta per metodica no touch, punta nelaton flessibile, con fori smussati ed autolubrificati, contenuto in confezione tascabile singola sterile. Misure varie UOMO

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				MOTIVAZIONE	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				6	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
		Uniformità delle parti congiunte	8				8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
		TOTA. COEFFICIENTI COMMISSIONE					8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
		TOTA. PUNTEGGIO SUBCRITERIO					8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR.SSA SALVINI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
				1		DR. FAGOTTI	
				1		DR.SSA SALVINI	
				1		DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
				0		DR. FAGOTTI	
				0		DR.SSA SALVINI	
				0		DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0	
				1		DR. FAGOTTI	
				1		DR.SSA SALVINI	
				1		DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	6	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
				1		DR. FAGOTTI	
				1		DR.SSA SALVINI	
				1		DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
				1		DR. FAGOTTI	
				1		DR.SSA SALVINI	
				1		DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6					
PUNTEGGIO TOTALE				67			

81.

81.

81.

81.

LOTTO N. 14 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

HOLLISTER S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere in PVC, atetere in PVC privo di ftalati, punta nelaton provvisto di introduttore che protegge la punta del catetere evitando il transito nei primi 15 mm dell'uretra e contenitore di gel che permette la lubrificazione al momento dell'uso. Confezionamento adeguato per effettuare il cateterismo con tecnica no-touch. In confezione singola sterile. Misure varie Uomo - Donna

							SI/NO	MOTIVAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							1	DR. FAGOTTI
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI	
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1		
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1		
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1		
							Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1		
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	DR. SSA SALVINI	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7		
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	DR. GUIGI	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3		
PUNTEGGIO TOTALE											70

DR. FAGOTTI

DR. SSA SALVINI

DR. GUIGGI

LOTTO N. 15 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

LOTTO DESERTO

2

73

10

LOTTO N. 16 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere con punta a sfera morbida, parte anteriore flessibile, fori arrotondati atraumatici, pronto all'uso, con soluzione salina compresa nella confezione. In confezione singola sterile. Misure varie Uomo							SI/NO		MOTIVAZIONE			
							SI					
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI					
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1		DR. FAGOTTI			
							1		DR.SSA SALVINI			
							1		DR. GUIGI			
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				6		
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6					1		DR. FAGOTTI		
								1		DR.SSA SALVINI		
								1		DR. GUIGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				6	
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO												
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1		DR. FAGOTTI			
							1		DR.SSA SALVINI			
							1		DR. GUIGI			
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				8		
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8					1		DR. FAGOTTI		
								1		DR.SSA SALVINI		
								1		DR. GUIGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				8	
		Uniformità delle parti congiunte	8					1		DR. FAGOTTI		
								1		DR.SSA SALVINI		
								1		DR. GUIGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8					1		DR. FAGOTTI		
								1		DR.SSA SALVINI		
								1		DR. GUIGI		
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1								

4

12

12

[illegible][illegible]

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR.SSA SALVINI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
				PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO			
Gamma delle misure disponibili	10	Amplezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	n. 11 misure offerte		1	DR. FAGOTTI
				n. 11 misure offerte		1	DR.SSA SALVINI
				n. 11 misure offerte		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO							
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	0			DR. FAGOTTI
				0			DR.SSA SALVINI
				0			DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0	
		1			DR. FAGOTTI		
		1			DR.SSA SALVINI		
		1			DR. GUIGGI		
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1					
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6					
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO							
PUNTEGGIO TOTALE							
63,8							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 17 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Catetere con punta a sfera morbida, parte anteriore flessibile, fori arrotondati atraumatici, pronto all'uso, con gel lubrificante in contenitore integrato compreso nella confezione o già applicato. In confezione singola sterile. Misure varie Uomo


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI	
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. SSA SALVINI	
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR. SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10		
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10		
						0	DR. FAGOTTI	
						0	DR. SSA SALVINI	
						0	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR. SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR. SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR. SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8						
PUNTEGGIO TOTALE							67	






LOTTO N. 18 - SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI

B BRAUN MILANO S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere nelaton con lubrificante per cateterismo intermittente: catetere autolubrificato monovita, pronto per l'uso, idrofilico, punta nelaton, lubrificato con glicerina ed acqua integrati nella confezione, guaina per effettuare il cateterismo con metodica no touch, due fori di drenaggio traumatici e smussati, in poliolefina senza frangi, diametro identificato da codice colore, in confezione singola sterile. Uomo: lunghezza minima 40 cm - Donna: lunghezza minima 15 cm. Misure varie Uomo - Donna

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
							1		
							6		
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
								1	
								6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
							1		
							8		
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
								1	
								8	
Uniformità delle parti congiunte	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
						1	DR. GUIGGI		
						1			
						8			
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
						1	DR. GUIGGI		
						1			
						8			

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR.SSA SALVINI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	DR. FAGOTTI		1	
				DR.SSA SALVINI		1	
				DR. GUGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	DR. FAGOTTI		3	
				DR.SSA SALVINI		3	
				DR. GUGGI		3	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
Praticità della confezione	6	DR. FAGOTTI		1			
		DR.SSA SALVINI		1			
		DR. GUGGI		1			
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1			
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6			
PUNTEGGIO TOTALE							70


LOTTO N. 19 - SONDE NELATON NON AUTOLUBRIFICANTI

BENEFIS S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Sonda semirigida, trasparente, in silicone o pvc, a una via, senza palloncino, punta nelaton, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta e dotato di codice colore, lunghezza minima 40 cm, sterile, monouso.

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6			SI		
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
		Facilità di posizionamento	8			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. FAGOTTI		
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR.SSA SALVINI		
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1			
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7			
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	1		1	DR. FAGOTTI		
				1		1	DR.SSA SALVINI		
				1		1	DR. GUIGGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1			
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10			
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	3		3	DR. FAGOTTI		
				3		3	DR.SSA SALVINI		
				3		3	DR. GUIGGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3			
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3			
		Praticità della confezione	6	1		1	DR. FAGOTTI		
				1		1	DR.SSA SALVINI		
				1		1	DR. GUIGGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1			
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6			
PUNTEGGIO TOTALE								70	

LOTTO N. 20 – SONDE NELATON NON AUTOLUBRIFICANTI

BENEFIS S.R.L.





REQUISITI MINIMI: Sonda semirigida, trasparente, in silicone o pvc, a una via, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta e dotato di codice colore, lunghezza minima 40 cm, punta olivare curva tipo Tiemann, sterile, monouso.

REQUISITI MINIMI: Sonda semirigida, trasparente, in silicone o pvc, a una via, con imbuto standard raccordabile ai sistemi di raccolta e dotato di codice colore, lunghezza minima 40 cm, punta olivare curva tipo Tiemann, sterile, monouso.							SI/NO	MOTIVAZIONE	
							SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6					1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8					1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
Uniformità delle parti congiunte	8					1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
						1	DR. GUIGGI		
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8					1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
						1	DR. GUIGGI		
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12		1	DR. FAGOTTI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. SSA SALVINI
				Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 12 dell'08/11/2022		1	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7	
				DR. FAGOTTI		1	
				DR. SSA SALVINI		1	
				DR. GUIGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	DR. FAGOTTI		3	
				DR. SSA SALVINI		3	
				DR. GUIGGI		3	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
				DR. FAGOTTI		1	
				DR. SSA SALVINI		1	
				DR. GUIGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	DR. FAGOTTI		1	
				DR. SSA SALVINI		1	
				DR. GUIGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
				DR. FAGOTTI		1	
				DR. SSA SALVINI		1	
				DR. GUIGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
PUNTEGGIO TOTALE							70

LOTTO N. 21 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI SENZA PALLONCINO

LOTTO DESERTO

LOTTO N. 22 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

CLINI-LAB S.R.L.

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						Sì		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	7	N. 14 GG	1	DR. FAGOTTI	
						N. 14 GG	1	DR.SSA SALVINI
						N. 14 GG	1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	10	N. 7 MISURE	0,88	DR. FAGOTTI	
						N. 7 MISURE	0,88	DR.SSA SALVINI
						N. 7 MISURE	0,88	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,88	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8,8	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. FAGOTTI	
						3	DR.SSA SALVINI	
						3	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
		Praticità della confezione	6		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
PUNTEGGIO TOTALE 68,8								

CO.DI.SAN. S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE: catetere a due vie in lattice, silliconato esternamente (preferibilmente anche internamente), con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata; lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						1			
						1			
		Attraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6					6	
							1		
							1		
							1		
							1		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO						6			
						1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
							DR. GUIGGI		
						1			
						6			

Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0	DR. FAGOTTI
						Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0	DR.SSA SALVINI
						Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0	
						N. 7 MISURE	0,88	DR. FAGOTTI
						N. 7 MISURE	0,88	DR.SSA SALVINI
						N. 7 MISURE	0,88	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,88	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8,8	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	DR. FAGOTTI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
		Trasparenza confezione primaria che permetta di					3	


Caratteristiche del confezionamento	9	visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
Praticità della confezione	6						1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
PUNTEGGIO TOTALE							61,8		

OLINTO MARTELLI S.R.L.

OLINTO MARTELLI S.R.L.										
REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE: catetere a due vie in lattice, siliconato esternamente (preferibilmente anche internamente), con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata; lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.						SI/NO	MOTIVAZIONE			
						SI				
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1		DR. FAGOTTI	
							1		DR. SSA SALVINI	
			1		DR. GUIGGI				1	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1		DR. FAGOTTI	
							1		DR. SSA SALVINI	
			1		DR. GUIGGI				1	

[Handwritten signatures and initials]

		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
								N. 10 GG	0,71	DR. FAGOTTI
								N. 10 GG	0,71	DR.SSA SALVINI
								N. 10 GG	0,71	DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,71	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,97	
									1	DR. FAGOTTI
									1	DR.SSA SALVINI
									1	DR. GUIGGI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10	
									3	DR. FAGOTTI
									3	DR.SSA SALVINI
									3	DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
									1	DR. FAGOTTI
									1	DR.SSA SALVINI
									1	DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
PUNTEGGIO TOTALE										67,97





LOTTO N. 23 – SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

CO.DI.SAN. S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE PEDIATRICO: catetere a due vie in lattice, siliconato esternamente (preferibilmente anche internamente), con palloncino 1,5-5 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata; lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.									
SI/NO		MOTIVAZIONE							
SI									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		



Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7	Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0	DR. FAGOTTI	
							Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0		DR. SSA SALVINI
							Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0		
							Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0		
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0		
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		3
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3		
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
PUNTEGGIO TOTALE							63			
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO							70			

LOTTO N. 24 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI NELATON CON PALLONCINO

CLINI-LAB S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100%: catetere in silicone 100%, superficie liscia, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata; lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100%: catetere in silicone 100%, superficie liscia, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata; lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levighezza delle superfici, esente da imperfezioni	6			1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
						1		
						6		
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
						1		
						8		
		Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	
Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI		
					1	DR.SSA SALVINI		
					1	DR. GUIGGI		
					1			
					8			
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI		
					1	DR.SSA SALVINI		
					1	DR. GUIGGI		
					1			
					8			

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				7		1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10		1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3		3	DR. FAGOTTI
								3	DR.SSA SALVINI
								3	DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3
		Praticità della confezione						1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
PUNTEGGIO TOTALE							70		

CO.DI.SAN. S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100%: catetere in silicone 100%, superficie liscia, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata: lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, assente da imperfezioni	6				1	
							DR. FAGOTTI	
							DR.SSA SALVINI	
							DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
		1						
		Atraumaticità e conformazione della punta assente da scabrosità e di corretta conformazione	6				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							6	
							1	
							DR. FAGOTTI	
DR.SSA SALVINI								
DR. GUIGGI								
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE								
1								
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO								
6								

Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. FAGOTTI	
		Uniformità delle parti congiunte	8					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	8
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1							DR. GUIGGI		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1							1		
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7				Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0	DR. SSA SALVINI	
							Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.	0	DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0		
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1									
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1							8		



Caratteristiche funzionali	32	garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
								1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI		
					1	DR. GUGGI				
		Uniformità delle parti congiunte	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
					1	DR. FAGOTTI				
					1	DR.SSA SALVINI				
					1	DR. GUGGI				
Stabilità del presidio in situ	7	Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
								1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI		
					1	DR. GUGGI				
		Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7		
					1	DR. FAGOTTI				
					1	DR.SSA SALVINI				
					1	DR. GUGGI				
Gamma delle misure disponibili	10	Amplezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10		
								3	DR. FAGOTTI	
							3	DR.SSA SALVINI		
					3	DR. GUGGI				
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3		
					1	DR. FAGOTTI				
					1	DR.SSA SALVINI				
					1	DR. GUGGI				
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
PUNTEGGIO TOTALE										
70										

25

27

28

29

LOTTO N. 25 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI NELATON CON PALLONCINO

CO.DI.SAN. S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% PEDIATRICO: catetere a due vie in silicone 100%, con palloncino 1,5-5 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso. Misure varie.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, assente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Atraumaticità e conformazione della punta assente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7	Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.		0	DR. FAGOTTI
				Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.		0	DR.SSA SALVINI
				Riscontro fornito non consente di valutare con certezza le tempistiche di permanenza in situ.		0	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	DR. FAGOTTI		1	
				DR.SSA SALVINI		1	
				DR. GUIGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	DR. FAGOTTI		3	
				DR.SSA SALVINI		3	
				DR. GUIGGI		3	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
		Praticità della confezione	6	DR. FAGOTTI		1	
				DR.SSA SALVINI		1	
				DR. GUIGGI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
				PUNTEGGIO TOTALE		63	

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100%, PEDIATRICO: catetere a due vie in silicone 100%, con palloncino 1,5-5 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso. Misure varie.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI
Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6					DR. FAGOTTI	1
						DR.SSA SALVINI	1
						DR. GUIGGI	1
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1





Caratteristiche del materiale	12	Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR.SSA SALVINI		
									1	DR. GUIGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR.SSA SALVINI		
									1	DR. GUIGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
									1	DR. FAGOTTI		
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8						1	DR.SSA SALVINI		
									1	DR. GUIGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
		Uniformità delle parti congiunte	8						1	DR. FAGOTTI		
									1	DR.SSA SALVINI		
									1	DR. GUIGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8						1	DR. FAGOTTI		
									1	DR.SSA SALVINI		
									1	DR. GUIGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.							7			
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR.SSA SALVINI		
									1	DR. GUIGGI		
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure							10			
									3	DR. FAGOTTI		
									3	DR.SSA SALVINI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		

15

82

105

Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	6	3	6	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. GUIGGI	3	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	3		
								1	DR. FAGOTTI		
								1	DR. SSA SALVINI		
								1	DR. GUIGGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6		
							PUNTEGGIO TOTALE				70

LOTTO N. 26 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

CLINI-LAB S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
							1	DR. FAGOTTI
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				0,8	DR. FAGOTTI
							0,8	DR.SSA SALVINI
							0,8	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,8
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6,4
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI

Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUGGI	1
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR. SSA SALVINI		
									1	DR. GUGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR. SSA SALVINI		
									1	DR. GUGGI		
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8						Assenza di siringa preliempia nella confezione	0,8	DR. FAGOTTI	
									Assenza di siringa preliempia nella confezione	0,8	DR. SSA SALVINI	
									Assenza di siringa preliempia nella confezione	0,8	DR. GUGGI	
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6,4		
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR. SSA SALVINI		
									1	DR. GUGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
									1	DR. FAGOTTI		
									1	DR. SSA SALVINI		
									1	DR. GUGGI		
									TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
									TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
PUNTEGGIO SINGOLO CRITERIO												
Valutazione sospesa												
Valutazione sospesa												
Tempo massimo di permanenza in sede con assenza												
DR. SSA SALVINI												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stabilità del presidio in situ	7	di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	DR. GUIGGI	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	DR. FAGOTTI	
				DR.SSA SALVINI	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	DR. GUIGGI	
				3	
				3	
				3	
				3	
				3	
				3	
				3	
				3	
				3	
Praticità della confezione	6			DR. FAGOTTI	
				DR.SSA SALVINI	
				DR. GUIGGI	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
PUNTEGGIO TOTALE					
6					

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.							SI/NO	MOTIVAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale 								

DR. FAGOTTI

DR. GUIGGI

DR. SALVINI

Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. SSA SALVINI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
						Assenza di siringa prelievata nella confezione	0,8	DR. FAGOTTI
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			Assenza di siringa prelievata nella confezione	0,8	DR. SSA SALVINI
						Assenza di siringa prelievata nella confezione	0,8	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6,4	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
Stabilità del presidio in situ	7	Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
						Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa		DR. FAGOTTI
		Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa		DR. SSA SALVINI
						Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa		DR. GUGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0	
		Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				N. 7 MISURE	0,87	DR. FAGOTTI
						N. 7 MISURE	0,87	DR. SSA SALVINI
						N. 7 MISURE	0,87	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,87	
Gamma delle misure disponibili	10	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8,7	
							3	DR. FAGOTTI
							3	DR. SSA SALVINI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Caratteristiche del confezionamento	9	PUNTEGGIO MAX				PUNTEGGIO COMMISSARI			
		PUNTEGGIO TOTALE				PUNTEGGIO COMMISSIONE			
Praticità della confezione	6								
		PUNTEGGIO TOTALE							

OLINTO MARTELLI S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.										
						SI/NO	MOTIVAZIONE			
						SI				
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1		DR. FAGOTTI	
							1		DR.SSA SALVINI	
			1		DR. GUIGGI					
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1		DR. FAGOTTI	
							1		DR.SSA SALVINI	
			1		DR. GUIGGI					
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		

Handwritten signature and initials.

Uniformità delle parti congiunte	8	8	7	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1			
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8	
					1		DR. FAGOTTI	
					1		DR. SSA SALVINI	
					1		DR. GUGGI	
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1					
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8			
			Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa		DR. FAGOTTI			
			Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa		DR. SSA SALVINI			
			Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa		DR. GUGGI			
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.	7	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1			
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
					N. 8 MISURE		1	
					N. 8 MISURE		1	
					N. 8 MISURE		1	
Gamma delle misure disponibili	10	Amplezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1			
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10	
					3		DR. FAGOTTI	
					3		DR. SSA SALVINI	
					3		DR. GUGGI	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3			
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
					1		DR. FAGOTTI	
					1		DR. SSA SALVINI	
					1		DR. GUGGI	
PUNTEGGIO TOTALE				6				

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6			
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1			
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6			
		Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
									1	DR.SSA SALVINI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8			
Uniformità delle parti congiunte	8						1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8			
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8						1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8			
						Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa				
						DR. FAGOTTI				

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7	Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa	DR.SSA SALVINI
							Valutazione sospesa in attesa riscontro doc. tecnica Codisan Spa	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	0,87	DR. FAGOTTI
							0,87	DR.SSA SALVINI
							0,87	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,87
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8,7
							3	DR. FAGOTTI
							3	DR.SSA SALVINI
							3	DR. GUIGGI
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
		Praticità della confezione					1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6
							PUNTEGGIO TOTALE	




LOTTO N. 27 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI NELATON CON PALLONCINO

LOTTO DESERTO





LOTTO N. 28 – SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 3 VIE: CATETERE FOLEY 3 VIE SILICONE 100%: catetere a tre vie in silicone 100%, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 3 VIE: CATETERE FOLEY 3 VIE SILICONE 100%: catetere a tre vie in silicone 100%, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.										SI/NO		MOTIVAZIONE																	
										SI																			
CRITERI DI VALUTAZIONE										PUNTEGGIO MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX		PUNTI T MAX		PUNTI Q MAX		MOTIVAZIONE		PUNTEGGIO COMMISSARI							
Caratteristiche del materiale										12		Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni		6								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1		DR. FAGOTTI	
																										1		DR.SSA SALVINI	
																										1		DR. GUIGGI	
																										1		1	
																										1		1	
												Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione		6								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1		DR. FAGOTTI	
																										1		DR.SSA SALVINI	
																										1		DR. GUIGGI	
																										1		1	
																										1		1	
Facilità di posizionamento		8										TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1		DR. FAGOTTI											
																1		DR.SSA SALVINI											
																1		DR. GUIGGI											
																1		1											
																1		1											
Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)		8										TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1		DR. FAGOTTI											
																1		DR.SSA SALVINI											
																1		DR. GUIGGI											
																1		1											
																1		1											
Uniformità delle parti congiunte		8										TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1		DR. FAGOTTI											
																1		DR.SSA SALVINI											
																1		DR. GUIGGI											
																1		1											
																1		1											
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità		8										TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1		DR. FAGOTTI											
																1		DR.SSA SALVINI											
																1		DR. GUIGGI											
																1		1											
																1		1											

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7	DR. FAGOTTI	
							1	
							DR.SSA SALVINI	
							DR. GUIGI	
							1	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7						
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	DR. FAGOTTI	
							1	
							DR.SSA SALVINI	
							DR. GUIGI	
							1	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10						
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	DR. FAGOTTI	
							3	
							DR.SSA SALVINI	
							DR. GUIGI	
							3	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3						
Praticità della confezione	6						DR. FAGOTTI	
							1	
							DR.SSA SALVINI	
							DR. GUIGI	
							1	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6						
PUNTEGGIO TOTALE							70	

LOTTO N. 29 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

COLOPLAST S.P.A.

							SI/NO	MOTIVAZIONE
REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 3 VIE: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100%: catetere Foley, due vie, in silicone 100% per cateterizzazione complessa, apeo in punta per passaggio di filo guida, lunghezza minima 35 cm, fori di drenaggio atraumatici, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.							SI	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levighezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7		1	DR. FAGOTTI			
								1	DR.SSA SALVINI			
								1	DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			7		
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10		1	DR. FAGOTTI			
								1	DR.SSA SALVINI			
								1	DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			10		
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3		3	DR. FAGOTTI			
								3	DR.SSA SALVINI			
								3	DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			3		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3		
Caratteristiche del confezionamento	9	Praticità della confezione				6		1	DR. FAGOTTI			
								1	DR.SSA SALVINI			
								1	DR. GUGGI			
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6		
PUNTEGGIO TOTALE							70					






LOTTO N. 30 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

REQUISITI MINIMI: SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO (CATETERE + SACCA): sistema a circuito chiuso in silicone (catetere + sacca) pronto per l'uso per la massima protezione contro le infezioni durante il drenaggio delle urine, catetere con palloncino di capacità 10ml, codice colore, due fori, linea radiopaca, sterile, monouso. Misure varie.

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8						1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	
							8	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7	1		DR. FAGOTTI
							1		DR.SSA SALVINI
							1		DR. GUIGI
							1		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7							
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	1		DR. FAGOTTI
							1		DR.SSA SALVINI
							1		DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		10
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	3		DR. FAGOTTI
							3		DR.SSA SALVINI
							3		DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3
Caratteristiche del confezionamento	9	Praticità della confezione				6	1		DR. FAGOTTI
							1		DR.SSA SALVINI
							1		DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
PUNTEGGIO TOTALE							70		

LOTTO N. 31 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI DELINOTTE

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE DELINOTTE 3 VIE SILICONE: catetere a tre vie in silicone 100%, con palloncino da 50 a 80 ml, 2 fori laterali, punta secondo Delinotte, con valvola e raccordi luer e luer lock, sterile, monouso.

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede.				7	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUGGI
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	n. 4 misure	0,8	DR. FAGOTTI
							n. 4 misure	0,8	DR.SSA SALVINI
							n. 4 misure	0,8	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
								3	DR. FAGOTTI
								3	DR.SSA SALVINI
								3	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Caratteristiche del confezionamento		9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata			3			
			Praticità della confezione			6			
PUNTEGGIO TOTALE								68	

AV

MEDIVAL S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: CATETERE DELINOTTE 3 VIE SILICONE: catetere a tre vie in silicone 100%, con palloncino da 50 a 80 ml, 2 fori laterali, punta secondo Delinotte, con valvola e raccordi luer e luer lock, sterile, monouso.									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE		
						SI	PUNTEGGIO COMMISSARI		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							Punta lievemente rigida	0,8	DR. FAGOTTI
							Punta lievemente rigida	0,8	DR.SSA SALVINI
							Punta lievemente rigida	0,8	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,8	
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUGGI	

PUNTEGGIO TOTALE						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6
						61,8	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LOTTO N. 32 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI DUFOUR

CLINI-LAB S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE DUFOUR 2 VIE: catetere con rivestimento idrofilico a due vie, punta secondo Dufour, con palloncino della capacità compresa tra 50 e 100 ml, lunghezza minima 35 cm, 2 fori laterali con imbuto e valvola con raccordi luer e luer lock, latex free, senza talati, sterile, monouso.

						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
							6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
							6	
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
							8	
		Uniformità delle parti congiunte	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUGGI
							1	
							8	
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				0	
							8	
							DR. FAGOTTI	
							DR. GUGGI	

SI/NO	MOTIVAZIONE	
SI		
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUGGI
	1	
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				7	Non indicati tempi di permanenza.	0		DR.SSA SALVINI
							Non indicati tempi di permanenza.	0		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			0
								1		DR. FAGOTTI
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10		1		DR.SSA SALVINI
								1		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			10
								3		DR. FAGOTTI
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3		3		DR.SSA SALVINI
								3		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			3
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3
								1		DR. FAGOTTI
		Praticità della confezione						1		DR.SSA SALVINI
								1		DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6
							PUNTEGGIO TOTALE		63	

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE DUFOUR 2 VIE: catetere con rivestimento idrofilico a due vie, punta secondo Dufour, con palloncino della capacità compresa tra 50 e 100 ml, lunghezza minima 35 cm, 2 fori laterali con imbuto e valvola con raccordi luer e luer lock, latex free, senza tralati, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, essente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GIUGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
		Atraumaticità e conformazione della punta essente da scabrosità e di corretta conformazione	6					0,8	DR. FAGOTTI
								0,8	DR. SSA SALVINI
								0,8	DR. GIUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,8
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		4,8
					1		DR. FAGOTTI		
					1		DR. SSA SALVINI		





Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
							1	
							1	
							1	
		Uniformità delle parti congiunte	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	
							1	
Stabilità del presidio in situ	7	Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							1	
							1	
		Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7	
							0,8	
							0,8	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,8	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							3	
							3	
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
							1	
							1	
Caratteristiche del confezionamento	9	Praticità della confezione	6			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
							1	

						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6
PUNTEGGIO TOTALE							66,8

**TOTALE PUNTEGGIO
SUBCRITERIO**

h

66,8

 73



LOTTO N. 33 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI DUFOUR

CLINI-LAB S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE DUFOUR 3 VIE: catetere con rivestimento idrofilico a tre vie, punta secondo Dufour, con palloncino della capacità compresa tra 50 e 100 ml, lunghezza minima 35 cm, 2 fori laterali con imbuto e valvola con raccordi luer e luer lock, latex free, no flatali, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
						SI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, assente da imperfezioni	6			Superficie lavorata grossolanamente	0,2	DR. FAGOTTI
						Superficie lavorata grossolanamente	0,2	DR. SSA SALVINI
						Superficie lavorata grossolanamente	0,2	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,2
						Forma della punta non idonea	0,2	DR. FAGOTTI
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6			Forma della punta non idonea	0,2	DR. SSA SALVINI
						Forma della punta non idonea	0,2	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,2
						La conformazione della punta rende difficoltosa l'introduzione del dispositivo	0,2	DR. FAGOTTI
						La conformazione della punta rende difficoltosa l'introduzione del dispositivo	0,2	DR. SSA SALVINI
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8			La conformazione della punta rende difficoltosa l'introduzione del dispositivo	0,2	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,2
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1,2
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	DR. SSA SALVINI

Dr.

Dr.

Dr.

						TOTALE PUNTEGGIO SUCRITERIO	10	
							3	DR. FAGOTTI
							3	DR.SSA SALVINI
							3	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
						PUNTEGGIO TOTALE	64,61	



LOTTO N. 34 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI DUFOUR
COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE DUFOUR 3 VIE: catetere con rivestimento idrofilico a tre vie, punta secondo Dufour, con palloncino della capacità compresa tra 30 e 50 ml, lunghezza minima 35 cm, 2 fori laterali, con imbuto e valvola, con raccordi luer e luer lock, latex free, no ftalati, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE
						SI	
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				
		Uniformità delle parti congiunte	8				
		Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8				



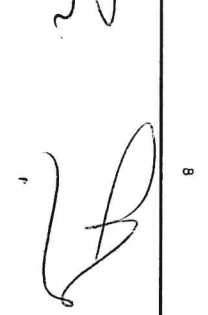
MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
	1	DR. FAGOTTI
	1	DR.SSA SALVINI
	1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				7	DR. FAGOTTI	
							1	
							1	
							1	
							1	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				10	DR. FAGOTTI	
							3	
							3	
							3	
							3	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	DR. FAGOTTI	
							1	
							1	
							1	
							1	
PUNTEGGIO TOTALE							70	

LOTTO N. 35 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICALI TIEMANN CON PALLONCINO

CLINI-LAB S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE TIEMAN 2 VIE: catetere semirigido, trasparente, silicone 100%, a 2 vie, punta olivare curva Tiemann, con palloncino, lunghezza minima 40 cm, con valvola e attacco luer e luer lock, sterile, monouso.							SI/NO	MOTIVAZIONE	
							SI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6					1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8					1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8
Uniformità delle parti congiunte	8					1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
						1	DR. GUGGI		
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8					1	DR. FAGOTTI		
						1	DR.SSA SALVINI		
						1	DR. GUGGI		
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		8		

Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7	Tempi di permanenza non indicati		0	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
				Tempi di permanenza non indicati		0	
				Tempi di permanenza non indicati		0	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0	
Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,78	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		0,78	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,78	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7,8	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	
Caratteristiche del confezionamento	9	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		3	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		3	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
PUNTEGGIO TOTALE							60,8

COLOPLAST S.P.A.							
REQUISITI MINIMI: CATETERE TIEMAN 2 VIE: catetere semifrigido, trasparente, silicone 100%, a 2 vie, punta olivare curva Tiemann, con palloncino, lunghezza minima 40 cm, con valvola e attacco luer e luer lock, sterile, monouso.			SI/NO	MOTIVAZIONE			
CRITERI DI VALUTAZIONE			SI	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatazza delle superfici, assente da imperfezioni	6	PUNTEGGIO MAX		1	DR. FAGOTTI DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI
				SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		1	
				PUNTI D MAX		1	
				PUNTI T MAX		1	
				PUNTI Q MAX		1	
				MOTIVAZIONE		1	
				PUNTEGGIO COMMISSARI		1	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
				1		DR. FAGOTTI	
				1		DR.SSA SALVINI	
				1		DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		6	
				1		DR. FAGOTTI	
				1		DR.SSA SALVINI	
				1		DR. GUIGGI	

		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6			<table><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>8</td></tr></table>	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6		1		1		1	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		1		1		1	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		1		1		1	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6																																							
	1																																							
	1																																							
	1																																							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																																							
	1																																							
	1																																							
	1																																							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																																							
	1																																							
	1																																							
	1																																							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																																							
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8			<table><tr><td></td><td>DR. FAGOTTI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR.SSA SALVINI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR. GUIGGI</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>8</td></tr></table>		DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI	1	DR. GUIGGI	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																								
				DR. FAGOTTI																																				
			1	DR.SSA SALVINI																																				
		1	DR. GUIGGI																																					
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																					
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																																					
		Uniformità delle parti congiunte	8			<table><tr><td></td><td>DR. FAGOTTI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR.SSA SALVINI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR. GUIGGI</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>8</td></tr></table>		DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI	1	DR. GUIGGI	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																								
				DR. FAGOTTI																																				
			1	DR.SSA SALVINI																																				
		1	DR. GUIGGI																																					
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																																							
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8			<table><tr><td></td><td>DR. FAGOTTI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR.SSA SALVINI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR. GUIGGI</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>8</td></tr></table>		DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI	1	DR. GUIGGI	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																										
		DR. FAGOTTI																																						
	1	DR.SSA SALVINI																																						
1	DR. GUIGGI																																							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8																																							
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.				<table><tr><td></td><td>DR. FAGOTTI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR.SSA SALVINI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR. GUIGGI</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>7</td></tr></table>		DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI	1	DR. GUIGGI	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7																								
				DR. FAGOTTI																																				
			1	DR.SSA SALVINI																																				
			1	DR. GUIGGI																																				
			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																				
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7																																				
			Gamma delle misure disponibili	10	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				<table><tr><td></td><td>DR. FAGOTTI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR.SSA SALVINI</td></tr><tr><td>1</td><td>DR. GUIGGI</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO</td><td>10</td></tr></table>		DR. FAGOTTI	1	DR.SSA SALVINI	1	DR. GUIGGI	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10																					
							DR. FAGOTTI																																	
						1	DR.SSA SALVINI																																	
						1	DR. GUIGGI																																	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1																																							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10																																							
							<table><tr><td></td><td>DR. FAGOTTI</td></tr><tr><td>3</td><td>DR.SSA SALVINI</td></tr><tr><td>3</td><td>DR. GUIGGI</td></tr><tr><td>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE</td><td>3</td></tr></table>		DR. FAGOTTI	3	DR.SSA SALVINI	3	DR. GUIGGI	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3																									
	DR. FAGOTTI																																							
3	DR.SSA SALVINI																																							
3	DR. GUIGGI																																							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3																																							

Caratteristiche del confezionamento	9	Praticità della confezione	6	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				3	
				1		DR. FAGOTTI			
				1		DR.SSA SALVINI			
				1		DR. GUGGI			
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				6	
				PUNTEGGIO TOTALE					



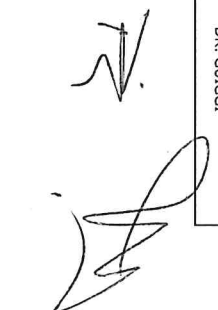
MEDIVAL S.R.L.										
REQUISITI MINIMI: CATETERE TIEMAN 2 VIE: catetere semirigido, trasparente, silicone 100%, a 2 vie, punta olivare curva Tiemann, con palloncino, lunghezza minima 40 cm, con valvola e attacco luer e luer lock, sterile, monouso.						SI/NO		MOTIVAZIONE		
						SI				
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni	6				1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
							1	DR. GUGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6	
		Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione	6				ESTREMITÀ DELLA PUNTA NON PERFORANTE	0,6	DR. FAGOTTI	
							ESTREMITÀ DELLA PUNTA NON PERFORANTE	0,6	DR.SSA SALVINI	
							ESTREMITÀ DELLA PUNTA NON PERFORANTE	0,6	DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0,6
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3,6
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di posizionamento	8				1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
							1	DR. GUGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8	
		Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8					1	DR. FAGOTTI	
								1	DR.SSA SALVINI	
								1	DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8
							1	DR. FAGOTTI		
							1	DR.SSA SALVINI		
							1	DR. GUGGI		
							DR. SSA SALVINI			

	Uniformità delle parti congiunte	8					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
	Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8						1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
							Tempi di permanenza non indicati	0	DR. FAGOTTI
							Tempi di permanenza non indicati	0	DR.SSA SALVINI
							Tempi di permanenza non indicati	0	DR. GUIGGI
Stabilità del presidio in situ	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.	7					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0	
							n. 8 misure	0,89	DR. FAGOTTI
								0,89	DR.SSA SALVINI
								0,89	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,89	
Gamma delle misure disponibili	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure	10					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8,9	
								3	DR. FAGOTTI
								3	DR.SSA SALVINI
								3	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
Caratteristiche del confezionamento	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3						1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
	Praticità della confezione	6						1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
							PUNTEGGIO TOTALE	59,5	

OLINTO MARTELLI S.R.L.

REQUISITI MINIMI: CATETERE TIEMAN 2 VIE: catetere semirigido, trasparente, silicone 100%, a 2 vie, punta olivare curva Tiemann, con palloncino, lunghezza minima 40 cm, con valvola e attacco luer e luer lock, sterile, monouso.	SI/NO	MOTIVAZIONE
	SI	

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	12	Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni	6				1		DR. FAGOTTI	
							1		DR.SSA SALVINI	
							1		DR. GUIGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6	
			1		DR. FAGOTTI					
			1		DR.SSA SALVINI					
			1		DR. GUIGI					
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1					
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6					
Caratteristiche funzionali	32	Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere)	8				1		DR. FAGOTTI	
							1		DR.SSA SALVINI	
							1		DR. GUIGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8	
		Uniformità delle parti congiunte	8					1		DR. FAGOTTI
								1		DR.SSA SALVINI
								1		DR. GUIGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8
Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità	8					1		DR. FAGOTTI		
						1		DR.SSA SALVINI		
						1		DR. GUIGI		
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			8		
Stabilità del presidio in situ	7	Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.					0		DR. FAGOTTI	
							0		DR.SSA SALVINI	
							0		DR. GUIGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			0	

							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
					10		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10
						3	DR. FAGOTTI	
						3	DR.SSA SALVINI	
						3	DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3
						1	DR. FAGOTTI	
						1	DR.SSA SALVINI	
						1	DR. GUGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6
PUNTEGGIO TOTALE								
63								



